

Oferta comercială

HT 100 Sistem de monitorizare a glucozei în sânge



Reagenți GDH-FAD

0,7μl probă de sânge

Valoare medie pentru 14 zile


Rezultatele testului în 5 secunde

500 Rezultate Depozitate

Ejectorul al benzilor

Specificare

Hematocrit	0-70%
Proba	Sânge venos și capilar
Unitate de măsurare	mg/dl sau mmol/L
Interval de măsurare	20-600 mg/dl (1.1-33.3 mmol/L)
Medie	7/14/30 zile
Alarma setată	4 setări
Conexiune	Mini USB extern
Alimentare	2 AAA baterii
Durata vieții bateriei	Aproximativ 1000 teste

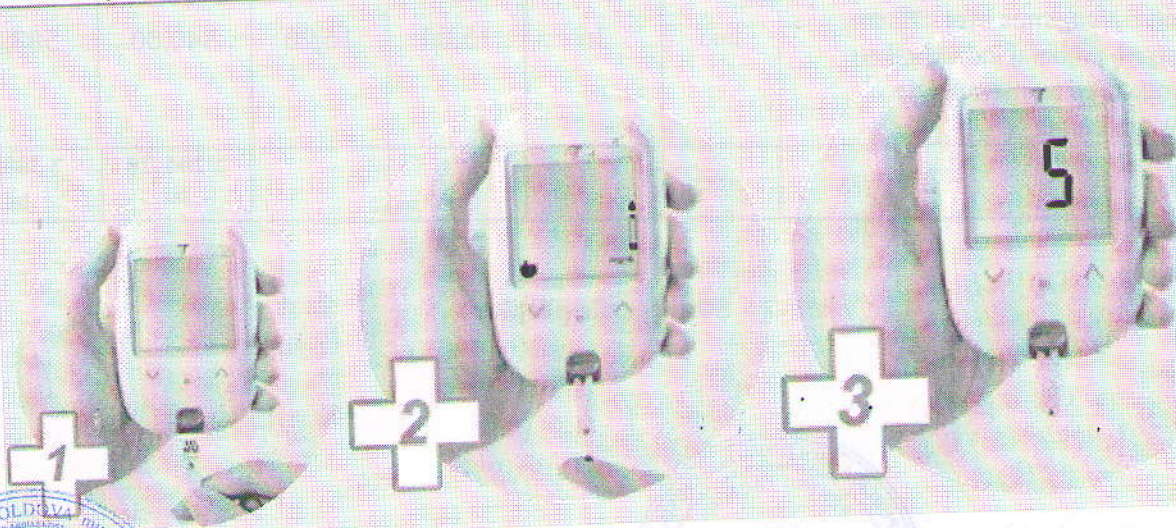

"Profilabdiagnostic" SRL

MD 2028, Moldova, Chișinău, Miorița 5, of.3,
Tel.: /+373 22/ 882-516; Fax: /+373 22/ 882-516
e-mail: profilabdiagnostic@gmail.com

