

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1582295778345d din 05.03.2020
	Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1	Aspirator chirurgical (performanță înaltă)	NEW Hospivac 350	Italia	CA-MI	Conform Anexei 1	Conform Anexei 1	EC, ISO
Lot 4	Lampă de examinare	Mach LED 120F	Germania	Dr. Mach	Conform Anexei 2	Conform Anexei 2	EC, ISO
Lot 5	Lampă germicidă mobilă	NBVE 60PL Flow UV-C	Polonia	Ultraviol	Conform Anexei 3	Conform Anexei 3	EC, ISO
Lot 8	Troleu de urgență	K040-E	Turcia	Kenmak	Conform Anexei 4	Conform Anexei 4	EC, ISO



Semnăt:

Nume: Lungu Ion


În calitate de: Bioinginer

Ofertantul: "M-INTER-FARMA" S.A.

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 21

Data: "04" Martie 2020

Aspirator chirurgical (performanță înaltă) utilizate pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Vacuum: Limita minimă - 0 mm Hg; Limita maximă - ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min; Indicator vacuum - Da, eroarea $\pm 10\%$ Reglator aspirație: Da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector. În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: Da Selector mecanic de vas: Da Numărul vaselor: 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas: Da Vas tip reutilizabil: Da Suport: Container pentru amplasarea tubului deaspirare: Da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frina Da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare Da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației Da Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz Da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Training Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare Da, limba română Service manual Da	New Hospivac 350, CA-MI, Italia Aspirator chirurgical (performanță înaltă) utilizate pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Vacuum: Da, Limita minimă - 0 mm Hg; Da, Limita maximă - 675 mmHg; Da, Rata de flux, l/min. 60 l/min; Da, Indicator vacuum - Da, eroarea $\pm 10\%$ Da, Reglator aspirație: Da Da, Nivelul de zgomot, dBA ~ 50 dBA Vas colector. Da, În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: Da, Selector mecanic de vas: Da, Numărul vaselor: 2 buc. Da, Capacitatea, 5L Da, Protecție la umplere pentru fiecare vas: Da, Vas tip reutilizabil Da, Suport: Container pentru amplasarea tubului deaspirare: Da, Suport cu roțile 4 roți Da, Roți cu frina 2 buc. Da, Mîner pentru transportare Accesorii Da, Pedală de pornire/oprire a aspirației Da, Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz Da, Filtru de unică utilizare 15 buc. Da, Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Logistică Da, Transportare la locul solicitat Da, Instalare Da, Training Cerințe față de furnizor Da, Garanție 2 ani Documente Da, Manual de utilizare, limba română Da, Service manual
---	--

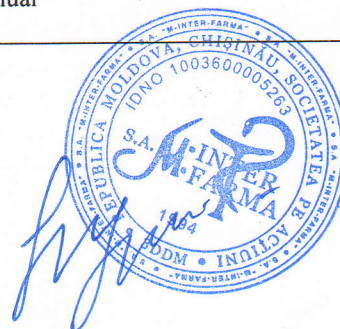

Lampă de examinare utilizată pentru iluminarea zonelor intervențiilor ginecologice Parametru Cerință Caracteristici generale Înălțime Reglabilă, 1.5 – 1.8 m Brațe articulate Da Suport Mobil, minim 4 roți, cu frână Material carcasă Anticorozivă Sursa de lumină LED Intensitatea luminoasă Minimum 50000 Lux la 1 m Reglarea intensității luminoase Da Temperatura luminii Minimum 4300 K Indicile de redare a culorii Ra minimum 95 Durata de viață LED - ului Minimum 30000 ore Sursă de alimentare Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de alimentare Schuko Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Training Da Cerințe față de furnizor Certificate CE, certificat european Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare Da, limba română Service manual Da	Mach LED 120F, Dr. Mach, Germania Lampă de examinare utilizată pentru iluminarea zonelor intervențiilor ginecologice Parametru Cerință Caracteristici generale Da, 0,76 - 1,970 Da, Brațe articulate Da, Suport Mobil, 4 roți, cu frână Da, Material carcasă Anticorozivă Da, Sursa de lumină LED Da, Intensitatea luminoasă 50000 Lux la 1 m Da, Reglarea intensității luminoase Da, Temperatura luminii Minimum 4500 K Da, Indicile de redare a culorii Ra 95 Da, Durata de viață LED – 60000 ore Sursă de alimentare: Da, Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Da, Cablu de alimentare Schuko Logistică Da, Transportare la locul solicitat Da, Instalare Da, Training Cerințe față de furnizor Da, Certificate CE, certificat european Da, Garanție 2 ani Documente Da, Manual de utilizare, limba română Da, Service manual
--	--



	NBVE 60PL Flow UV-C, Ultraviol, Polonia
Lampă germicidă mobilă utilizată pentru sterilizarea încăperilor prin intermediul razelor UVc	Lampă germicidă mobilă utilizată pentru sterilizarea încăperilor prin intermediul razelor UVc
Parametru Cerință	Parametru Cerință
Destinația dezinfectarea aerului din incaperile medicale	Da, Destinația dezinfectarea aerului din incaperile medicale
Corpul de dezinfectare de tip închis Da	Da, Corpul de dezinfectare de tip închis
Undele ultraviolete nu au contact direct cu suprafețele externe a incaperilor Da	Da, Undele ultraviolete nu au contact direct cu suprafețele externe a incaperilor
Dezinfectare fara utilizarea soluțiilor chimice Da	Da, Dezinfectare fara utilizarea soluțiilor chimice
Ventilator intern pentru asigurarea flux de aer Da	Da, Ventilator intern pentru asigurarea flux de aer
Aer tratat, purificat min. 100m3 h	Da, Aer tratat, purificat min. 132 m3/h
Timer de afișarea timpului de lucru a lămpilor Da	Da, Timer de afișarea timpului de lucru a lămpilor
Suport mobil pe roti pivotante cu frina Da	Da, Suport mobil pe roti pivotante cu frina
Suprafața de dezinfectare > 18m²	Da, Suprafața de dezinfectare 20 m²
Sursa de alimentare 220V, 50Hz	Da, Sursa de alimentare 220V, 50Hz
Lămpi Fluorescente tubulare	Da, Lămpi Fluorescente tubulare
Accesorii	Accesorii
Lămpi bactericide de rezerva 1 set	Da, Lămpi bactericide de rezerva 1 set
Filtre de aer 1 set	Da, Filtre de aer 1 set
Cerință față de furnizor	Cerință față de furnizor
Transportare Da	Da, Transportare
Instalare și testare Da	Da, Instalare și testare
Garanție 2 ani	Da, Garanție 2 ani
Training pentru utilizatori Da	Da, Training pentru utilizatori
Manual pentru utilizatori In limba romana sau rusa	Da, Manual pentru utilizatori In limba romana sau rusa
Manual de service sau întreținere Da	Da, Manual de service sau întreținere



	K040-E, Kenmak, Turcia
Troleu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor de urgență și dispozitivelor de resuscitare	Troleu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor de urgență și dispozitivelor de resuscitare
Parametru Cerință	Parametru Cerință
Caracteristici generale	Caracteristici generale
Material carcasa oțel inoxidabil sau metal vopsit	Da, Material carcasa, metal vopsit
Material coșuri plastic Da	Da, Material coșuri plastic
Suprafața de lucru a a troleului Monolit	Da, Suprafața de lucru a a troleului Monolit, inox
Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Da	Da, Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici
Coșuri laterale Minim 2	Da, Coșuri laterale 2 buc.
Coș lateral pentru deșeuri Da	Da, Coș lateral pentru deșeuri
Spațiu de amplasare a defibrilatorului Da, cu fixarea defibrilatorului	Da, Spațiu de amplasare a defibrilatorului, cu fixarea defibrilatorului
Număr de sertare Minim 5	Da, Număr de sertare 5 buc.
Sertare de diferite adâncimi Da	Da, Sertare de diferite adâncimi
Primul sertar Plat	Da, Primul sertar Plat
Sertare Cu divizoare	Da, Sertare Cu divizoare
Număr de roți 4	Da, Număr de roți 4
Roți cu frână Minim 1	Da, Roți cu frână Minim 1
Logistică	Logistică
Transportare la locul solicitat Da	Da, Transportare la locul solicitat
Instalare Da	Da, Instalare
Cerințe față de furnizor	Cerințe față de furnizor
Garanție 2 ani	Da, Garanție 2 ani

