

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Oxigen medical lichid (O<sub>2</sub> - criogenic) este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: LI7K 5 /0,25

Partida №

### BULETIN DE ANALIZE


№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de	99,50	99.80
2	Concentrația de C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , în %,	Absent	absent
3	Concentrația de CO <sub>2</sub> la 1 dm <sup>3</sup> de oxigen lichifiat, cm <sup>3</sup> , nu mai mare	3,0	0.15
4	Conținutul de ulei	Absent	absent
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	retinut
6	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	retinut
7	Conținutul de O <sub>3</sub> și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	retinut
8	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	retinut
9	Prezența mirosului	Absent	absent

**Calitatea oxigenului corespunde conform GOST 6331-78**

**Data: 17.10.2023**

**Inginer laborant:** \_\_\_\_\_

**Laboratorul Secției de Producere**

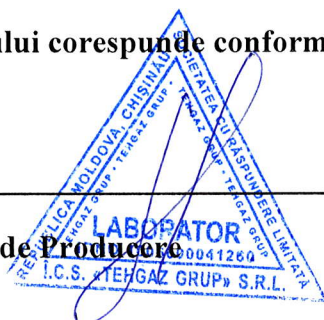

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Oxigen medical gazos (O<sub>2</sub> - gazos) este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: LI7K 5/0,25

Partida №:

### BULETIN DE ANALIZE

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de	99,5	99.80
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.0006
3	Concentrația de H <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO <sub>2</sub> , nu mai mare	0.01	0.005
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O <sub>3</sub> și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Data: 17.10.2023

Inginer laborant: \_\_\_\_\_

Laboratorul Secției de Producere

