


Машина ручная
сверлильная
электрическая
ИЭ 1032-1



Паспорт
ИЭ 1032-1



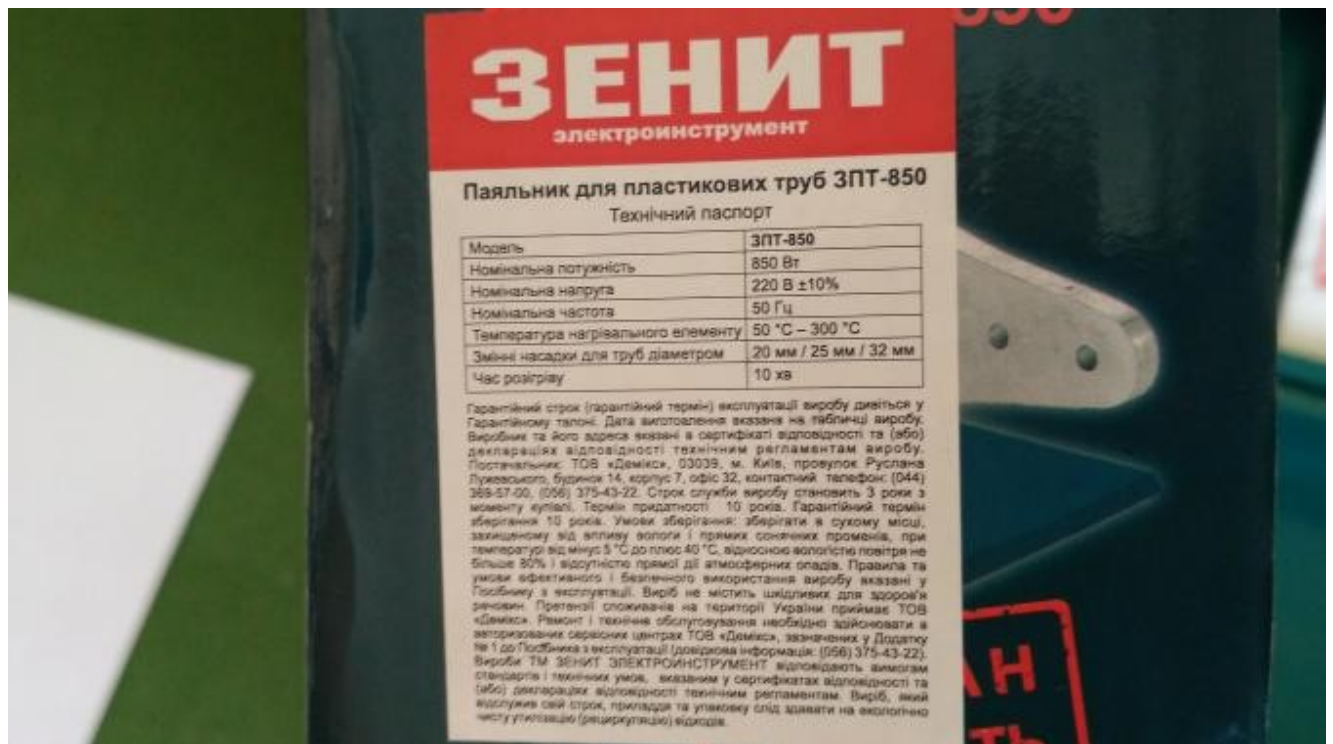

ОКП 42 2406

ЭЛЕКТРОМЕТРА

Уматено по «МЕГОММЕТР»

**МЕГОММЕТРЫ Ф 41021-1М, Ф 41022-1М
ПАСПОРТ****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ДЕЛЕНИЯ**

1.1. Мегомметры Ф41021-1М, Ф41022-1М предназначены для измерения сопротивления изоляции различных электроустановок, их отдельных частей под напряжением, и могут использоваться во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Деления измерения сопротивления изоляции, значения напряжения на шкалах прибора при разомкнутой цепью цепи и участки диапазонов с относительной погрешностью не более 15 и 50%, приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

Уматено многомерный мегомметр	Деления измерения сопротивления, МОм	Уматено деления с относительной погрешностью в процентах		Напряжение В
		15%	50%	
Ф41021-1М	0—30 0—2000	—	0,03—30 30—1000	100±5
	0—150 0—10000	—	0,15—150 150—5000	500±25
	0—300 0—20000	—	0,3—300 300—10000	1000±50
Ф41022-1М	0—2000 0—20000	75—1000 750—4000	—	1000±50
	0—5000 0—50000	107,5—2500 1075—10000	—	2500±125

2.2. Класс точности 1,5 по ГОСТ 8401-80. Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности равен ±1,5% от деления шкалы.

Длина шкалы мегомметра не менее 60 мм.



"УНИВЕРСАЛ"

**НАБОРЫ
ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА**

ПАСПОРТ

000 000 00







