

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 14.12.2020

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1607433438135

Către: **IMSP Institutul Mamei și Copilului**

Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L declară că:

- a. Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificări nu au fost.

Societatea cu răspundere limitată Romedcom S.R.L se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri ”Uscător pentru stația de oxigen”.

Prețul total al ofertei constituie: 83 700,00 **MDL** (optzeci și trei mii șapte sute lei, 00 ban) **MDL**, fără TVA.

Cu TVA constituie: 100 440,00 **MDL** (o sută mii patru sute patruzeci lei, 00 bani) **MDL**.

- b. Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c. În cazul acceptării prezentei oferte, Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.
- e. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: Ștefan Țurcanu_

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L

Adresa: Republica Moldova,

Data 14.12.2020

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1607433438135		Data: 14.12.2020		Pagina: 1 din 1		
Denumirea licitației: Uscător pentru stația de oxigen		Lot: 1		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		
Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
1	2	3	4	5	6	7
42900 000-5	1	Uscător pentru stația de oxigen	RDP 750 + AF(P) 0706 3mkm	Slovenia	Omega Air	8
						Consumul de aer – 750 m3/h Presiune de lucru – 16 bar Alimentare electrică – 3/400V50 Hz Lungimea (A) – pînă la 596mm Lățime (B) – pînă la 735 mm Înălțimea (C) – pînă la 1104 mm Conexiune de intrare/ieșire – G2
						Consumul de aer – 750 m3/h Presiune de lucru – 10 bar Alimentare electrică – 3/400V50 Hz Lungimea (A) – pînă la 600mm Lățime (B) – pînă la 750 mm Înălțimea (C) – pînă la 1200 mm Conexiune de intrare/ieșire – G2”

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciusev 16, of.6

Numărul licitației: : ocds-b3wdp1-MD-1607433438135	Data 14.12.2020
Denumirea licitației: Uscător pentru stația de oxigen	
Pagina: 1 din 1	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42900 000-5	1	Uscător pentru stația de oxigen	Bucată	1	83 700,00	100 440,00	83 700,00	100 440,00	- în decurs de 10 de la solicitare
Suma totală:							83 700,00	100 440,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Romedcom” SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciuseva 16, of.6

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data: 14.12.2020

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1607433438135**

Pagina __ din

A. Ofertanți individuali

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	ROMEDCOM SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	Oficiu: str.Sciusev 16, of. 6 mun. Chișinău Tel/fax: 022-53-01-95 079807733
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	Proprietate	
	Formă de organizare juridică	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2004
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	Producător	-
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Import si comercializarea dispozitive medicale
	Intermediar	-
	Altele	-
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	Numele	Țurcanu Ștefan
	Locul de muncă și funcția	Administrator Legal
	Adresa	Chișinău, Republica Moldova
	Telefon / Fax	Tel.022 53 01 95 Fax. 022 53 01 95
	E-mail:	
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0405126
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	CONFORM FDA
2. Informații de calificare		
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	15 ani

2.1.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	<i>Nu se aplica</i>
2.2.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri similare pe parcursul perioadei prevăzute în IPO 11.1 (a)	<i>Nu se aplică</i>
2.3.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	<i>Nu se aplică</i>
2.4.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<i>Nu se aplică</i>
3. Informații financiare		
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii	
3.2.	Adresa: mun. Chișinău str. Sciusev, 16 of 6. Telefon: (022) 53-01-95;079807733 IBAN: MD87AG00000022513656045 MDL Banca: BC MOLDOVA – AGROINBANK” SA Adresa poștală a băncii: Chișinău str. C. Tanase Cod: AGRNMD2X IDNO:1004600066975	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	Nu este cazul	Nu este cazul
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	Nu este cazul	Nu este cazul
<i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i>		

B. Partenerii individuali ai Asociației

4.1.	Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4.2.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.
4.3.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).
<i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.</i>	



RDP SERIES

REFRIGERATION COMPRESSED AIR DRYERS

14 bar
max. operating pressure

1,5 to 45 °C
operating ambient temperature

3 °C
pressure dew point

20 to 13.200 Nm³/h
flow rate

R134a (R407c)
refrigerant

air cooled
type of cooling

DESCRIPTION


RDP refrigeration dryers have been designed to effectively separate water from the compressed air thus lower pressure dew point all the way down to +3°C.





Drying is achieved on the principle of cooling which takes place inside highly efficient and ultra-compact 3 stage heat exchanger. In the first stage (air-air heat exchanger) hot and humid inlet air is being pre-cooled by the cold outgoing air. In the second stage (air-refrigerant heat exchanger) intensive water condensation takes place due to cooling the air.

All condensed water is separated from the main compressed air stream in the third stage by the integrated demister. A proven and robust design enables efficient and reliable operation, fast installation and simple maintenance.

APPLICATIONS

- Compressed air systems
- Sized to match standard compressor outputs

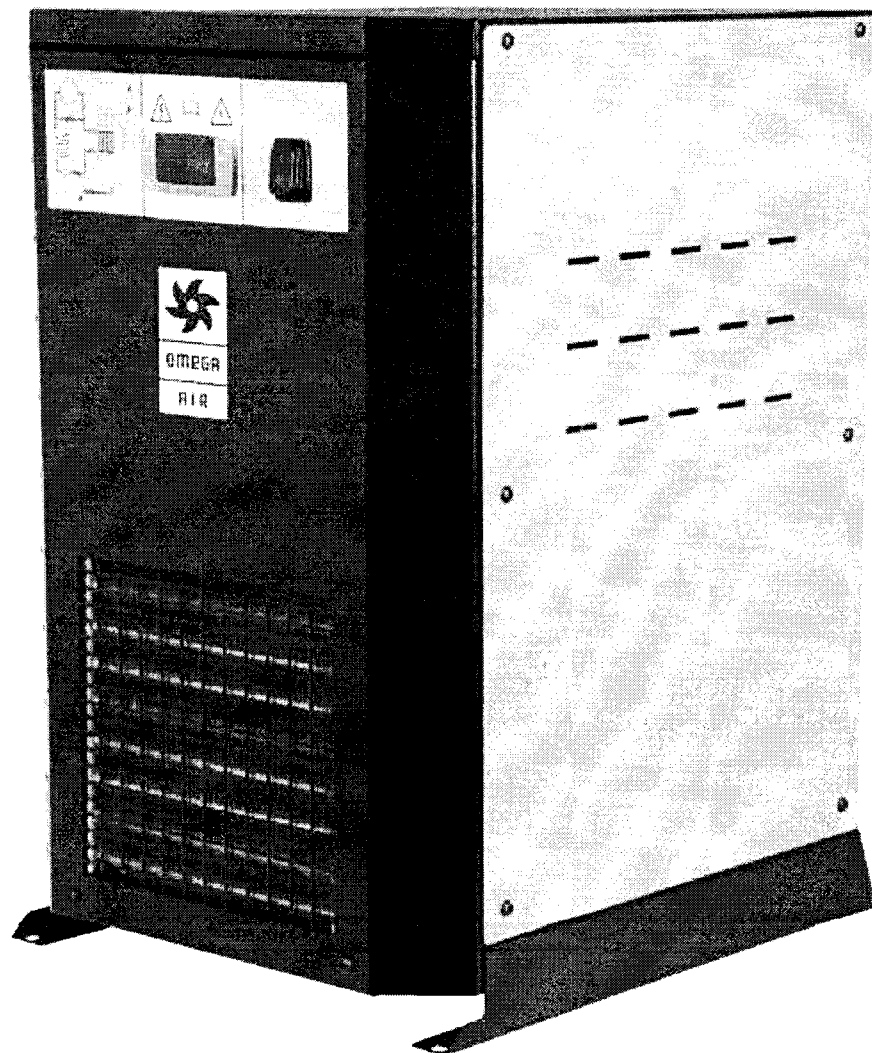

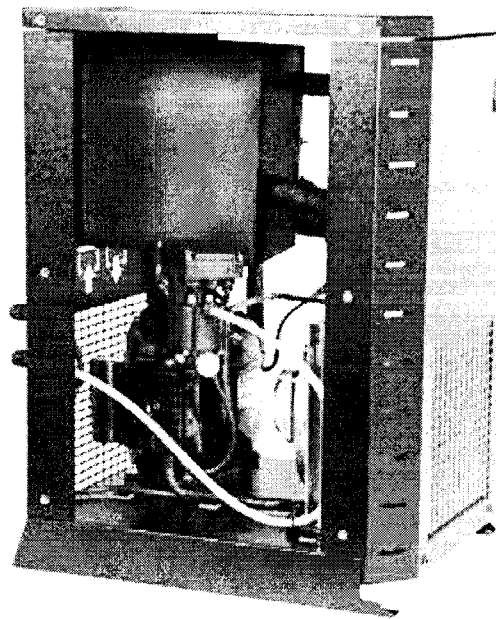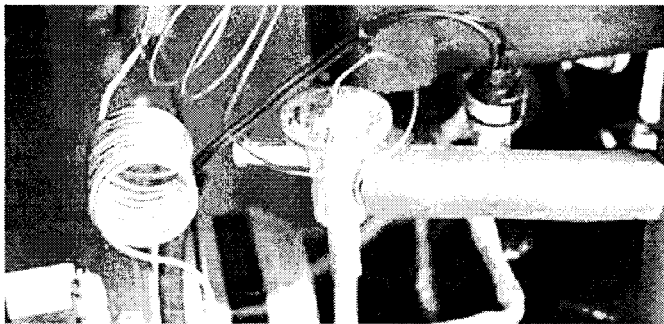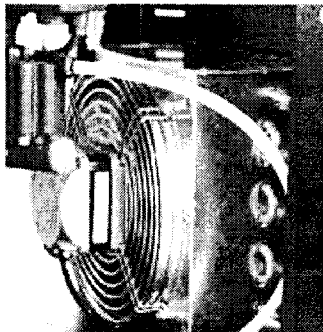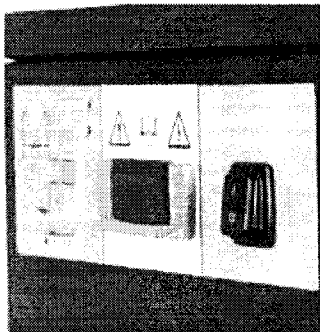

TECHNICAL DATA

Type	Air flow	Power supply	Dimensions			Power Input	Air connection
	Nm ³ /h	Ph / V / Hz	W	L (mm)	H (mm)	W	
RDP 20	20	1/230/50	358	455	604	150	G 3/8" BSP-F
RDP 35	35	1/230/50	358	455	604	150	G 3/8" BSP-F
RDP 50	50	1/230/50	358	455	604	180	G 3/4" BSP-F
RDP 75	75	1/230/50	358	455	604	250	G 3/4" BSP-F
RDP 100	100	1/230/50	358	455	604	360	G 3/4" BSP-F
RDP 140	140	1/230/50	486	580	904	460	G 1" BSP-F
RDP 180	180	1/230/50	486	580	904	590	G 1" BSP-F
RDP 235	235	1/230/50	486	580	904	840	G 1" BSP-F
RDP 300	300	1/230/50	486	580	904	1.200	G 1 1/2" BSP-F
RDP 380	380	1/230/50	596	735	1.104	1.400	G 1 1/2" BSP-F
RDP 480	480	1/230/50	596	735	1.104	1.900	G 1 1/2" BSP-F
RDP 600	600	1/230/50	718	697	1.405	1.900	G 2" BSP-F
RDP 750	750	3/400/50	596	735	1.104	2.700	G 2" BSP-F
RDP 950	950	3/400/50	718	697	1.405	3.800	G 2" BSP-F
RDP 1150	1.150	3/400/50	823	837	1.426	3.700	G 2 1/2" BSP-F
RDP 1300	1.300	3/400/50	823	837	1.426	4.700	G 2 1/2" BSP-F
RDP 1500	1.500	3/400/50	900	1.100	1.500		G 2 1/2" BSP-F
RDP 1900	1.900	3/400/50	900	1.100	1.500		DN80
RDP 2600	2.600	3/400/50	1.200	1.250	1.750		DN100
RDP 3400	3.400	3/400/50	1.200	1.250	1.750		DN100
RDP 4400	4.400	3/400/50	1.200	1.250	1.750		DN125
RDP 5400	5.400	3/400/50	1.350	1.800	1.850		DN125
RDP 6600	6.600	3/400/50	1.350	1.800	1.850		DN150
RDP 7200	7.200	3/400/50	1.350	1.800	1.850		DN150
RDP 8800	8.800	3/400/50	1.350	1.800	1.850		DN200
RDP 10800	10.800	3/400/50	1.600	2.300	2.500		DN200
RDP 13200	13.200	3/400/50	1.600	2.300	2.500		DN200

CORRECTION FACTOR FOR OPERATING PRESSURE CHANGES

Operating pressure [bar]	4	5	6	7	8	10	12	14
Operating pressure [bar]	58	72	87	100	115	145	174	203
Correction factor	0,77	0,86	0,93	1,00	1,05	1,14	1,21	1,27

CORRECTION FACTOR FOR DEW POINT CHANGES

Temperature [°C]	3	5	7	10
Temperature [°F]	37,4	41	44,6	50
Correction factor	1,00	1,099	1,209	1,385

CORRECTION FACTOR FOR INLET TEMPERATURE CHANGES

Temperature [°C]	≤25	30	35	40	45	50	55
Temperature [°F]	77	86	95	104	113	122	131
Correction factor	1,2	1,12	1	0,83	0,69	0,59	0,5

CORRECTION FACTOR FOR AMBIENT TEMPERATURE CHANGES

Temperature [°C]	≤25	30	35	40	45
Temperature [°F]	77	86	95	104	113
Correction factor	1	0,96	0,9	0,82	0,72

ROMEDCOM S.R.L.

C210/E00863

"10" Octombrie 2019

CERTIFICAT

Prin prezentul, Direcția Operațiuni cu Clienții la Centrala B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. (cod bancar AGRNMD2X) confirmă, că ROMEDCOM S.R.L. (cod fiscal 1004600066975) deține în bancă următoarele conturi curente:

Cod IBAN MDL: MD87AG000000022513656045

Cod IBAN EUR: MD33AG000000022513656047

Cod IBAN USD: MD76AG000000022513656049

Cod IBAN RUB: MD22AG000000022513656051

Cu respect,



**Sef al Direcției Operațiuni
cu Clienții la Centrala Băncii**


Salcuțan Natalia

**Contabil șef al Direcției Operațiuni
cu Clienții la Centrala Băncii**

Mardari Marcela

Ex: T.Musteață
Tel: 022-303722

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată

"ROMEDCOM"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1004600066975

Data înregistrării

18.11.2004


Data eliberării

31.03.2010


Jimbei Mihai, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura



MD 0097726

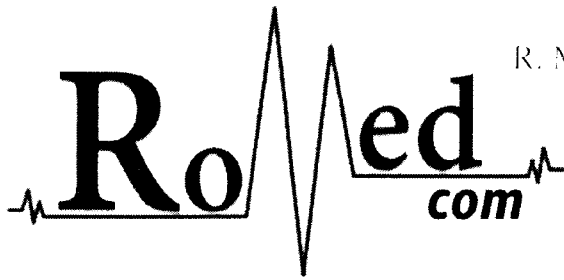

R. Moldova, mun. Chișinău, str. Seiusev 16, of. 2 MD-2001;

Codul Fiscal (IDNO): 1004600066975;

Cod TVA: 0405126

Tel/Fax: +373 (22) 530195

GSM: + 37360106007 + 37379807733 - 37379422107

email: office@romedcom.md; service@romedcom.md

Declarație

Prin prezenta, compania Romedcom SRL participant la procedura de achiziție prin licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1607433438135 din data de 14.12.2020, organizată de către IMSP Institutul Mamei și Copilului, garantează:

- termenul de garanție valabil 12 luni,
- demontarea uscătorului vechi și montarea noului uscător.

Cu respect,

Romedcom SRL