


Imagine de sus – unitatea de alimentare a probelor

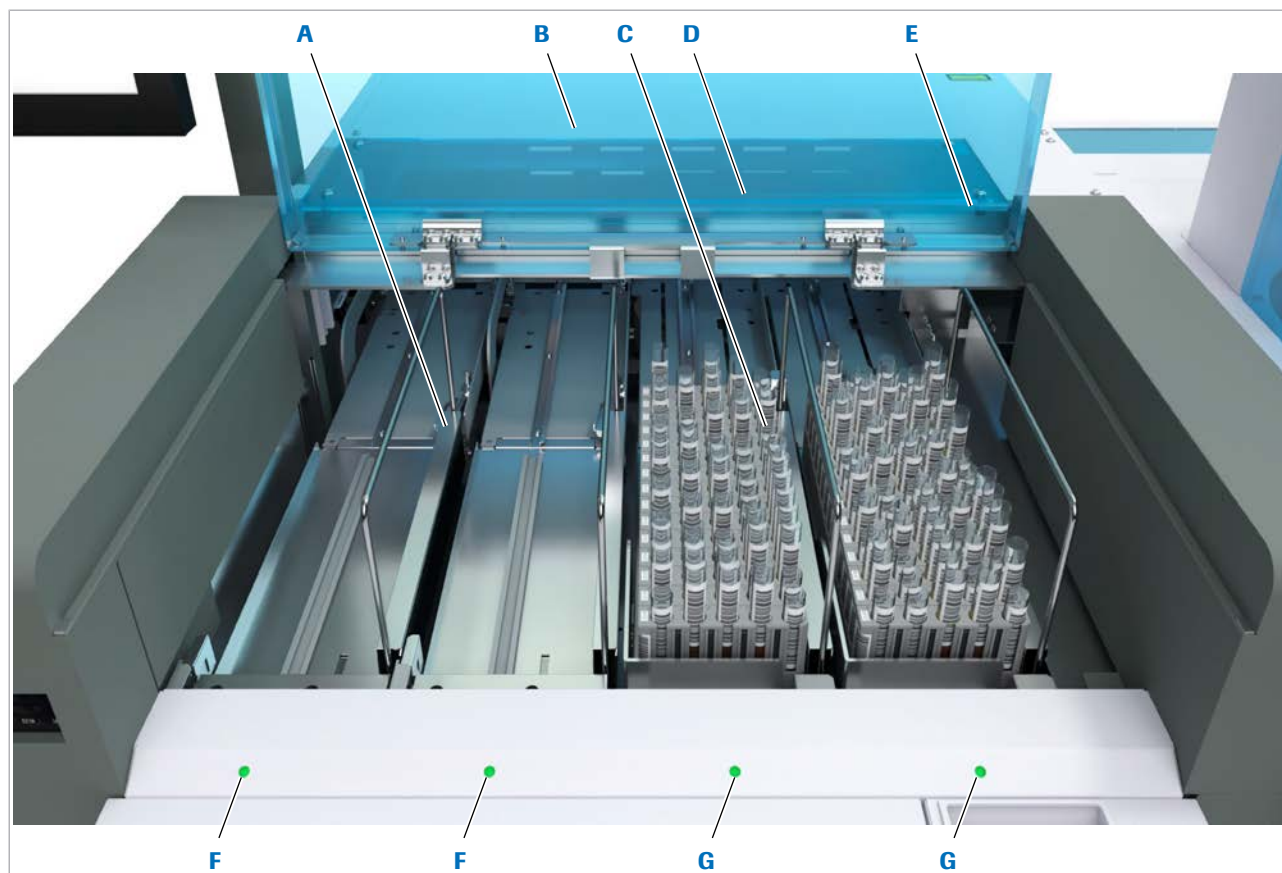

A Benzi de descărcare

B Capac principal

C Culoare de încărcare

D Cititor de coduri de bare rack

E Cititor de coduri de bare probe

F Indicatoare de stare (banda de descărcare)

G Indicatoare de stare (banda de încărcare)

Benzi de descărcare

Benziile de descărcare sunt formate din 2 benzi, fiecare găzduind până la 30 de rackuri (150 probe). Benziile de descărcare găzduiesc rackurile procesate până când le eliminați din instrument.

Capac principal

Capacul principal protejează probele de contaminare. Nu deschideți capacul principal dacă indicatoarele de stare sunt stinse.

Culoare de încărcare

Benziile de încărcare sunt formate din 2 benzi, fiecare găzduind până la 30 de rackuri (150 probe). Rackurile pot fi așezate pe banda de încărcare pe tăvi de rackuri care cuprind până la 15 rackuri. Rackurile sunt transportate spre unitatea intermediară de stocare a probelor posterioară a benzii respective. Imediat ce tava