

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea aparatelor tehnice de laborator dentar

Nr. 18 din 13.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica Stomatologică Republicană (IMSP PSR)
Localitatea	mun. Chișinău
IDNO	1003600150118
Adresa	mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17
Numărul de telefon	tel.: 022-22-22-29
Numărul de fax	-
E-mail oficial	repubdent@ms.md , imsppsr@gmail.com .
Adresa de internet	stomatologia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Chiroșca, jurist, șef al Serviciului juridic și resurse umane tel.: 069974446, suport.juridic.psr@gmail.com.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1762190507144 Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762190507144?tab=contract-notice Data publicării: 03.11.2025
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante	Da
Sursa de finanțare	Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	236 300,00

3. Până la termenul-limită (data 11.11.2025, ora 13:28), au depus oferte 3 (trei) ofertanți:

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	SRL Unident-AS	1003600043229	Sergiu Popa
2	CS Vivodent SRL	100600028842	Alexandru Smîntîna Valentina Smîntîna
3	SRL Reloc-Com	1008600004847	Alexandru Romanenco

4. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Reloc-Com	În temeiul prevederilor pct. 51 din Regulamentul cu privire la achizițiile de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022, Grupul de lucru a decis de a respinge oferta operatorului economic SRL Reloc-Com pentru lotul nr. 2, deoarece aceasta nu corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă, și anume: <ul style="list-style-type: none">- s-a solicitat greutate maximă de 6 kg, dar s-a propus de 9 kg;- s-a solicitat viteza de scanare arcada completă 9 secunde, dar s-a propus model complet arcada 14-20 secunde;- s-a solicitat acuratețe $\leq 6 \mu\text{m}$, dar s-a propus $\leq 8 \mu\text{m}$.

5. Modalitatea de evaluare a ofertelor: *pentru mai multe loturi.*

6. Criteriul de atribuire aplicat: *prețul cel mai scăzut*

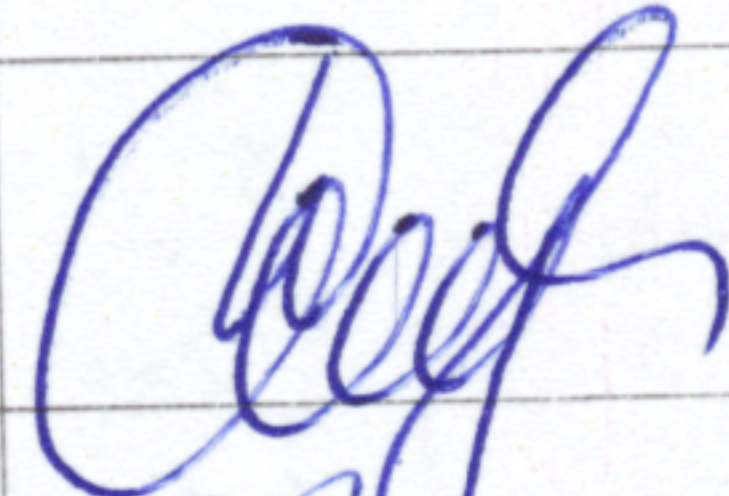
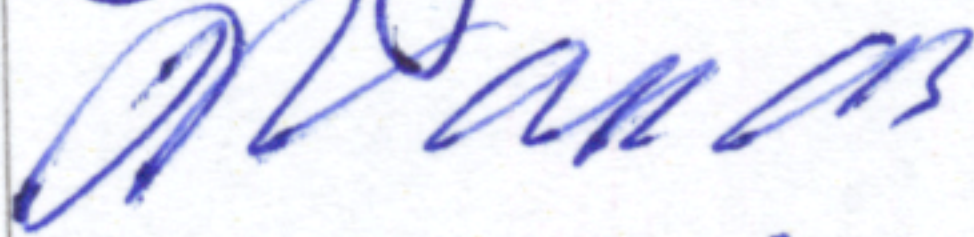
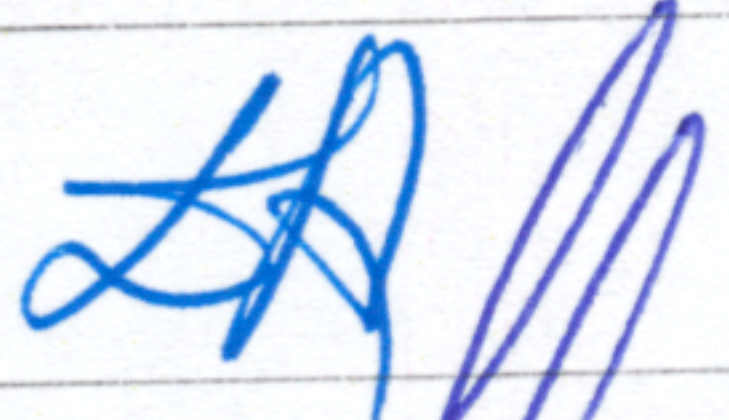
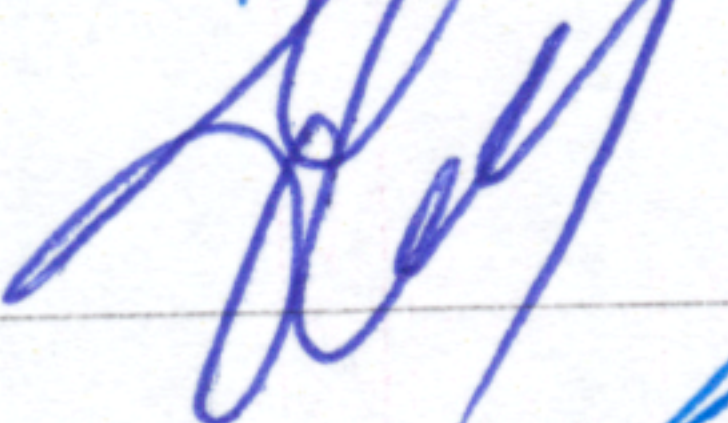
7. Informația privind factorii de evaluare aplicați: *nu se aplică*
8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitatea și unitatea de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul nr. 1 Micromotor de laborator	CS Vivodent SRL	7 buc	8 333,33	58 333,33	70 000,00
Lotul nr. 2 Scanner de laborator dentar 3D	CS Vivodent SRL	1 buc	70 833,33	70 833,33	85 000,00
Lotul nr. 3 Imprimantă de laborator dentar 3D cu stație de spălare și fotopolimerizare	CS Vivodent SRL	1 buc	16 666,67	16 666,67	20 000,00
Lotul nr. 4 Pompă de vid P3 898052	CS Vivodent SRL	1 buc	16 250,00	16 250,00	19 500,00
Lotul nr. 5 Giroform Pin	CS Vivodent SRL	1 buc	51 666,67	51 666,67	62 000,00
Lotul nr. 6 Pompă vacuum	SRL Unident-AS	1 buc	23 342,70	23 342,70	28 011,24

Anularea procedurii de achiziție publică: *Nu se aplică.*

9. Componența grupului de lucru:

Nr. crt.	Numele, prenumele	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Maria Dulgher	Președinte	
2	Tatiana Vascan	Membru	
3	Angela Donica	Membru	
4	Tatiana Ciolpan	Membru	
5	Irina Chiroșca	Secretar	