


Notă informativă

Privind examinarea ofertelor la Licităția Publică 21024143 din 30/06/2020

Produse parafarmaceutice 2020

1. Lot 33. Mască Boussignac CPAP cu nebulizer –Labromed Laborator SRL lipsă mostră, informația (image) nu este suficientă.
Data Control SRL – lipsă mostră.
2. Lot 34. Mască facială tip CPAP - Labromed Laborator SRL lipsă mostră, informația (image) nu este suficientă.
Echipamed Plus SRL – lipsă mostră, informația (image) nu este suficientă.
3. Lot 35. Mască facială tip VNI - Labromed Laborator SRL lipsă mostră, informația (image) nu este suficientă.
4. Lot 58. Set combinat AS+AE – Berhord Farmed SRL mostra prezentată nu întrunește toți parametrii solicitați, cateterul este dintr-un material moale ce crează dificultăți la instalare.
Grazy Price Medical SRL mostra prezentată nu întrunește toți parametrii solicitați.
5. Lot 60. Set pentru anestezie epidurală cu filtru- Berhord Farmed SRL mostra prezentată nu întrunește toți parametrii solicitați, cateterul este din poliamid, material este moale ce crează dificultăți la instalare.
6. Lot 68. Set de tuburi gofrate pentru aparat de ventilare – Imunotehnomed SRL mostra prezentată nu întrunește toți parametrii solicitați, lungimea circuitului este mai mare de 1,5m.

Șef secție ATI Sergiu Cobîlețchi

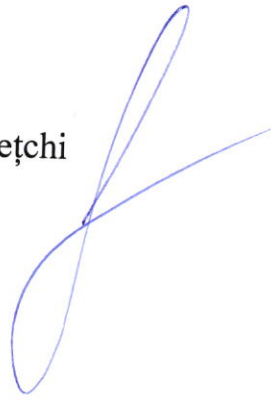


Nota informativă
Privind examinarea ofertelor prezentate la Licitatia publica nr. 21024143(2)
din 30.06.2020
Pentru achizitionarea produselor parafarmaceutice
Loturile nr.nr.51, 85

Ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul **LP nr. 21024143(2) din 30.06.2020**, pentru loturile **nr.nr.51, 85** s-a constatat următoarele:

1. Pentru lotul nr. 51 de catre compania Medexcom-Teh a fost propusa plasa-proteza de polipropilen (nu poliester) in cantitate de 10 bucati fara acoperire de colagen, ce categoric nu poate fi folosita ca proteza intraabdominala.
2. Pentru lotul nr. 85 a fost inaintata oferta pentru tub-dren toracic de catre SRL Sogno. Tubul – dren, este de o rigiditate scazuta si forma curbata. Fiind amplasat in cavitatea pleurala, de la temperatura corpului devine elastic, se indoaie si nu asigura permeabilitatea ceruta.

23.07.2020

Şef secție Bloc de Operații



A. Mitiglo