

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005



Iovu Galina, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 33731 din 18.09.2020

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 **Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 **Comerțul cu autovehicule;**
- 5 **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 **Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 **Publicitate;**
- 8 **Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 **Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 **Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 **Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.09.2020.

Specialist superior
tel. 022-207-837

Teut Marina



EB 0315420



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

05.11.2020

Către IP Institutul Național de Metrologie

LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE BUNURI SIMILARE

Prin prezenta, SA "Eximotor" în persoana directorului Socolova Natalia, întru participarea în licitația cu Nr. ocds-b3wdp1-MD-1603439767696 din 06 noiembrie 2020 prezintă lista principalelor livrări de bunuri similare:

1. Noiembrie 2017

Client: Inspectoratul General de Politie

Bunuri: **Echipament laser de colectare a datelor și cartografiere a locului accidentelor rutiere**

Suma contractului: 348 360,00 lei, inclusiv TVA

Observații: Echipamentul a inclus certificare metrologică și training de utilizare.

2. Decembrie 2017

Client: Universitatea Tehnica al Moldovei


Bunuri: **HeCd laser de laborator cu accesorii**

Suma contractului: 573 600,00 lei, inclusiv TVA

Director SA "Eximotor"



Socolova Natalia



05.11.2020

Către IP Institutul Național de Metrologie


GARANȚIE ASUPRA PRODUSULUI

Prin prezenta, SA "Eximotor" în persoana directorului Socolova Natalia, întru participarea în licitația cu Nr. ocde-b3wdp1-MD-1603439767696 din 06 noiembrie 2020 declară, că perioada de garanție pentru echipamentul de masurare a greutății - Balante cu capcana pentru etalonarea pipetelor de producție Radwag este de 24 luni din data predării beneficiarului.

Director SA "Eximotor"



Socolova Natalia



FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 06.11.2020

Licitația nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1603439767696** Cod CPV: 38300000-8

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: IP Institutul Național de Metrologie

SA Eximotor declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

b) SA Eximotor se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii –
Mijloace de masurare: Echipament de masurare a greutatii - Balante cu capcana pentru etalonarea pipetelor 2..

Suma Lot 1 – 570 000,00 lei (fara TVA) , 684 000,00 lei (cu TVA)

TOTAL: 570 000,00 lei (fara TVA) , 684 000,00 lei (cu TVA)

c) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

d) În cazul acceptării prezentei oferte, Eximotor SA se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în c onformitate cu punctul IPO5.4.

f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat: _____

Nume: Socolova Natalia

În calitate de: director

Ofertantul: SA Eximotor

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15 of. 6

Data: 06.11.2020



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 3 din 23.10.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Balanță cu capacă pentru etalonarea pipetelor	MYA 21.4Y.P Microbalance	Polonia	RADWAG	Domeniu de aplicare Preluarea, conservarea și transmiterea unității de măsură a masei și etalonarea pipetelor (dozatoarelor de volum) Interval minim de măsurare 0 ÷ 6,0 g Valoare diviziunii 1 µg Incertitudine de măsurare U < 1 µg Tensiunea de alimentare 230V AC Conexiune PC RS-232 sau USB	Parametrele propuse sunt anexate Balanța se propune în set cu adaptorul pentru pipete MY11	



Componente indispensabile		-Capcană de aburi. -Pompă de absorbție. -Soft specializat pentru afișarea și prelucrarea datelor de măsurare. -Cablu de alimentare. -Conductoare de conectare la PC. -Cutie de transportare. -Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței.	
Instalare		I. Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie).	Instalarea va fi efectuată de producător din contul furnizorului (în laboratorul INM).
Trasabilitate		II. Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de un Institut Național de Metrologie, semnat al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la nivel internațional.	Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare, emis de PCA (Centrul Po-lonez de Acreditatie), membru al CIPM MRA
Training		Furnizorul va asigura training pentru minimum două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului. Va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor.	Pretul include training pentru două persoane și demonstrarea funcționării.
Garanție		III. Minimum 2 ani din data punerii în funcțiune.	Garanție 24 luni dn data punerii în funcție



Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor	XA 82/220.4Y.A Polonia PLUS Analytical Balance	RADWAG	Documentație	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.	Documentația va fi în una din limbile solicitate
			Domeniu de aplicare	Preluarea, conservarea și transmiterea unității de măsură a masei și etalonarea pipetelor (dozatoarelor de volum)	Parametrele propuse sunt anexate Balanța se propune în set cu adaptorul pentru pipete XA17
Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor	XA 82/220.4Y.A Polonia PLUS Analytical Balance	RADWAG	Interval minim de măsurare	0 ÷ 100,0 g	Instalarea va fi efectuată de producător din contul furnizorului (în laboratorul INM).
			Valoare diviziunii	10 µg	
			Incertitudine de măsurare	U < 10 µg	
			Tensiunea de alimentare	230V AC	
			Conexiune PC	RS-232 sau USB	Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare, emis de PCA (Centrul Polonez de Acreditare), membru al CIPM MRA
			Componente indispensabile	-Capcană de aburi.	
				-Pompă de absorbție.	
				-Soft specializat pentru afișarea și prelucrarea datelor de măsurare.	
			Componente indispensabile	-Cablul de alimentare.	Pretul include training pentru două persoane și demonstrarea funcționării.
				-Conductoare de conectare la PC.	
				-Cutie de transportare.	
				-Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței.	
Trasabilitate			Instalare	I. Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie).	Garantie 24 luni dn data punerii in funcție
			Trasabilitate	II. Echipamentul va fi însoțit de certificat de	Documentația va fi în una din limbile solicitate

					etalonare emis de un Institut Național de Metrologie, semnat al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la nivel internațional.	Pentru ambele poziții din Lotul 1 se oferă o (una) stație de lucru Workstation for Pipettes Calibration DUAL care include loc de instalare a doua balanțe și conține pompa de absorbiție. Descrierea amănunțită a stației de lucru se anexează. Prețul stației este inclus în ofertă.	
				Training	Furnizorul va asigura training pentru minimum două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului. Va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor.		
				Garanție	III. Minimum 2 ani din data punerii în funcțiune.		
				Documentație	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.		
Total lot 1							
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Ofertantul: SA Eximotor Adresa: Chisinau, str. Albisoara 38A



Specificații de preț (F4.2)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: 3 din 23.10.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
38300000-8	Lotul 1								MD87ML000000002251630274
	Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor	0±6,0 g	1	350 000,00 lei	420000,00 lei	350 000,00 lei	420 000,00 lei	60 zile calendaristice	
	Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor	0±100,0 g	1	220 000,00 lei	264 000,00 lei	220 000,00 lei	264 000,00 lei	60 zile calendaristice	
	Total lot 1								
	TOTAL					570 000,00 lei	684 000,00 lei		

Semnat: _____ Prenumele: Socolova Natalia în calitate de: Director

Ofertantul: SA Eximotor Adresa: Chisinau, str. Albisoara 38A



ORDIN DE PLATA		nr.	1011	DATA EMITERII	04 11 2020	TIP.DOC. 1
PLATITI	12000.00	LEI	Douasprezece Mii lei 00 bani			
PLATITOR (R) "EXIMOTOR" S.A.		Cod IBAN	MD38ML000000022512092160			
		CODUL FISCAL	1002600034712			
PRESTATORUL PLATITOR suc. "Centru"				CODUL BANCII	MOLDMD2X309	
BENEFICIAR (R) "INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE" I.P.		Cod IBAN	MD87ML000000002251630274			
		CODUL FISCAL	1013600006135			
PRESTATORUL BENEFICIAR suc. "Zorile"				CODUL BANCII	MOLDMD2X330	
DESTINATIA PLATII	Plata pu garantia pu oferta la procedura de achizitie publica nr 3 din 23.10.2020.			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT ☐ N ☐ U L.S.		
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII		SEMNATURILE EMITENTULUI		
001	04 11 2020	04 11 2020 11:21:10				
SEMNATURA PRESTATORULUI				B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A. mun. Chisinau EX 04 noiembrie 2020 MD-2012, Republica Moldova Strada Chisinau, 50. APT. 100/100A, 30.		

Digitally signed by Extras
 Date: 2020.11.05 16:43:52 +02:00
 Reason: MICO Extract
 Location: Moldova Chisinau



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2027231 / **1263** din 02.11.2020
№ от

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование EXIMOTOR S.A.	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер 1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) Aerodromului nr.15 of.6	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта 0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.11.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DGACM

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **E. Cojocaru, tel. 82-34-26**
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Nina GHENCIU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.11.2020 ora 14:22:29
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Data prezentării 29.05.2020 18:13:53

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: EXIMOTOR S.A.Sediul: Aerodromului nr.15 of.6Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: Aerodromului nr.15 of.6Cod postal: 2024Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANIActivitatea principală: G4532, Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehiculeForma proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuniCod CUIO: 37541535Codul fiscal: 1002600034712

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Bezrucico NadejdaTelefon: +37322407545Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 99 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	229090295	280341372
Alte venituri din activitatea operațională	020	164601	596627
Venituri din alte activități	030	6119478	12811294
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	235374374	293749293
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	200875723	248149636
Cheltuieli privind stocurile	070	6487055	7706383
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3905495	5063517
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1092759	1222688
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3312384	3590547
Alte cheltuieli	110	3556021	3213522
Cheltuieli din alte activități	120	6978032	13189307
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	226207469	282135600
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	9166905	11613693
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	916492	1363659
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	8250413	10250034



BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	35456	33707
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	735326	90173
	Terenuri	030	2333912	6372191
	Mijloace fixe	040	46899819	50913004
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	50004513	57409075
2.	Active circulante			
	Materiale	140	164770	125631
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	35730	42242
	Produsul în curs de execuție și produse	170		
	Marfuri	180	45682182	60941851
	Creanțe comerciale	190	38209540	37621290
	Creanțe ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9468952	10929786
	Creanțe ale bugetului	220	2135163	2543746
	Creanțe ale personalului	230	314	
	Alte creanțe curente	240	1307	982
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4017221	1902858
	Alte elemente de numerar	260		7977
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	840	806
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	36948	41771
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	99752967	114158940
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	149757480	171568015



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	20000	20000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	14732
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	54382667	54382667
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	10250034
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	54402667	64667433
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	11258930	18184590
	Împrumuturi pe termen lung	410	29656846	29656846
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	40915776	47841436
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3703727	3780009
	Datorii comerciale	470	38573738	41833090
	Datorii față de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	11673184	12882545
	Datorii față de personal	500	1577	83945
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	131589	192009
	Datorii față de buget	520	355222	287548
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	54439037	59059146
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	149757480	171568015

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

1 Indicatori	2 Cod rd.	3 Perioada de gestiune precedenta	4 curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	229090295	280341372
Costul vânzării	020	200875723	248149636
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	28214572	32191736
Alte venituri din activitatea operațională	040	164601	596627
Cheltuieli de distribuție	050	12379367	14732534
Cheltuieli administrative	060	2418326	2880830
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3556021	3183293
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10025459	11991706
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-858554	-378013
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	9166905	11613693
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	916492	1363659
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	8250413	10250034

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	20000			20000
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20000			20000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	24586	9854	14732
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	120	54382667			54382667
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	10250034		10250034
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	54382667	10274620	9854	64647433
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	54402667	10274620	9854	64667433

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	270104884	335773714
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	189731435	329240525
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	4988806	6207516
Dobinzi platite	040	2019324	2067605
Plata impozitului pe venit	050	1666970	1058582
Alte incasari	060	162099980	1325304
Alte plati	070	226542397	7390408
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7255932	-8865618
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	65198	6092583
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		5795380
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	65198	297203
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	63337964	119899686
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	68162069	112896763
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		



Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4824105	7002923
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2497025	-1565492
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-88880	-540894
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1609076	4017221
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4017221	1910835

Date generale

Anexa 6

- Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
Numar de înregistrare 1002600034712 Data înregistrării 12.06.1995 Seria MO Numar 1131112
- Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
data 12.06.1995, suma 20000 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota debitorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificări ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indica:
Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 96 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 20 persoane,
 - muncitori 72 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 92 persoane.
- Remunerarea personalului entității in perioada de gestiune 5063517 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabilă lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 20000 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 431171 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	309379	978	978
2	121792	643	643

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabilă

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii



Anexa 9

Tabelul 1

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600034712, denumire: EXIMOTOR S.A.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 29.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2020 18:13:53





www.radwag.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. 63/2/18/EN)

1	Non-automatic weighing instrument Instrument model: MYA xx.4Y ; MYA xx.4Y.P ; MYA xx.4Y.F ; MYA xx.4Y.F1 UYA xx.4Y ; UYA xx.4Y.F	
2	Manufacturer: RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski Address: POLAND, 26-600 Radom, 5 Toruńska Street	
3	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer	
4	-	
5	The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:	
6	Directive	Harmonised Standards
	2014/30/EU	EN 61326-1:2013
	2014/35/EU	EN 61010-1:2010
	<i>Balance with CE mark featuring supplementary metrological marking (capital letter M and two last digits of the year when metrological marking was applied) and Notified Body no. additionally adhere to:</i>	
	2014/31/EU	EN 45501
7	Notified Body no. 1383, Czech Metrology Institute, performed EC type-examination and issued the certificate: EC type-approval certificate no. TCM 128/15-5342	
8	Additional information: The manufacturer's Quality System accordant with module D is under the supervision of Notified Body no. 1383, Czech Metrology Institute	

Signed for and on behalf of:

The Managing Director of RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE – *Dr. Witold Lewandowski*

Radom 07.05.2018

.....
Place and date of issue

Jacek Pilecki, *Manager of Quality Control Department*

.....
Name, Position



J. Pilecki
.....
Signature



www.radwag.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. 66/1/19/EN)

1	Non-automatic weighing instrument Instrument model: XA xxx.4Y PLUS ; XA xxx.4Y.A PLUS ; XA xxx.4Y.M PLUS ; XA xxx.4Y.M.A PLUS ; XA xxx.4Y.M.A.P PLUS ; XA xxx.4Y.A ; XA xxx.4Y.F ; XA xxx.4Y.M.A	
2	Manufacturer: RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski Address: POLAND, 26-600 Radom, 5 Toruńska Street	
3	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer	
4	-	
5	The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:	
6	Directive	Harmonised Standards
	2014/30/EU	EN 61326-1:2013
	2014/35/EU	EN 61010-1:2010
	<i>Balance with CE mark featuring supplementary metrological marking (capital letter M and two last digits of the year when metrological marking was applied) and Notified Body no. additionally adhere to:</i>	
	2014/31/EU	EN 45501
7	Notified Body no. 1383, Czech Metrology Institute, performed EC type-examination and issued the certificate: EC type-approval certificate no. TCM 128/15-5342	
8	Additional information: The manufacturer's Quality System accordant with module D is under the supervision of Notified Body no. 1383, Czech Metrology Institute	

Signed for and on behalf of:

The Managing Director of RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE – *Dr. Witold Lewandowski*

Radom 20.12.2019

.....
Place and date of issue

Jacek Pilecki, *Manager of Quality Control Department*

.....
Name, Position



J. Pilecki
.....
Signature

MYA 4Y.P Microbalances

The most precise and comfortable calibration and volume control of the piston pipettes



Automatically opened weighing chamber



Weighing chamber with an adapter for pipettes calibration


Functions



Parts counting




Percent weighing



Pipettes calibration



GLP procedures



Ambient conditions measurement




Dosing



Statistics



Statistical quality control




Proximity sensors



Replaceable unit



Checkweighing



Animal weighing



Autotest



automatic lid opening



Multilingual menu



Formulations



Differential weighing

Features

Pipettes Volume Control Compliant with ISO 8655

Special adapter located in the weighing chamber enables verifying the volume of piston pipettes with use of gravimetric method. Evaporation ring limits liquid vaporization which significantly improves measurement accuracy.

2 in 1 Functionality

The MYA 4Y.P microbalances have been designed to allow pipettes calibration, however they offer full functionality typical for devices that are used to carry out standard mass measurement processes.

Significantly Fast Measurement

Powerful processor offers new possibilities of operation assuring both short indication stabilization time and repeatability.

Intuitive Operation and Touch Screen

5.7" colour touch screen enables intuitive operation and easy access to numerous applications and functions of the weighing instrument.

Automatic Level Control

Leveling system facilitates adjustment of device level, it also uninterruptedly controls the level state, and informs about potential level deviations.

Automatic Weighing Chamber

The system controlling weighing chamber opening enables quick access to the weighing pan. Proximity sensors allow you to open and close the weighing chamber touch-free.

Numerous Options of Data Management

Extensive storage capacity enables record of all measurement data in a form of complex reports and statistical graphs.

ALIBI Memory

Data security and protection is provided by ALIBI memory which automatically archives all carried out measurements.



Technical Specifications

	MYA 21.4Y.P
Maximum capacity [Max]	21 g
Minimum load	100 µg
Readability [d]	1 µg
Verification scale interval [e]	1 mg
Tare range	-21 g
Standard values	
Repeatability (5% Max)*	1 µg
Repeatability (Max)*	3 µg
Minimum weight (USP)	2 mg
Minimum weight (U=1%, k=2)	0,2 mg
Permissible values	
Repeatability (5% Max)*	1,6 µg
Repeatability (Max)*	4 µg
Linearity	±7 µg
Eccentric load deviation	7 µg
Stabilization time	max 10 s
Adjustment	internal
Verification	Yes
OIML Class	I
Indicator fastening	35 cm cable, wireless connection (option)***
Display	5.7" colour, resistive touch screen
Keypad	8 keys
Protection class	IP 43
Databases	19
Touch-free operation	2 programmable proximity sensors
USB-A	2
RS 232	2
Wireless connection	802.11 b/g/n
Ethernet	10 / 100 Mbit
Power supply	13.5 ÷ 16 V DC
Power consumption	10 W
Operating temperature	+10 ÷ +40 °C
Operating temperature change rate	±0.3°C/1h (±1°C/8h)
Atmospheric humidity****	40 ÷ 80%
Relative humidity change rate	±1%/h (±4%/8h)
Transport and storage temperature	-10 ÷ +50 °C
Weighing pan dimensions	ø 26 mm
Weighing chamber dimensions	ø 90 × 90 mm
Weighing device dimensions	411 × 163 × 183 mm
Net weight	9.1 kg
Gross weight	16.6 kg
Packaging dimensions	660 × 660 × 455 mm

* repeatability is expressed as a standard deviation from 10 weighing cycles

** parameter determined in the following temperature range: +15 ÷ +35 °C


*** optional solution on purchase order **** non-condensing conditions

Values of parameters provided in Technical Specifications table have been determined under stable laboratory conditions. Due to ambient conditions impact or/and balance setup, the above parameters may vary for environments other than laboratory.




XA 4Y.A PLUS analytical balance


SYNERGY LAB Line – New quality of small mass weighing

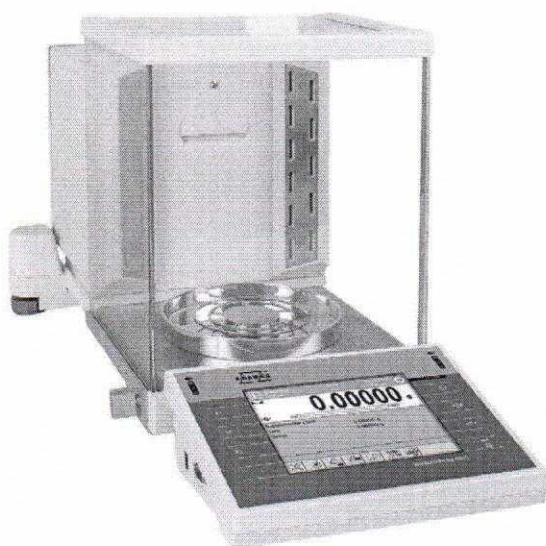


XA 4Y.A PLUS, d = 0,01 mg



Fully automatic leveling of the scale



Automatic weighing chamber door



Antistatic ionizer built into the weighings chamber



A completely detachable weighing chamber

Functions

 Parts counting	 Statistics	 Statistical quality control	 Automatic sliding door	 Ambient conditions measurement
 Dosing	 Animal weighing	 Autotest	 Cooperation with titrators	 Moveable range
 Checkweighing	 Differential weighing	 Density determination	 GLP procedures	 Replaceable unit
 Formulations	 Pipettes calibration	 Under hook weighing	 Proximity sensors	 Multilingual menu
 Percent weighing	 Compliance with 21 CFR Part 11			

Features

Reliable Results and Excellent Weighing Parameters

The best weighing parameters enable applying XA 4Y.A PLUS analytical balances in majority of demanding laboratory processes.

21 CFR Part 11 Compliance Module

XA 4Y.A PLUS balances are compliant with 21 CFR part 11 and EU GMP part 4, annex 11. This means that the XA 4Y series features numerous functions for protecting and monitoring work results of particular operators.

Smart Min Weight

With use of the „Smart Min Weight“ function, the XA 4Y.A PLUS automatically adjusts resolution of the range to the currently weighed mass. This results with improvement of the minimum sample weight parameter by 30%.

Innovative 2-Point Adjustment System

Brand new adjustment system guarantees the highest measurement accuracy. It minimizes linearity errors simultaneously providing reliable indications for the whole weighing range.

Antistatic Weighing Chamber

XA 4Y.A PLUS analytical balance is a device where the influence of electrostatics onto the weighing result has been eliminated due to use of special antistatic coating of the glass panes, and thanks to an in-built ionizer.

Ergonomic Mechanical Design

Latch-type system of weighing chamber components fastening allows fast and easy tool-free assembly/disassembly. Smart system of pressures equalization guarantees stable measurement. It eliminates errors generated by rapid change of pressure inside the weighing chamber.



Technical Specifications

	XA 52.4Y.A PLUS	XA 82/220.4Y.A PLUS	XA 110.4Y.A PLUS	XA 120/250.4Y.A PLUS
Maximum capacity [Max]	52 g	82/220 g	110 g	120/250 g
Minimum load	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
Readability [d]	0.01 mg	0.01 mg / 0.1 mg	0.01 mg	0.01 mg / 0.1 mg
Verification scale interval [e]	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
Tare range	-52 g	-220 g	-110 g	-250 g
Standard values				
Repeatability(5% Max)*	0.005 mg	0.005 mg	0.005 mg	0.005 mg
Repeatability(Max)*	0.01 mg	0.06 mg	0.02 mg	0.06 mg
Minimum weight (USP)	10 mg *****	10 mg *****	10 mg *****	10 mg *****
Minimum weight (U=1%, k=2)	1.0 mg *****	1.0 mg *****	1.0 mg *****	1.0 mg *****
Permissible values				
Repeatability(5% Max)*	0.012 mg	0.012 mg	0.012 mg	0.012 mg
Repeatability(Max)*	0.02 mg	0.08 mg	0.03 mg	0.1 mg
Linearity	±0.03 mg	±0.06 mg / ±0.2 mg	±0.06 mg	±0.06 / ±0.2 mg
Eccentric load deviation	0.03 mg	0.2 mg	0.06 mg	0.2 mg
Stabilization time	4 s	4 s	4 s	4 s
Adjustment	internal	internal	internal	internal
Moveable range	—	Yes	—	Yes
Verification	Yes	Yes	Yes	Yes
OIML Class	I	I	I	I
Indicator fastening	35 cm cable, wireless connection (option)***	35 cm cable, wireless connection (option)***	35 cm cable, wireless connection (option)***	35 cm cable, wireless connection (option)***
Display	5.7" colour, resistive touch screen	5.7" colour, resistive touch screen	5.7" colour, resistive touch screen	5.7" colour, resistive touch screen
Keypad	8 keys	8 keys	8 keys	8 keys
Protection class	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43
Databases	19	19	19	19
Touch-free operation	2 programmable proximity sensors	2 programmable proximity sensors	2 programmable proximity sensors	2 programmable proximity sensors
USB-A	2	2	2	2
Ethernet	10 / 100 Mbit	10 / 100 Mbit	10 / 100 Mbit	10 / 100 Mbit
RS 232	2	2	2	2
IN/OUT	4 x IN / 4 x OUT	4 x IN / 4 x OUT	4 x IN / 4 x OUT	4 x IN / 4 x OUT
Wi-Fi*	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Power supply	13.5 ÷ 16 V DC	13.5 ÷ 16 V DC	13.5 ÷ 16 V DC	13.5 ÷ 16 V DC
Power consumption	10 W	10 W	10 W	10 W
Operating temperature	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C
Atmospheric humidity****	20 ÷ 80 %	20 ÷ 80 %	20 ÷ 80 %	20 ÷ 80 %
Transport and storage temperature	-20 ÷ +50 °C	-20 ÷ +50 °C	-20 ÷ +50 °C	-20 ÷ +50 °C
Weighing pan dimensions	ø 90 mm open-work, ø 85 mm standard (option)*****	ø 90 mm open-work, ø 85 mm standard (option)*****	ø 90 mm open-work, ø 85 mm standard (option)*****	ø 90 mm open-work, ø 85 mm standard (option)*****
Weighing chamber dimensions	199 x 160 x 228 mm	199 x 160 x 228 mm	199 x 160 x 228 mm	199 x 160 x 228 mm
Weighing device dimensions	564 x 253 x 300 mm	564 x 253 x 300 mm	564 x 253 x 300 mm	564 x 253 x 300 mm
Net weight	14.7 kg	14.7 kg	14.7 kg	14.7 kg
Gross weight	19.1 kg	19.1 kg	19.1 kg	19.1 kg
Packaging dimensions	720 x 385 x 485 mm	720 x 385 x 485 mm	720 x 385 x 485 mm	720 x 385 x 485 mm

* repeatability is expressed as a standard deviation from 10 weighing cycles
 ** parameter determined in the following temperature range: +15 ÷ +35 °C
 *** optional solution on purchase order
 **** non-condensing conditions
 ***** ø 85 mm standard weighing pan on purchase order
 Achieved thanks to the Smart Min Weight function
 Wi-Fi* is a registered trademark of Wi-Fi* Alliance.



Adapters for Pipettes Calibration

Preventing evaporation of liquid during weighing.



XA11



MY11



XA17



XA100

Features

Specially Designed Construction

The adapter is equipped with a weighing pan of a special design that enables placing the measuring vessel centrally inside the weighing chamber. The weighing pan and the vessel are housed in a glass chamber featuring an opening allowing the user to dispense liquid through it, and reducing air drafts.

Minimization of Weighed Liquid Evaporation

Evaporation ring is an integral part of the adapter, it increases relative humidity inside the weighing chamber. With this, evaporation of the liquid during piston pipette calibration/verification is stopped.

Compatible with

MA11:

- MYA 4Y microbalances

XA11:

- XA 4Y PLUS microbalances

XA17:

- XA 4Y PLUS analytical balances

XA100:

- XA 4Y PLUS analytical balances (except for XA 52.4Y PLUS balance)
- XA 4Y.A PLUS analytical balances (except for XA 52.4Y.A PLUS balance)

Set Content

- base (for adapters for XA balances)
- weighing pan
- weighing vessel
- evaporation ring


- glass chamber with opening for dosing
- weighing pan supplementary weight (optional load for XA17 and XA100 pipette calibration adapters)




Technical Specifications

	MY11	XA11	XA17	XA100
Construction material	aluminum, glass	aluminum, glass	aluminum, glass	aluminum, glass
Weighing pan material	aluminum	aluminum	stainless steel, aluminum	stainless steel, aluminum
Volume	11ml	11ml	17ml	100ml
Overall dimensions	141 × Ø93 mm	136 × Ø99,5 mm	103 × Ø99,5 mm	160 × Ø99,5 mm
Net weight	140 g	400 g	450 g	560 g
Gross weight	400 g	800 g	850 g	1000 g


Dimensions

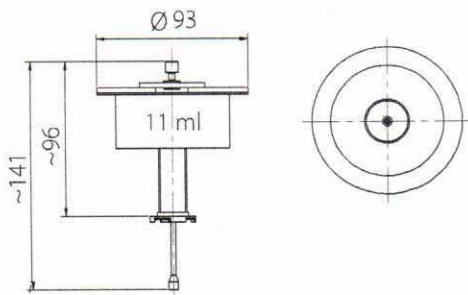


MY11

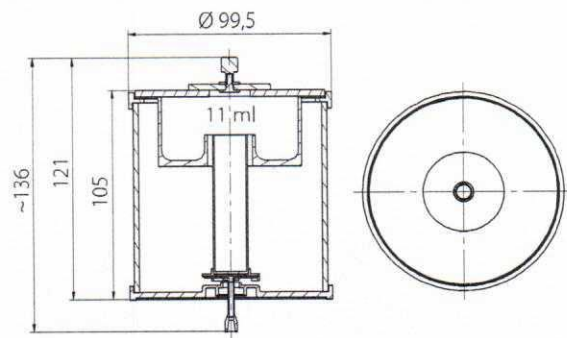

XA11

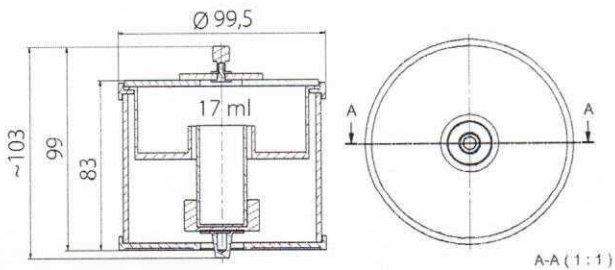

XA17

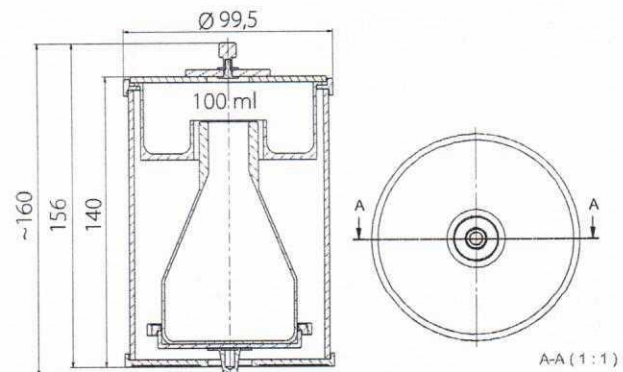

XA100

