

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: **14.01.2020**

Către: **IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)**

SA "M-INTER-FARMA" declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
 - a) SA "M-INTER-FARMA" se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **Reactivi și consumabile pentru Clinica Em. Coțaga.**
 - a) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie **1 935,19 (o mie nouă sute treizeci și cinci lei 19 bani)**
 - b) Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie **2 090,00 (două mii nouăzeci de lei 00 bani)**
- c) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
În cazul acceptării prezentei oferte, SA "M-INTER-FARMA" se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Palii Nina

În calitate de: Specialist în achiziții publice

Ofertantul: "M-INTER-FARMA" SA

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23

Data: 14.01.2020



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1577186702598 din 14.01.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi și consumabile pentru Clinica Em. Coțaga							
Co d CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prođu- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 24 Termoindicatoare și azopiram							
3310000 0-1	INDICATOR chimic (intern) 132 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii IKPS-VN în autoclave cu registre	132, (intern) Nr.1000 în set cu registru	Federația Rusa	Medtest	INDICATOR chimic (intern) 132 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii IKPS-VN în autoclave cu registre	INDICATOR chimic (intern) 132 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii IKPS-VN în autoclave cu registre	DC, aviz sanitar
3310000 0-1	INDICATOR chimic (intern) 180 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele cu registre	180 (intern) Nr.1000 în set cu registru	Federația Rusa	Medtest	INDICATOR chimic (intern) 180 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele cu registre	INDICATOR chimic (intern) 180 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele cu registre	DC, aviz sanitar
3310000 0-1	Indicator chimic 121 intern Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre	121 intern, Nr.1000 în set cu registru	Federația Rusa	Medtest	Indicator chimic 121 intern Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre	Indicator chimic 121 intern Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre	DC, aviz sanitar
3310000 0-1	AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata	p/u 100 ml solutie gata	Federația Rusa	Medtest	AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata	AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata	DC, aviz sanitar

Semnata: Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist în achizitii publice

Ofertantul: "M-INTER-FARMA" SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23



Specificații de preț (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă –

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1577186702598				Data: 14.01.2020			Alternativa nr.: nu vor fi			
Denumirea LP:Reactivi și consumabile pentru Clinica Em. Coțaga				Lot:24			Pagina: 1 din 1			
Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/p restare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	33600000-6	INDICATOR chimic (intern) 132 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizării IKPS-VN în autoclave cu registru	set	3	175,93	190,00	527,78	570,00	timp de 3 zile de la comanda cumpărătorului, pe parcursul 2020	
2	33600000-6	INDICATOR chimic (intern) 180 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizării cu aer fierbinte în poupinele cu registru	set	3	175,93	190,00	527,78	570,00	timp de 3 zile de la comanda cumpărătorului, pe parcursul 2020	
3	33600000-6	Indicador chimic 121 intern Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registru	set	1	175,93	190,00	175,93	190,00	timp de 3 zile de la comanda cumpărătorului, pe parcursul 2020	
4	33600000-6	AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata	set	4	175,93	190,00	703,70	760,00	timp de 3 zile de la comanda cumpărătorului, pe parcursul 2020	
TOTAL							1935,19	2090,00		

Semnătură:  Numele, prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist în achiziții publice

Ofertantul: "M-INTER-FARMA" SA Adresa: mun. Chisinau, str.Grenoble, 23

ORDIN DE PLATĂ		Nr. 13	DATA EMITERII	3 Ianuarie 2020	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	20-00	LEI			
PLĂTITOR: (R)SA M-Inter-Farma		CODUL IBAN	MD37EN000000022245246845		
		CODUL FISCAL	1003600005263		
PRESTATORUL PLĂTITOR:	BC ENERGBANK SA				
BENEFICIAR: (R)Institutul Mamei si Copilului IMSP		CODUL IBAN	MD91ML000000000225152859		
		CODUL FISCAL	1003600151643		
PRESTATORUL BENEFICIAR:	BC MOLDINDCONBANK SA Chisinau				
DESTINAȚIA PLĂȚII: Garantia pt oferta la procedura ocd s-b3wdp1-MD-1577186702598 din 01.20.20. Fara TVA. Fara TVA			TIPUL TRANSFERULUI	<input type="checkbox"/> NORMALURGENT <input checked="" type="checkbox"/> N	
			Semnatura electronica MOLDSIGN Maria (R)Morozov 03-01-2020 12:44:16		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII			
	ORA PRIMIRII *				
MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURA PRESTATORULUI		BC ENERGBANK SA Status: EXECUTAT 03-01-2020 12:45:06 L.Ș.	

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată *





Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 13/01-08/68
din « 14 » ianuarie 2012

“M-Inter-Farma” S.A.
MD-2028, mun. Chișinău,
str. Grenoble, 23

Prin prezenta B.C. „ENERGBANK” S.A. (codul băncii ENEGMD22) confirmă că
“M-Inter-Farma” S.A., cod fiscal 1003600005263 deține contul IBAN
MD37EN000000022245246845 în MDL, USD, EUR, RUB, UAH, GBP, CHF. .

Prezentul certificat este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Șef Secția Deservire Clienți DOB

Marcela Antoniu





S.A. M-INTER-FARMA

IDNO 1003600005263 Cod OKPO 37020536 Cod TVA 0207934

MD 2025, Chișinău, strada Grenoble 23

Tel 00 373 22/90-40-06, 90-40-07, 90-40-05


Nr. 07 din 14 ianuarie 2020

Către
IMSP Institutul Mamei și Copilului
Grupul de lucru la licitația publică nr.
ocds-b3wdp1-MD-1577186702598

DECLARAȚIA

Prin prezenta "M-INTER-FARMA" SA, confirmă că, va prezenta mostre produselor, oferite în cadrul procedurii de achiziții publice **ocds-b3wdp1-MD-1577186702598 privind " Reactivi și consumabile pentru Clinica Em. Coțaga"** la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile.

Cu respect,
Director "M- INTER-FARMA" SA

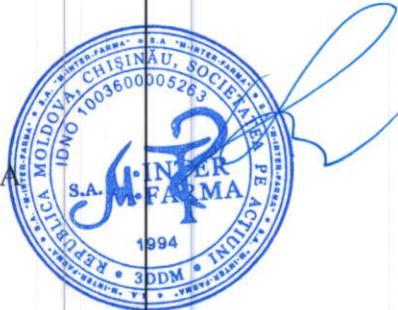

Morozov Maria



S.A. M-INTER-FARMA

IDNO 1003600005263 Cod OKPO 37020536 Cod TVA 0207934
MD 2025, Chișinău, strada Grenoble 23
Tel 00 373 22/90-40-06, 90-40-07, 90-40-05

Nr. 08 din 14 ianuarie 2020

Către
IMSP Institutul Mamei și Copilului
Grupul de lucru la licitația publică nr.
ocds-b3wdp1-MD-1577186702598

DECLARAȚIA

Prin prezenta "M-INTER-FARMA" SA, confirmă că, va prezenta actele conform DUAЕ la procedura de achiziții publică **ocds-b3wdp1-MD-1577186702598** privind "Reactivi și consumabile pentru Clinica Em. Coțaga" la solicitarea autorității contractante.

Cu respect,
Director "M- INTER-FARMA" SA



Morozov Maria

MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LJ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-2283/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "25" iulie a./e. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Reactivi de diagnostic – Azopiram pentru 100 ml soluție gata, indicatori pentru controlul sterilității,
пачете pentru sterilizare anexa!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Indicații Metodice nr.29 FȚ/1683 din 14.05.01, Directiva Europeană 93/42/EEC privind
dispozitivele medicale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Federația Rusă, ZAO "MEDTEST"

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„M-INTER-FARMA” SA, Moldova, Chișinău, str. Grenoble, 23

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.01/KIII din 11.04.2018, facturi, pașapoarte de conformitate, legitimații de înregistrare
aviz sanitar nr.571 din 16.07.2018, raport a încercărilor de laborator nr. 4226 din 22.07.2019
(a enumeră documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 4226 din 22.07.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

scopuri medicinale

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 iulie 2019

Int. DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ



Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

10-XVI-09



ANSP/HA03

0004837

03



ООО «Санкт-Петербургское Общество Естествоиспытателей»
 НПЦ «Эко-Сервис»
 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
 Тел./факс (812) 702-10-44, 450-67-79 www.ecoservice-spb.ru
 ПАСПОРТ №47

Набор реагентов для контроля качества
 предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
 «Азопирам-СК»
 Кат.№ В-50101

Серия № 0419
 Годен до 04.2021

Хранение и транспортирование
 при 18-25°C

Показатели качества

Показатель	Требования по ТУ	Результаты анализа
1. Внешний вид		
1.1. Амидопирин	Порошок белого цвета	Соответствует
1.2. Стабилизатор	Бесцветная прозрачная жидкость	Соответствует
1.3. Анилин солянокислый	Порошок белого цвета	
2. Технические характеристики		
2.1. Чувствительность, положительная реакция при разведении крови, не менее	1 : 100 000	Соответствует
2.2. Время выхода на устойчивые показания, мин., не более	1	Соответствует

Заключение: Набор соответствует требованиям ТУ 9398-248-27511906-02

Дата составления паспорта:

ОТК
 19.04.19



ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
Индикатор химический одноразового применения
для контроля процессов стерилизации
"Медтест"-134°C/20 мин, класс 4

НРИМ.932621.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2012/13342 от 12.12.2017

Серия № **060919**

ТУ 9398-014-53262326-2012


Дата изготовления **09 2019**

№ п/п	Показатели	Требования ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие внешнего вида индикатора	1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.10., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16.	соответствует
2	Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки	1.3., 1.4.6., 1.4.7.	соответствует
3	Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора	1.2.20.	соответствует
4	Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния	1.2.20.	соответствует
5	Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе	1.2.21.	соответствует
6	Срок годности	1.2.44. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует


Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-014-53262326-2012, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

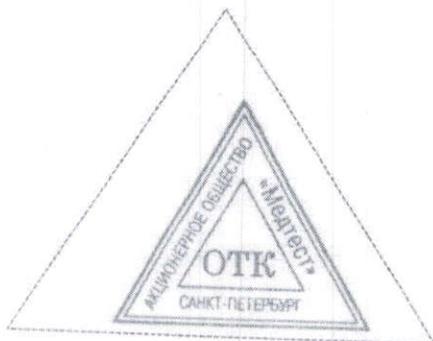


Начальник ХТУ

 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил
Начальник производства

 А.Е. Хорев



ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
Индикатор химический одноразового применения
для контроля процессов стерилизации
"Медтест"-134°C/18 мин, класс 4

НРИМ.932821.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2012/13342 от 12.12.2017 г.

Серия № **050919**

ТУ 9398-014-53262326-2012


Дата изготовления **09 2019**

№ п/п	Показатели	Требования ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие внешнего вида индикатора	1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.10., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16.	соответствует
2	Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки	1.3., 1.4.6., 1.4.7.	соответствует
3	Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора	1.2.20.	соответствует
4	Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния	1.2.20.	соответствует
5	Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе	1.2.21.	соответствует
6	Срок годности	1.2.44. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

Заключение:


Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-014-53262326-2012, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

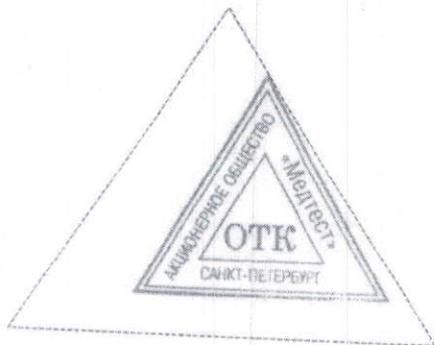


Начальник ХТУ

 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил
Начальник производства

 А.С. Щеголев



ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
 Индикатор химический одноразового применения
 для контроля процессов стерилизации
"Медтест"-134°C/4 мин
 НРИМ.932621.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2009/05786 от 14.12.2017

Серия № **040919**

ТУ 9398-008-53262326-2009

Дата изготовления **09 2019**


№ п/п	Показатели	Требования ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие внешнего вида индикатора	1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.9., 1.2.11., 1.2.16.	соответствует
2	Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки	1.3., 1.4.6., 1.4.7.	соответствует
3	Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора	1.2.20., 1.2.24.	соответствует
4	Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния	1.2.24.	соответствует
5	Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в насыщенном паре	1.2.25., 1.2.27.	соответствует
6	Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе	1.2.22., 1.2.26.	соответствует
7	Срок годности	1.2.32. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний


Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-008-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.


Начальник ХТУ



 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
 Начальник упаковочного участка


 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил
 Начальник производства


 А.Е. Корев

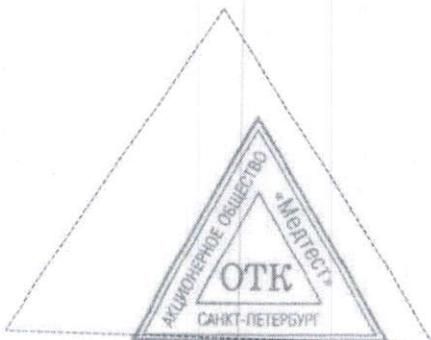

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

**Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации
 комбинированный самоклеящийся плоский ПСПВ-СтериМаг**

НРИМ.932719-003ПС

Код/типоразмер (мм):
 ПСПВ-СтериМаг


60x100; 75x150; 75x200; 90x170; 90x180; 90x230; 90x250;
100x200; 100x210; 100x250; 100x300; 100x320; 100x400;
100x500; 115x200; 115x245; 130x250; 130x270; 130x370;
140x200; 140x250; 140x390; 150x250; 150x280; 150x300;
150x350; 150x400; 150x600; 190x330; 190x340; 200x300;
200x330; 200x400; 230x280; 230x350; 250x320; 250x360;
250x400; 250x440; 250x500; 300x390; 300x400; 300x430;
300x450; 300x500; 300x600; 350x400; 350x470; 350x500;
350x600; 400x600; 450x500; 450x550; 500x600

Номер гос.
 регистрации:
 № ФСР 2010/08882
 от 06.09.2017 г.
 ТУ 9398-011-
 53262326-2010

Серийный выпуск.
 Дату изготовления смотри на упаковке.

№ п/п	Показатели	Пункты требований ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие внешнего вида	1.2.2. 1.2.3. 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8.	соответствует
2	Маркировка	1.4.5.	соответствует
3	Соответствие состава комплекту НТД	1.3.	соответствует
4	Проверка устойчивости /совместимости/ к факторам стерилизации	1.2.13.	соответствует
5	Проверка сохранности микробного барьера	1.2.14.	соответствует
6	Соответствие цветов начального, конечного состояний индикаторной метки	1.2.4.	соответствует
7	Срок годности при хранении:	60 месяцев с даты изготовления	соответствует

Заключение:
 Продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

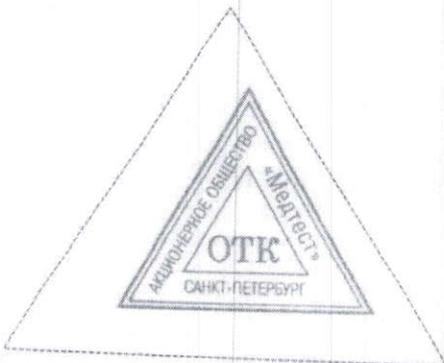

Отпуск разрешил
 Начальник ХТУ

Комплектацию в соответствии
 с заказ - нарядом проверил
 Начальник упаковочного участка

Отпуск разрешил
 Начальник производства

[Handwritten signature]
 Воронницкая М.А.
[Handwritten signature]
 Нецаева И.И.
[Handwritten signature]
 Хорев А.Е.

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
 Индикатор химический одноразового применения
 для контроля процессов стерилизации
"Медтест"-134°C/7 мин
 НРИМ.932621.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2009/05786 от 14.12.2017

Серия № **130919**

ТУ 9398-008-53262326-2009

Дата изготовления **09 2019**


№ п/п	Показатели	Требования ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие внешнего вида индикатора	1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.9., 1.2.11., 1.2.16.	соответствует
2	Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки	1.3., 1.4.6., 1.4.7.	соответствует
3	Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора	1.2.20., 1.2.24.	соответствует
4	Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния	1.2.24.	соответствует
5	Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в насыщенном паре	1.2.25., 1.2.27.	соответствует
6	Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе	1.2.22., 1.2.26.	соответствует
7	Срок годности	1.2.32. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, поверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний


Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-008-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.


Начальник ХТУ

 М.А. Воротницкая


Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
 Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаяева

Отпуск разрешил
 Начальник производства

 А.Е. Хобрев



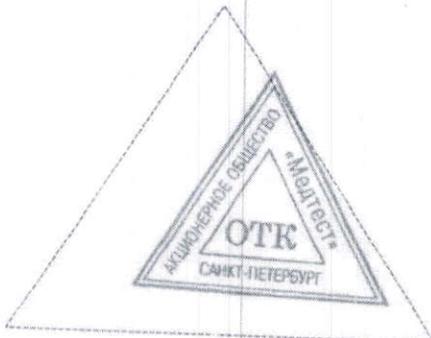

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
 Индикатор химический одноразового применения
 для контроля процессов стерилизации
"Медтест"-134°C/5 мин
 НРИМ.932821.005 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации №ФСР 2009/05786 от 14.12.2017

Серия № **240919**

ТУ 9398-008-53262326-2009


Дата изготовления **09 2019**

№ п/п	Показатели	Требования ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие внешнего вида индикатора	1.2.1., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.9., 1.2.11., 1.2.16.	соответствует
2	Соответствие состава упаковки, комплекту НТД, маркировки	1.3., 1.4.6., 1.4.7.	соответствует
3	Соответствие цветовой гаммы термоиндикаторной и цветовой меток индикатора	1.2.20., 1.2.24.	соответствует
4	Соответствие в условиях гарантированного достижения конечного состояния	1.2.24.	соответствует
5	Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в насыщенном паре	1.2.25., 1.2.27.	соответствует
6	Проверка несоответствия в условиях недостижения конечного состояния в сухом горячем воздухе	1.2.22., 1.2.26.	соответствует
7	Срок годности	1.2.32. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, проверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-008-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

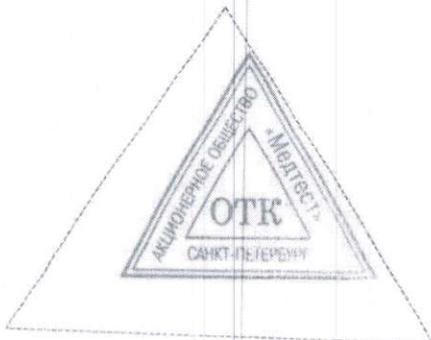

Начальник ХТУ

[Signature]
 М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
 Начальник упаковочного участка

[Signature]
 И.Н. Печенева

[Signature]
 А.Е. Хорев

Отпуск разрешил
 Начальник производства

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
Индикатор химический одноразового применения для контроля
паровой стерилизации ИКПС-ВН/01-"Медтест"-132/20

132 (±2)°С / 20 мин. (+2) мин.

(параметры режима)

НРИМ.932719.005ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/09764 от 26.08.2018г.

ТУ 9398-003-53262326-2006

Серия № 240919

Дата изготовления 09 2019

№ п/п	Показатели	Номера пунктов требований ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие состава комплекту НТД	1.2.1., 1.2.3., 1.3.1., 1.5.2	соответствует
2	Маркировка	1.4.	соответствует
3	Соответствие габаритных размеров, внешнего вида	1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10.	соответствует
4	Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов в условиях отсутствия пара	1.2.17.	соответствует
5	Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях	1.2.14., 1.2.15., 1.2.16	соответствует
6	Срок годности	1.2.21. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

Начальник ХТУ


М.А. Воротницкая


Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
Начальник упаковочного участка


И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил
Начальник производства


А.Е. Копеев



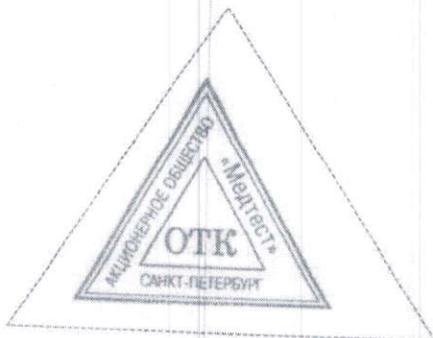

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
Индикатор химический одноразового применения для контроля
паровой стерилизации ИКПС-ВН/01-"Медтест"-120/45

120 (+2)°C / 45 мин. (+3) мин.

(параметры режима)

НРИМ.932719.005ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/09764 от 26.03.2018г.

Серия № 060919

ТУ 9398-003-53262326-2006


Дата изготовления 09 2019

1	Показатели	Номера пунктов требований ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие состава комплекту НТД	1.2.1., 1.2.3., 1.3.1., 1.5.2	соответствует
2	Маркировка	1.4.	соответствует
3	Соответствие габаритных размеров, внешнего вида	1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10.	соответствует
4	Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов в условиях отсутствия пара	1.2.17.	соответствует
5	Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях	1.2.14., 1.2.15., 1.2.16	соответствует
6	Срок годности	1.2.21. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, проверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:


Продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

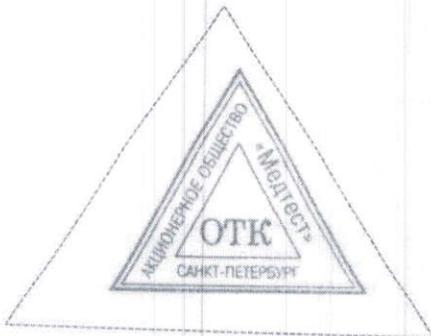


Начальник ХТУ

 М.А. Воронницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
Начальник упаковочного участка

 И.Н. Нечаева

Отпуск разрешил
Начальник производства

 А.Е. Хорев



ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический
для контроля паровой стерилизации ИКПС-"Медтест"-120/45

ИКПС-120 (+2)°С – 45 мин. (+3) мин.

(параметры режима)

НРИМ.932719.007ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/06854 от 26.03.2018г.

Серия №

070919

ТУ 9398-001-53262326-2009

Дата изготовления


09 2019

№ п/п	Показатели	Пункты требований ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие состава комплекту НТД	1.3.1.	соответствует
2	Маркировка	1.4.	соответствует
3	Соответствие внешнего вида, окраски эталона	1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.-1.2.5., 1.2.7., 1.2.13., 1.2.18., 1.2.21.	соответствует
4	Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов	1.2.17., 1.2.21.	соответствует
5	Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях	1.2.18.	соответствует
6	Срок годности	1.2.25. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-001-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

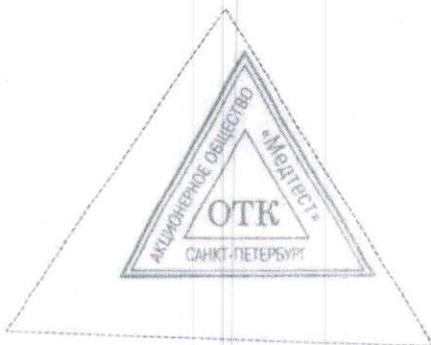

Начальник ХТУ

[Signature]
М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
Начальник упаковочного участка

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Отпуск разрешил
Начальник производства



ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический

для контроля воздушной стерилизации ИКВС-"Медтест"-180/60

ИКВС-180 (± 3)°C – 60 мин. (+5) мин.

(марка, параметры, режимы)

НРИМ.932719.008 ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/06854 от 26.03.2018 г.

Серия № **250919**

ТУ 9398-001-53262326-2009


Дата изготовления **06 2019**

№ п/п	Показатели	Требования ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие состава комплекту НТД	1.3.1.	соответствует
2	Соответствие маркировки, упаковки	1.4., 1.5.	соответствует
3	Соответствие внешнего вида индикаторов	1.2.1., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.12., 1.2.13., 1.2.14.	соответствует
4	Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов в условиях отсутствия пара	1.2.17.	соответствует
5	Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях	1.2.18., 1.2.19., 1.2.21.	соответствует
6	Срок годности	1.2.25. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, ТУ 9398-001-53262326-2009, ГОСТ ISO 11140-1-2011, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

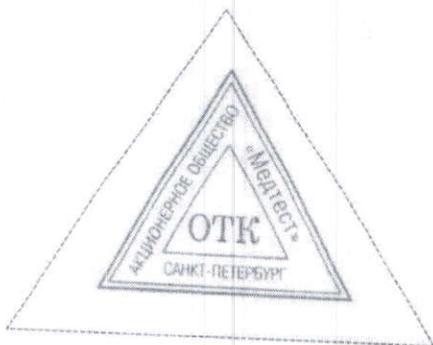

Начальник ХТУ

[Signature] М.А. Воротницкая

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
 Начальник упаковочного участка

[Signature] К.Н. Печенева

Отпуск разрешил
 Начальник производства

[Signature] А.В. Хорев



ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
 Индикатор химический
 для контроля паровой стерилизации ИКПС-"Медтест"-132/20
ИКПС-132 (± 2) $^{\circ}$ C – 20 мин. (+2) мин.
 (параметры режима)

НРИМ.932719.007ПС

Класс исполнения по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – 4 (многопеременные)

Номер гос. регистрации № ФСР 2010/06854 от 26.03.2018г.

Серия №

190919

ТУ 9398-001-53262326-2009

Дата изготовления


09 2019

№ п/п	Показатели	Требования ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие состава комплекту НТД	1.3.1.	соответствует
2	Маркировка	1.4.	соответствует
3	Соответствие внешнего вида, окраски эталона	1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.-1.2.5., 1.2.7., 1.2.13., 1.2.18., 1.2.21.	соответствует
4	Устойчивость к воздействию стерилизующих факторов	1.2.17., 1.2.21.	соответствует
5	Соответствие эксплуатационных качеств индикаторов в регламентных значениях	1.2.18.	соответствует
6	Срок годности	1.2.25. 36 месяцев с даты изготовления	соответствует

Испытания, поверки проведены в объеме предъявительских испытаний

Заключение:

продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

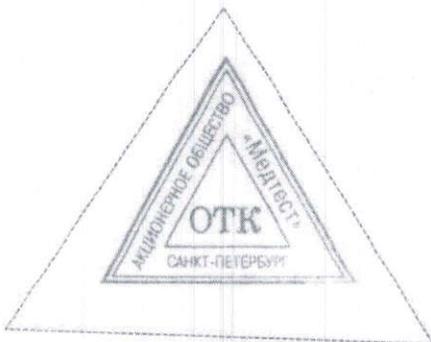

Начальник ХТУ

Комплектацию в соответствии с заказ - нарядом проверил
 Начальник упаковочного участка

Отпуск разрешил
 Начальник производства

(Signature)
 М.А. Воротницкая

(Signature)
 М.А. Мечасова

(Signature)
 А.А. Хорев