

Formularul ofertei (F3.1)

Data: "25" iulie 2020

Licitația Nr.: 21025594

Alternativa Nr.: *nu sunt*

Către: AGENTIA NATIONALA pentru SANATATE PUBLICA

"GBG-MLD" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) "GBG-MLD" SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: - Denumirea- echipament medical
- c) **Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 615 395,00**
[sase sute cincisprezece mii trei sute nouazeci si cinci] Lei 00 bani.
- d) **Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 738 474,00**
[sapte sute treizeci si opt mii patru sute saptezeci și patru] Lei 00 bani.
- e) Prezentă ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, "GBG-MLD" SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7.** pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____ L.Ș.

Nume: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65 of. 607

Data: "25" iulie 2020

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: "25" iulie 2020

Licitația Nr.: 21025594

Pagina 1 din 2

A. Ofertanți individuali

	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	„GBG-MLD., SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	Mun. Chisinau, str. Tighina 65, of. 607
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Persoană juridică
	<i>Proprietate</i>	Privată
	<i>Formă de organizare juridică</i>	Societate cu Răspundere Limitată
	<i>Altele</i>	-
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	06.01.1995
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	<i>Agent local/Distribuitoare al producătorului străin</i>	Distribuitoare
	<i>Intermediar</i>	-
	<i>Companie de antrepozit</i>	-
	<i>Altele</i>	-
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	<i>Numele</i>	Tudor Ceaicovschi
	<i>Locul de muncă și funcția</i>	„GBG-MLD., SRL, Director
	<i>Adresa</i>	Mun. Chisinau, str. Tighina 65, of. 607
	<i>Telefon / Fax</i>	022 54 73 73
	<i>E-mail</i>	office@gbg.md
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0205086
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	Nu este cazul
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA3.</i>
	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și	25 ani

	servicii	
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	"Nu se aplică"
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	"Nu se aplică"
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	"Nu se aplică"
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	"Nu se aplică"
	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: <i>Se anexează pentru a.2019</i>	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: <i>Denumirea: BC „Moldova – Agroindbank,, SA, fil. M. Eminescu</i> <i>Adresa: Mun. Chisinau, str. Tighina 49</i> <i>Telefon: 022 54 88 49</i> <i>Fax: 022 54 88 49</i>	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	-	-
	-	-
	Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	-	-
	-	-
<i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i>		
	-	
	-	
	-	
	-	

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziții 21025594 din 25.07.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Cod ECO /IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 8								
33100000-1	Baie cu apă de laborator digitală cu 6 ochiuri	buc	2	11805,00	14166,00	23610,00	28332,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 10								
33100000-1	Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0-1000° grade		1	47165,00	56598,00	47165,00	56598,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 12								
33100000-1	Dozator	buc	4	1950,00	2340,00	7800,00	9360,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 13								
33100000-1	Dozator	buc	9	1950,00	2340,00	17550,00	21060,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 14								
33100000-1	Dozator	buc	1	1950,00	2340,00	1950,00	2340,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 16								
33100000-1	Dozator	buc	1	7000,00	8400,00	7000,00	8400,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 22								

33100000- 1	Centrifuga de laborator, cu rotor 12x15ml, viteza - 100-5000 rpm	buc	1	15120,00	18144,00	15120,00	18144,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 29								
33100000- 1	Frigider de laborator cu înregistrator de temperatura	buc	8	43375,00	52050,00	347000,00	416400,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 33								
33100000- 1	Stație Elisa	buc.	1	122300,00	146760,00	122300,00	146760,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	Lotul 45								
33100000- 1	Agitator orbital	buc.	1	25900,00	31080,00	25900,00	31080,00	01.10.2020	MD34TRPBAA314 110A15826AC
	TOTAL					615395,00	738474,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65 of. 607

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21025594 din 25.07. 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 8						
	Baie cu apă de laborator digitală cu 6 ochiuri				Băile cu 6 locuri au o platformă perforată, acoperită cu capac din oțel inoxidabil Carcasa băilor este acoperită cu un strat de oțel galvanizat, vopsită epoxi, iar interiorul și cadrul băilor sunt confecționate din inox. Controlul temperaturii se realizează printr-un termostat digital, iar rezistențele de încălzire sunt prevăzute cu protecție la supraîncălzire Domeniul de temperatură: ambiant ± 5 °C până la 99,9 °C Regulatorul de nivel al apei din baie este ajustabil și este inclus în aparatul standard Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție 1 an din momentul instalării echipamentului NUVE NB 20 K 52 006 Lid with 6 holes for NB 20 (Hole dia. 95 mm)	Băile cu 6 locuri au o platformă cu inele, acoperită cu capac din oțel inoxidabil Carcasa băilor este acoperită cu un strat de oțel galvanizat, vopsită epoxi, iar interiorul și cadrul băilor sunt confecționate din inox. Controlul temperaturii se realizează printr-un termostat digital, iar rezistențele de încălzire sunt prevăzute cu protecție la supraîncălzire Domeniul de temperatură: ambiant ± 5 °C până la 99,9 °C Regulatorul de nivel al apei din baie este ajustabil și este inclus în aparatul standard Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție 1 an din momentul instalării echipamentului NUVE NB 20 K 52 006 Lid with 6 holes for NB 20 (Hole dia. 95 mm)	Certificat de Conformitate
33100000 -I		NB20	Turcia	Nuve			
	Lotul 10						

		Cuptor cu mufă - diapazon de temperatură 0-1000° grade				Tmax. grade C - 1100: Programare digitală a temperaturii și timpului Domeniul de reglare automate a temperaturii de la +150 până la min +1100 °C, încălzire din 4 parti. Materialul camerei de ardere și a usii din ceramica. volumul minim 7.0 L litri	Tmax. grade C - 1100: Programare digitală a temperaturii și timpului Domeniul de reglare automate a temperaturii de la +150 până la min +1100 °C, încălzire din 4 parti. Materialul camerei de ardere și a usii din ceramica. volumul minim 7.0 L litri	Certificat de Conformitate
33100000 -1						Dimensiuni camera mm, (200x250x140) Dimensiuni totale mm, (550x580x650) Putere, kW - 2.0 Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică Nuve MF 207 Controler MF XXX Control system with programmable steps	Dimensiuni camera mm, (200x250x140) Dimensiuni totale mm, (550x580x650) Putere, kW - 2.0 Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică Nuve MF 207 Controler MF XXX Control system with programmable steps	Certificat de Conformitate
	Lotul 12							
33100000 -1						Dozator monocal volum reglabil 20-200 mkl îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozor/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit. - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -uşurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana (Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română	Dozator monocal volum reglabil 20-200 mkl îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozor/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit. - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -uşurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana (Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba rusa	Certificat de Conformitate
	Lotul 13							
33100000 -1						Dozator monocal volum reglabil 100-1000 mkl îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozor/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit. - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -uşurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana (Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română	Dozator monocal volum reglabil 100-1000 mkl îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozor/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit. - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -uşurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana (Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba rusa	Certificat de Conformitate

	12x15ml, viteză - 100-5000 rpm				rotorului; Blocarea capacul în timpul funcționării; Senzor de dezechilibru; Semnal sonor oprire rotativă;• Deblocarea automată și deschiderea capacului după oprirea centrifugii; Reglare digitală de înaltă precizie a vitezei rotorului 1000-5000; Numărul de rotoare utilizate 1, cu 3 tipuri de adaptoare; Domeniul de temperatură admis, o Cde la +10 la +40; Zgomot maxim - nu mai mult de 55 dB; Volumul maxim de tuburi utilizate: 15 ml; Dimensiunile maxime ale tuburilor utilizate sunt: 17x155 mm. Alimentaria-220v. Asigurarea metrologică a echipamentului; Buletin de verificare metrologică inițială. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă Nuve NF200 cu rotor 12x15ml	Conformitate
	Lotul 29				rotorului; Blocarea capacul în timpul funcționării; Senzor de dezechilibru; Semnal sonor oprire rotativă;• Deblocarea automată și deschiderea capacului după oprirea centrifugii; Reglare digitală de înaltă precizie a vitezei rotorului 100-5000; Numărul de rotoare utilizate 3; Domeniul de temperatură admis, o Cde la +10 la +40; Zgomot maxim - nu mai mult de 55 dB; Volumul maxim de tuburi utilizate: 50 ml; Dimensiunile maxime ale tuburilor utilizate sunt: 30x155 mm. Alimentaria-220v. Asigurarea metrologică a echipamentului; Buletin de verificare metrologică inițială. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă	
331000000-1	Frigider de laborator cu înregistrator de temperatura			AKS427 Danemarc Vestfros	Model Vertical, Volum- 3350 litri; Diapazon de temperatură 2°C la +8°C; Display de indicare a temperaturii- da; Control temperaturii- extern, precizia 0.1°C; Ușă -Lacăt cu cel puțin două chei, reversibilă. Agent frigorific- R600a Ușă -Lacăt cu cel puțin două chei, reversibilă. Agent frigorific- R600a sau anologic. Rafturi - cel puțin 5. Roțile – dateate. Grosimea izolației- nu mai puțin de 50 mm. Decongelare -auto. Alimentare-220V, 50 Hz. Rezistent la umiditate; Intervalul de temperatura -2°C - +20°C; Precizie de măsurare 0.5°C; Baterie de litiu ce se poate înlocui; Afisare date pe display LCD;	Certificat de Conformitate
	Lotul 33					
331000000-1	Stație Elisa			Chromatic 4300-1W-8, INTELSPEED Microplate SUA, Letonia Awaress Technologies	O stație de lucru ELISA compactă semiautomatizată, incluzând : 1. Cititor: - Domeniul dinamic: 0-4.0 OD	Certificat de Conformitate

			washer-PC +imprimantia	Biosan	- Precizie: $\pm 1\%$ - Interval spectral: 405-700 nm - Filtre: (filtre preinstalate: 405, 450, 492, 630 nm) - Pozitii pentru filtre in total : 6 (filtrele 600 si 700nm optional) 2.Spaltator: - Configurația colectoarelor: colector cu 8 senzori, cu 2 ace paralele, una pentru a se dispensa, iar cealaltă pentru a aspira; - Volumul de distribuire: 25-1600 μl aprox. - Mod de spălare: standard, revărsare, înmuiere, două puncte epigij - Capacitate tampon de spălare: 3 x 1 L (sau mai mari) sticle pentru diferite soluții de spălare, - Recipient lichid de deșuri: 1 buc - 2 L. 3. Cerințe PC: - Hardware obligatoriu: computer Windows cu port USB- da - Imprimantă laser: imprimantă Pc cu jet de culoare alb-negru- da - Software PC: se adaptează cu ușurință la orice protocol ELISA-da	- Precizie: $\pm 1\%$ - Interval spectral: 405-700 nm - Filtre: (filtre preinstalate: 405, 450, 492, 630 nm) - Pozitii pentru filtre in total : 6 (filtrele 600 si 700nm optional) 2.Spaltator: - Configurația colectoarelor: colector cu 8 senzori, cu 2 ace paralele, una pentru a se dispensa, iar cealaltă pentru a aspira; - Volumul de distribuire: 25-1600 μl aprox. - Mod de spălare: standard, revărsare, înmuiere, două puncte epigij - Capacitate tampon de spălare: 3 x 1 L (sau mai mari) sticle pentru diferite soluții de spălare, - Recipient lichid de deșuri: 1 buc - 2 L. 3. Cerințe PC: - Hardware obligatoriu: computer Windows cu port USB- da - Imprimantă laser: imprimantă Pc cu jet de culoare alb-negru- da - Software PC: se adaptează cu ușurință la orice protocol ELISA-da
	Lotul 45					
331000000 -I	Agitator orbital		PSU-20i cu PP20	Letonia Biosan	- Dimens.ex.380 - 410; adinc.410-510; înălțime 140; dimens. Platformei 330-430 x330-430; încărcare max. 8 kg	- Dimens.ext 410; 410-; înălțime 140; dimens. Platformei 330-430 x330-430; încărcare max. 8 kg - Biosan PSU-20i cu PP20

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovsch Tudor În calitate de: Director

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4)

Data: "25" iulie 2020

Licitația Nr: 21025594

Către: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

"GBG-MLD" SRL confirmă prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: Tudor Ceaicovschi

Funcția în cadrul companiei: director

Denumirea companiei: "GBG-MLD" SRL

L.Ș.

Declarație privind situația personală a operatorului economic (F3.5)

“GBG-MLD” SRL

Subsemnatul Tudor Ceaicovschi, reprezentant împuternicit al “GBG-MLD” SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Tudor Ceaicovschi reprezentant împuternicit al “GBG-MLD” SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de licitație publică nr. 21025594 din 25 iulie 2020 pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect achiziționarea echipament medical conform necesităților ANSP, cod CPV-33100000-1, declar pe propria răspundere că:

nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;

mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;

nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;

nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 25 iulie 2020

Operator economic,

“GBG-MLD” SRL

Semnătura _____

L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 19681 din 18.12.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «GBG-MLD».**

Denumirea prescurtată: **«GBG-MLD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600117582.**

Data înregistrării de stat: **06.01.1995.**

Sediul: **MD-2001, str. Tighina, 65, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice;**
- 2 Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale;**
- 3 Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice și de parfumerie;**
- 4 Producția echipamentului de control pentru procesele industriale;**
- 5 Practica medicală;**
- 6 Fabricarea utilajului medical și chirurgical și a dispozitivelor ortopedice;**
- 7 Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control;**
- 8 Transporturi rutiere de mărfuri.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **CEAICOVSCHI TUDOR.**

Asociați:

I. CEAICOVSCHI TUDOR 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al 1-lea din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.12.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **A2016845** / **862** din **20.07.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CBG-MLD S.R.L.	1003600117582
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Tighina nr.65	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 04.08.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DGACM

Funcția/Dолжность

L.S./М.П.

Executor: **A. Creacico**

Tel. 82-34-27

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись




Nina GHENCIU

Nume și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.07.2020 ora 11:29:59
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



Documentul Unic de Achiziții Europene, în continuare DUAE, este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Este disponibil în limba sa și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurii de achiziții publice în Republica Moldova. Dacărăd DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunități de oferire transformare începând din octombrie 2018. DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru căutătorii, ofertanții și alte părți interesate de completarea DUAE în format electronic. Formulărele online pot fi completate, imprimat și apoi trimis câmpionului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în baza acestor date informatice din sistemul de achiziții publice sau pot fi trimise prin documente justificative.

Partea I a formularului DUAЕ se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	Numărul anunțului invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J O	Nr. anunt: 21025594
B.	Identitatea achizitorului	Denumirea oficială	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
		Tara	Republica Moldova
		Număr unic de identificare a autorității	1018601000021
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	Tipul procedurii	Cererea ofertelor de prețuri Conf
		Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	SIA RSAP
		Data deschiderii ofertelor	Equipament medical
		Denumirea obiectului de achiziții	
		Scurtă descrie	

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații:

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
Denumire	"GBC-MLD" SRL str. Tighina 65, of.607 MD-2001 Chisinau Republica Moldova	
Adresa juridică	www.gbc.md	
Cod postal	office@gbc.md	
Oras	022-54-91-20	
Tara	Tudor Caracovschi	
Adresa web	1003600117582	
e-mail	0205086	
Telefon	S.R.L. Tudor Caracovschi; 100%	
Persoana sau persoanele de contact:		
Număr unic de identificare (IDNO) / NIFP după caz		
Numărul cod TVA – dacă este cazul		
Statutul juridic al operatorului economic		
Numele fondatorilor		
Operatorii economici este		
întreprindere mică,		
întreprindere mijlocie		
Numai în cazul în care activitatea este rezolvată, operatorul economic este un astfel de proiect		
	Da ☒ Nu ☐	
	Da ☐ Nu ☒	

[illegible]

Partea III – Motive de excludere

Motive referitoare la condamnările penale

Art.18 din Legea nr 131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.

Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice

pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni leuate de activități teroriste financiare, terorismului judiciar, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și sau înșelăciune.

Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre

conducere sau de control in cadrul acestuia.

privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea

Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul candidatului dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește costurile de transport în cazul în care este necesar să se efectueze o procedură de achiziție publică.

activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie

Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant candidatul în sensul alin. (7) sunt evaluate (includ seama de gravitatea și

Al. (9) Un ofertant candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziție (construcția informației oferite) nu poate candida din nou la procedurile de achiziție.

Participare la o organizație criminală. Text	Da	☒ Nu
--	----	--

Fraude Text	Da	Nu
-------------	----	----

Case	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Case	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Exploatarea prin muncă a corbilor si alte forme de trafic de persoane / <i>Exploitation of labour through begging and other forms of trafficking in persons</i>	Da	☒	☒
---	----	-------------------------------------	-------------------------------------

Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere:

oferant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:

41. (2^a) *Prem. Accertare che la alim. 2.1. b), obiettando concludendo in este esclus dei procedura de atribuire diviz beneficiariz in prevederile legale in vigore in Republica Moldova sau in tara in care este stabilit.*

în vederea plămii acestora, inclusiv a majorărilor de mărțire (penaliților) și sau a amenzilor.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

La evaluarea datelor conținând în cazul unei conștientizări durabile în măsura în care aceasta este administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie.

Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale	Da ☒
---	--

eventualelor: doborâzi acumulate sau a amenzilor? ☐ În rugăm să le descrieți aceste informații sunt disponibile

Plata asigurarilor sociale

teritoriul Republicii Moldova, ca și în alte state Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau	Da ☒
---	---

În cazul în care această încălcare a obligatiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau

Nu
 ă d rugăm să po, cităm dela condamnările în carul totu condamnării, durata pender de aclude în măsura în care decizia este
 stabilită ducem la condamnare. (Dec. rati ce măsura de fust afel) = 10)

economie este inclusă în mărul și executat contractul		Da	Nu
Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)/la rugăm să le descrieți			
Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.			
Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se prezintă în legislația națională, anulul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?/la rugăm să le descrieți			
Da	☒	Nu	☐
Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice			
Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice?/la rugăm să le descrieți			
Da	☐	Nu	☒
Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile			
Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior./la rugăm să le descrieți			
Da	☐	Nu	☒
Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură			
Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare:			
a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție;			
b) A acuzat astfel de informații;			
c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea în care a fost încheiat contractul;	Da	☒	Nu
d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau să a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea	Da	☐	Nu
Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:			
Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau de parteneri terți. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficienți și relevanți pentru demonstrarea faptului că operatorul candidant nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat calificativ din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care operatorul candidant este stabilit, cum ar fi certificate, cazurile practice sau alte documente echivalente, emise de autorități competente din țara respectivă.			
Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sînt stabiliți operatorii candidanți, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directorii de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind operatorul candidant.			
Al. (5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul candidant nu se emit documente de natură celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau publice sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.			

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include:			
A Capacitatea de a corespunde cerințelor			
Art. 21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:			
Înscrierea într-un registru profesional relevant:			
Foste inserți într-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	Da	☒	Nu
Foste necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit./la rugăm să le descrieți	Da	☐	Nu
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, întreprinderi sau alte persoane	Da	☐	Nu
B Capacitatea economică și financiară			
Articolul 20 al.1 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, stabilește că:			
Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi:			
Declarații bancare			
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității	Da	☒	Nu

contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?/la rugăm să le descrieți		Da	☐	Nu	☒
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, întreprinderi sau alte persoane					
Cifra de afaceri anuală					
Art. 20 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, stabilește că:					
Al. (1) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii businessului, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indică cifrele de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referință la grupul de loturi, dar operatorii câștigători și alții care nu au multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.					
Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anulul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Valoare	Se completează de către operatorul economic Cifra de afaceri 124.231.391				
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, întreprinderi sau alte persoane	☒	Da	☐	Nu	☐
www.raportare.md					
Cifra de afaceri medie anuală	An: 2017 Cifra de afaceri: 126.318.597				
Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anulul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Număr de ani 3 (trei) Valoare 121.590.810	An: 2018 Cifra de afaceri: 114.222.442				
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, întreprinderi sau alte persoane	☒	Da	☐	Nu	☐
www.statistica.md					
Raport financiar					
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extras din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da				
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, întreprinderi sau alte persoane	☒	Da	☐	Nu	☐
www.statistica.md					
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anulul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formulările solicitate în anulul de participare.	Art. 20 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, stabilește că:				
Al. (5) În cazul în care operatorul candidant își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția operatorului candidantului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 din (1) și din (2) lit. a) și c) care determină excluderea din procedura de atribuire.					
Al. (6) Atunci când operatorul candidant se bazează pe capacitatea altor persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca operatorul candidant și acea persoană să fie răspundătoare solidar pentru executarea contractului.					
Al. (7) În același context prevăzute la alin. (4) lit. f), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.					
C Capacitatea tehnică și/sau profesională					
Art. 21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:					
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anulul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitoarelor contracte, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?					
☒ Da					
Nu: ☐					
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, întreprinderi sau alte persoane					
Da: ☒ Nu: ☐					
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anulul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică și/sau profesională, vă rugăm să furnizați formulările solicitate în anulul de participare.					
Prezentarea contractelor de achiziții publice de lucru: executarea de lucrări de tipul specificat					
Numai pentru contractele de achiziții publice de lucru în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani:					
Descriere					
Valoare					
Data de începere					

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include

A	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? (mențiune minimă 1 zi lucrătoare)	☒ Da ☐ Nu
	Acceți informații sunt disponibile pentru autorități, dăm-o bază de date națională?	☒ Da ☐ Nu

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include:

operatorul economic declară că îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod	Da
operatorul economic declară că dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunșii de participare relevant	Da
care informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	Da ☒ Nu ☐

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără înmăiere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agenția Națională pentru Sănătate Publică, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document¹ în vederea achiziției în scopul achiziționării medii de cultura publică în SI ARS AP Mîndu cu nr. 21075504

Nume: Tudor Cealcovschi
Poziția: Director general
Data: [25 07 20]
Locul: Chișinău
Semnătura:

Data de încheiere			
Beneficiar		Da	Nu
<i>Aceste informații sunt disponibile, gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> Nu mai pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii, executarea de livrări, prestări de tipul specificat economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anulul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>			
Valoare			
Data de începere			
Data de încheiere			
Beneficiar		Da	Nu
<i>Aceste informații sunt disponibile, gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> Dacă autoritatea contractantă sau emitentul contractului solicită în anulul de participare prezentarea unor formulare, să rugăm să furnizați formularele solicitate în anulul de participare			
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i> Vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate			
<i>Aceste informații sunt disponibile, gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> Dacă autoritatea contractantă sau emitentul contractului solicită în anulul de participare prezentarea unor formulare, să rugăm să furnizați formularele solicitate în anulul de participare			
Permiterea controlorilor Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? <i>Vă rugăm să reținem că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractanților pentru executarea părții respective, trebuie să completezi un DUA/E separat pentru acest subcontractant/ subcontractanți</i>			
Diplome de studii și calificări profesionale Următoarele calificări: educaționale și profesionale sunt deținute de personalul de servicii sau de contractantul însuși și sau în funcție de cerințele stabilite în anulul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>			
<i>Aceste informații sunt disponibile, gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> Dacă autoritatea contractantă sau emitentul contractului solicită în anulul de participare prezentarea unor formulare, să rugăm să furnizați formularele solicitate în anulul de participare			
Măsurile de management al mediului Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>			
<i>Aceste informații sunt disponibile, gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>			
Numărul membrilor personalului de conducere Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează			
Anul 2017 Număr: 3 Anul 2018 Număr: 2 Anul 2019 Număr: 2			
Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: cantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza esantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate			
<i>Aceste informații sunt disponibile, gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>			
Dacă autoritatea contractantă sau emitentul contractului solicită în anulul de participare prezentarea unor formulare, să rugăm să furnizați formularele solicitate în anulul de participare			
Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu At: al din: age subiectele următoarelor motive de selecție Beneficiari emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu			
<i>Aceste informații sunt disponibile, gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> Dacă autoritatea contractantă sau emitentul contractului solicită în anulul de participare prezentarea unor formulare, să rugăm să furnizați formularele solicitate în anulul de participare			

Partea V - Indicații generale pentru toate criteriile de selecție



DECLARATION OF CONFORMITY

MDD 93/42/EC CERTIFICATE

Manufacturer: **A/S Vestfrost**
Falkevej 12
6705 Esbjerg Ø
Denmark

We, the manufacturer, hereby declare that the products as listed below are in conformity with the provisions of the EC Directive 93/42/EC, amended by EC Directive 2007/47/EC, and the transposition into the national law of Denmark, Order on Medical Devices "Ministeriet for forebyggelse og sundhed, nr. 1263 of 15. December 2008, Bekendtgørelse om medicinsk udstyr", which apply to them.

Device classification: I

Conformity assessment route: MDD 93/42/EC (amended by 2007/47/EC) annex VII

Products: **AKG 427, AKS 427**
Biomedical refrigerator

Intended use: Biomedical line refrigerators are intended for storage of medicines intended for use in humans or other human use materials.



SIGNATURE

06.03.2015

DATE

AUTHORITY:
JENS DAMGAARD, CEO
A/S VESTFROST

VESTFROST
SOLUTIONS



EC Certificate

Full Quality Assurance System according to

Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex-II Section 3

Certificate Number: 1984-MDD-10-030

We hereby declare that an examination of the under mentioned full quality assurance system has been carried out following the requirements of the national legislation to which the undersigned is subjected, transposing annex II (with the exemption of section 4) of the Directive 93/42/EEC on medical devices. We certify that the full quality assurance system conforms with the relevant provisions of the aforementioned directive.

Organization:

**NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ
İMALAT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Saracalar Mahallesi Saracalar Kümeevleri No:4/2 Akyurt Ankara, Turkey

Products: Steam Sterilizers, Dry Heat Sterilizers, Blood Bank Refrigerators, Deep Freezers, Platelet Incubators

The products defined at the enclosure which is the part of this certificate and contains one page. The certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact Kiwa for details.

Report Number: M.3158.10
Date of first issue: 31 May 2010
Date of last issue: 19 February 2019
Revision Number: 08
Expiry Date: 18 February 2024

19 February 2019, Istanbul, Turkey

Head of Notified Body


CERTIFICATE



NB SERIES

Unstirred Water Baths

- Designed for many general and special applications in microbiology, research and industrial laboratories
- Excellent temperature control of liquid for uniform and stable temperatures
- Reliable and accurate N-Prime™ programmable PID microprocessor control system
- User friendly control panel including large bright LED displays for temperature and time
- Easy programming with one button, just turn and push
- Password protected menu to secure the operation
- Programmable alarm limits
- Data recording on memory stick by means of USB port up to 125 days
- Programmable delayed start function
- Safety thermostat to prevent running without water and audible and visual alarms against over heating
- Seamless corrosion resistant stainless steel tank for a longer life
- Minimized risk of contamination by the rounded corners and smooth surfaces of the tank
- Silicon sheet heaters surrounding the tank from three sides for uniform heating
- Triple insulation consisting of glass wool, aluminium layer and air gap for high efficiency
- Angled front panel to protect the controller from accidental water spillage
- Efficient tank usage as there is no obstruction in the tank such as circulation pump or heater
- Convenient drain for discharging the liquid in the tank quickly
- Footprint almost equal to the tank dimensions to save valuable bench space.

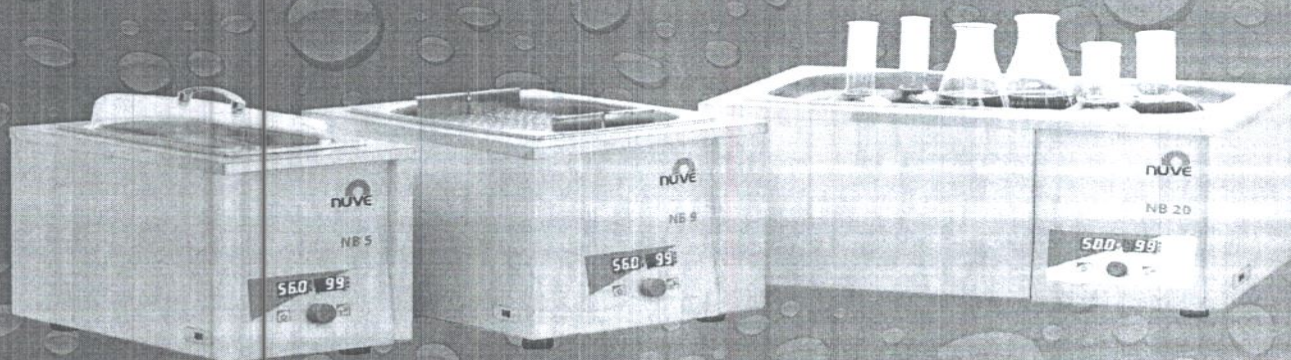

N-prime

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	NB 5	NB 9	NB 20
Tank Volume, litres	6	9,5	21
Useful Volume, litres	4	7	15
Temperature Range	Ambient Temp + 5°C / 99,9°C		
Temperature Sensor	Fe-Const		
Control System	N-Prime™ Programmable Microprocessor		
Temperature Set and Display Sensitivity	0,1°C		
Temperature Variation @37°C	± 0,2°C*		
Temperature Fluctuation @37°C	± 0,1°C*		
Programmable Alarm Limits	± 0,5°C / 5°C		
Timer	1 minute – 99,9 hours + Hold Position		
Delayed Start Timer	1 minute – 99,9 hours		
Selectable Recording Frequency on Memory Stick	10 or 30 seconds, 1, 5, 30 or 60 minutes		
Internal Material	Stainless Steel		
External Material	Epoxy - Polyester Powder Coated Steel		
Power Consumption	600 W	800 W	1600 W
Power Supply	230 V, 50/60 Hz		
Internal Dimensions (WxDxH) mm	150x300x150	240x300x145	505x300x145
External Dimensions (WxDxH) mm	240x400x270	320x405x275	590x405x275
Packing Dimensions (WxDxH) mm	300x460x480	390x450x480	650x450x480
Net / Packed Weight kg.	8 / 11	9 / 12	13 / 17

* At 22°C ambient temperature with closed lid

ACCESSORIES

K 04 290	Plexiglass lid for NB 5 (Resists up to 60°C)
K 52 010	Stainless steel lid for NB 5
K 04 286	Plexiglass lid for NB 9 (Resists up to 60°C)
K 52 007	Stainless steel lid for NB 9
K 04 289	Plexiglass lid for NB 20 (Resists up to 60°C)
K 52 003	Stainless steel lid for NB 20
K 52 008	Lid with 4 holes for NB 9 (Hole dia. 95 mm)
K 52 005	Lid with 4 holes for NB 20 (Hole dia. 95 mm)
K 52 006	Lid with 6 holes for NB 20 (Hole dia. 95 mm)
K 52 014	Lid with 8 holes for NB 20 (Hole dia. 95 mm)
A 08 051	Tube rack 52 x Ø 13 mm, wide 70 mm
A 08 050	Tube rack 30 x Ø 16 mm, wide 70 mm
A 08 021	Tube rack 27 x Ø 18 mm, wide 70 mm
A 08 049	Tube rack 12 x Ø 30 mm, wide 70 mm



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümesleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TURKEY t: +90 312 399 28 30 f: +90 312 399 21 97
nuve.com.tr sales@nuve.com.tr

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003 **CE**




MF SERIES

Muffle Furnace

MF Series General Purpose Furnaces have maximum operating temperatures of 1100°C, 1200°C and 1300°C and can be used for a wide range of applications in many different sectors such as metal, ceramic and food industry, jewelry and dentistry. Their perfect design is ideal for:

- Ashing organic and inorganic samples
- Firing and sintering of ceramics, stoneware and porcelain
- Melting, annealing, hardening, tempering, stress relieving and heat treatments of ferrous and non-ferrous metals
- Thermal aging
- Chemical decomposition
- Thermal shock testing
- High temperature tests of components or fishing products

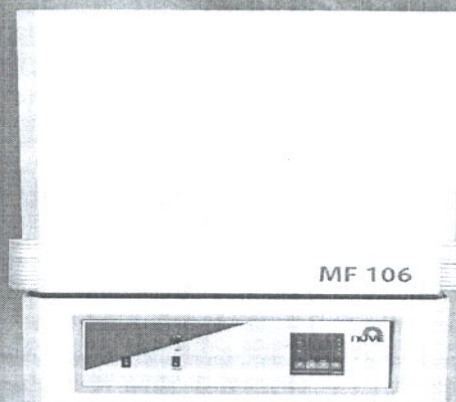

The chamber of MF Series Furnaces is made of vacuumed fiber board and refractory bricks. Refractory bricks are used for the bottom of the chamber and at the front of the chamber since those surfaces are subjected to more chemical and mechanical effects. Heating elements are coiled around the ceramic tubes and placed on the two sides of the chamber to ensure very good temperature uniformity and fast heating. Another advantage is the assembly system of the heaters which is very easy and economic to replace of the heaters in case of the failure.

By means of the high grade insulation made of fiber board, very good temperature homogeneity is obtained in the chamber. In addition to the insulation, double enveloped design with air gap between insulated chamber and the outer body keeps the outer body at low temperatures.

Counter balanced lid is opened upwards and keeps the hot surface of the lid away from the operator for safe and easy loading and unloading. As another safety feature, there is a switch which cuts off the power of the heaters when lid is opened.

The chimney for discharging the vapors occurring during the operation is offered as standard.

MF Series Furnaces are equipped with PID microprocessor control system which has temperature displays for actual and set temperatures. The control system gives an alarm in case of temperature sensor failure and stops heating if temperature exceeds the maximum set temperatures of the furnace.

Depending on the different performance needs, two more control systems are offered as option: Control systems with two steps and six steps. While it is possible to program only one heating ramp and one dwell for control system with two steps, it is possible to program totally six steps including heating ramps and dwells for control system with six steps. Those optional control systems have 3600 minute timer for each step and delayed start timer can be programmed up to 3600 minutes as well.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MF 106	MF 110	MF 205	MF 207	MF 306
Maximum temperature	1100°C		1200°C		1300°C
Continuous operating temperature	1050°C		1150°C		1250°C
Chamber volume, liters	6,3	10	5	7	6,3
Control system	PID Microprocessor control system				
Temperature set and display sensitivity	1°C				
Internal material	Fiber board and refractory brick				
External material	Electrostatic powder coated steel				
Time to maximum temperature, minutes	65	55	50	60	65
Power consumption, Watt	2000	3000	2000	2000	2500
Power supply	230 V, 50/60 Hz				
Internal dimensions (WxDxH) mm	210x200x150	200x250x200	180x200x140	200x250x140	200x250x140
External dimensions (WxDxH) mm	550x580x650	560x670x720	550x580x650	550x580x650	550x580x650

OPTIONS

MF XXX (T) Timer-3600 minutes

MF XXX (2) Control system with two steps

MF XXX (6) Control system with six steps

**NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.**

Saracalar Mah. Saracalar Kümesi Vleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA t. 0312 399 28 30 f. 0312 399 21 97

nuve.com.tr sales@nuve.com.tr

ISO 9001: 2008


ISO 13485: 2003





NF200

Bench Top Centrifuge

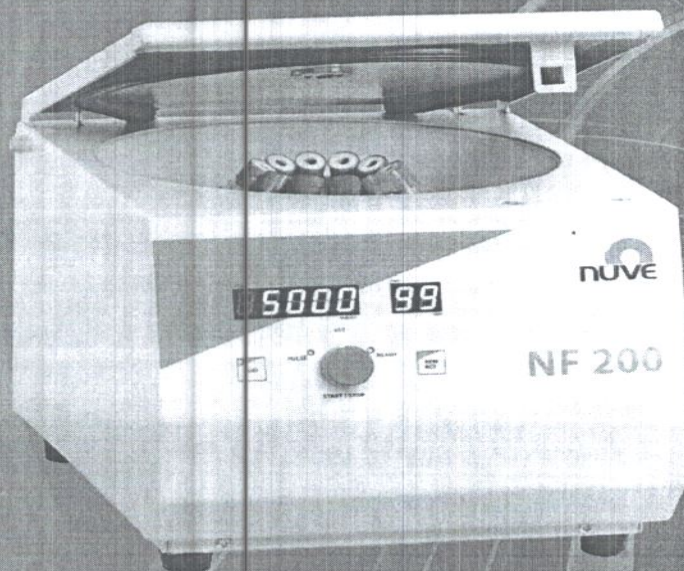

- Compact design for separation of blood samples, urine particle sedimentation and other routine applications in emergency and small laboratories
- N-Prime™ programmable microprocessor control system for accurate and reliable operations
- Easy programming with one button, just turn and push
- Two large LED displays for speed/RCF and time
- Possibility of programming RCF
- Pulse key for short centrifugation requirements
- Reduced temperature increase in the chamber by means of continuous air cooling through air channel in the lid
- Quiet brushless induction drive
- Safety ensured by steel body, lid and chamber, lid locking system and motor over temperature protection
- Delivered with 12x15 ml. angle rotor

N-prime

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Maximum Speed	5.000 rpm
Maximum RCF	2.822xg
Tube Capacity	12x15 ml.
Control System	N-Prime™ Programmable Microprocessor Control
Speed Set Range	1.000-5.000 rpm
Speed Set Step	10 rpm
Timer Set Range	1-99 Minutes and Hold Position
Timer Set Step	1 minute
Motor	Induction Motor
Body, Lid and Chamber	Epoxy-Polyester Powder Coated Steel
Power Supply	230 V / 50-60 Hz (115 V / 60 Hz)
Power Consumption	150 W
External Dimensions (WxDxH) mm.	280x360x260
Packing Dimensions (WxDxH) mm.	350x420x480
Net / Packed Weight, kg.	12 / 16

ROTOR

Rotor Type	Capacity	Max. Tube Dia. (mm)	Radius (mm)	Max. Speed	Max. RCF
Angle	12x15 ml.	17	101	5.000 rpm	2.822xg

ADAPTORS

Code	Tube Type	Max. Tube Dia. (mm)
G 03 057	1.5/2 ml tubes	11
G 03 014	7 ml vacuumed/ non vacuumed tubes	13
G 03 015	5 ml vacuumed/ non vacuumed tubes	13

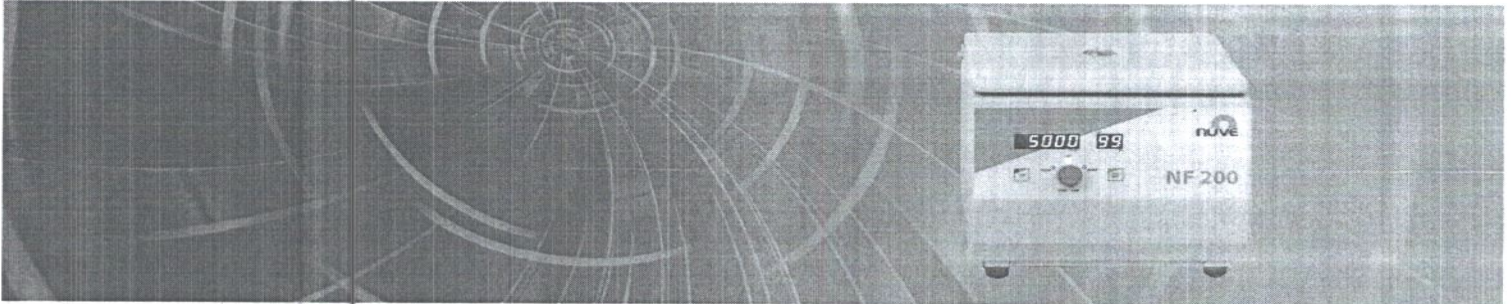

NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TURKEY t +90 312 399 28 30 f +90 312 399 21 97
nuve.com.tr sales@nuve.com.tr

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003



Datasheet

BIOMEDICAL
CATEGORY - REFRIGERATOR
MODEL - AKG/S 427
Controller

Defrost	Automatic
High/Low Temp. Alarm	Yes
Open Door Alarm	Yes
Probe Failure Alarm	Yes
Power Failure Alarm	Yes
USB Connection	Yes
Datalogging	Yes

Features

Lock	Yes
LED Light	Yes
Safety Thermostat	With DIN kit
Battery Backup for Controller, 48h	Yes
Porthole	Yes
Dry Contact	Yes
Door	Glass / Solid
Door Closure	Yes
Door Reversibility	Yes
Castors with hight adjustable feet	No

Construction

Outer Dimensions, HxVxD	2060x595x625
Inner Dimensions, HxVxD	1490x490x480
Volume Gross/net, L	350 / 331
Net Weight, kg	110
Material Inner Cabinet	Painted Steel
Material Outer Cabinet	Painted Steel
Insulation Thickness, mm	50
Insulation Type	Polyurethane with Cyclopentane
Refrigerant	R600a
Air Distribution	Dual Air Stream
Feet / Castors	4 Castors



LOW NOISE



ENVIRONMENT FRIENDLY



USER FRIENDLY

Operation

Temperature Range, C°	+2 to +8
Noise, dB	54
Energy Consumption 24/h, kWh	Glass 1,0 Solid 0,9
Frequency, Hz	50
Power Supply, V	220 / 240

Storage

Number of Shelves (Standard/max)	5 / 10 + Bottom
Shelf material	Polished Steel coated with Plastic Powder
Max Loading pr. Shelf, kg	16
Max no. of Drawers Available	10 + Bottom
Drawer Material	Stainless Steel
Max Loading pr. Drawer, kg	16

PSU-20i, Multi-functional Orbital Shaker

DESCRIPTION

Shaker PSU-20i provides three motion types: orbital, reciprocal and vibrating, which can be performed separately, pairwise and sequentially in repeated cycles. Shaker is designed for applications both in small specialized laboratories and in large multidisciplinary laboratories. PSU-20i is an ideal instrument for laboratories conducting research in biopharmaceutics and biomedicine.


Shaker PSU-20i is noiseless and reliable in operation, incorporates a direct drive system and brushless motor with a guaranteed service life up to 35,000 working hours. The use of direct drive and brushless motor allows for continuous mixing up to 7 days and ensures reliable operation for more than 2 years.

A choice of nine (9) different interchangeable platforms provides possibility of performing various procedures and techniques. Special attention should be paid to a multilevel platform, which allows accommodation of a large number of various microplates, Petri dishes, cultural bags and other low containers.

Shaker can be used in cold rooms or incubators, operating at ambient temperature range +4°C to +40°C.

SPECIFICATIONS

Speed control range	20-250* RPM (increment 5 rpm) * max. speed depends on the load and vessels' shape
Digital time setting	1 min-96 hrs / non-stop (increment 1 min)
Timer sound signal	+
Digital speed control	+
Maximum continuous operation time	168 hrs
Orbit	20 mm
Maximum load	8 kg
Overall dimensions (W×D×H)	410×410×130 mm
Weight	11.7 kg
Input current/power consumption	12 V, 3.2 A / 40 W
External power supply	Input AC 100-240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V

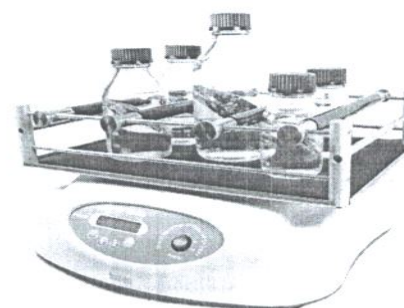

CAT. NUMBER

Without platform	Without platform
BS-010145-AC1	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010145-ACQ	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-010145-AC4	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-010145-ACJ	100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010145-CK	IQ OQ document
BS-010145-DK	PQ document

ACCESSORIES



UP-330
BS-010145-AK
platform

Universal platform with adjustable bars can accommodate laboratory glassware of different shapes.



P-30/100
BS-010135-BK
platform

Platform with clamps for flasks.



P-16/250
BS-010135-CK
platform

Platform with clamps for flasks.



P-9/500
BS-010135-AK
platform

Platform with clamps for flasks.



P-6/1000
BS-010135-DK
platform

Platform with clamps for flasks.



PP-20/4
BS-010126-EK
platform

Flat platform with non-slip rubber mat can accommodate various low profile containers.



PP-20/3
BS-010126-DK
platform

Flat platform with non-slip rubber mat can accommodate various low profile containers.



PP-20/2
BS-010126-CK
platform

Flat platform with non-slip rubber mat can accommodate various low profile containers.




PP-20
BS-010126-BK
platform

Flat platform with non-slip rubber mat can accommodate various low profile containers.




UP-168
BS-010135-JK
platform

Universal platform with clamps can accommodate flasks or bottles of different volume sizes. Clamps are not included with platform and need to be ordered separately.



TR-44/15
BS-010135-LK
rack

Adjustable angle test tube rack for UP-168



TR-21/50
BS-010135-KK
rack

Adjustable angle test tube rack for UP-168



FC-50
BS-010126-MK
clamp

Clamp 50 ml - Ø50 mm for UP-168




FC-100
BS-010126-IK
clamp

Clamp 100 ml - Ø65 mm for UP-168



FC-250
BS-010126-JK
clamp

Clamp 250 ml - Ø85 mm for UP-168




FC-500
BS-010126-LK
clamp

Clamp 500 ml - Ø105 mm for UP-168



FC-1000
BS-010126-IK
clamp


Clamp 1000 ml - Ø130 mm for UP-168



FC-2000
BS-010126-NK
clamp

Clamp 2000 ml - Ø165 mm for UP-168

CHROMATE®

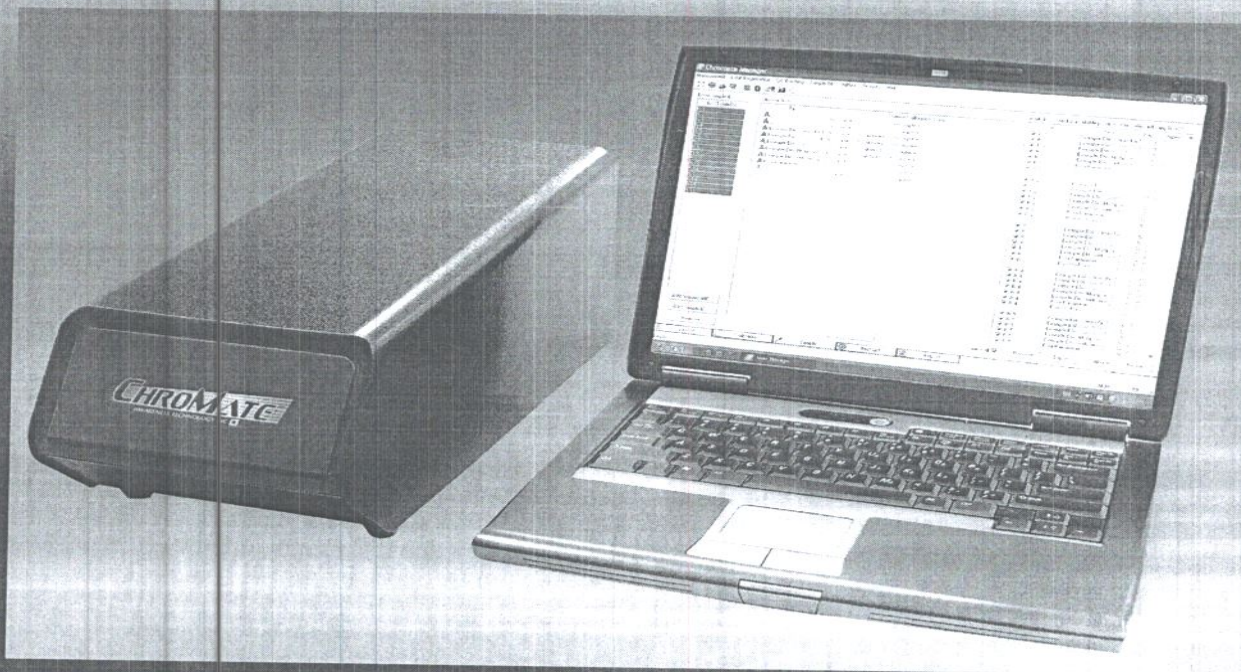

CHROMATE® - a compact, 8-channel microplate reader. Its streamlined design and minimal footprint offers superb optics to fit any size lab bench.

CHROMATE® and your PC team up to provide rapid reading and full access to high level software, reporting, curve fitting, and data storage, to meet the requirements of modern laboratories. Instrument and software come ready to "plug and play" with your PC.



AWARENESS TECHNOLOGY, Inc. PO Drawer 1679, Palm City, FL 34991 (772) 283 6540 fax (772) 283 8020
web site: <http://www.awaretech.com>, email: info@awaretech.com

Cost Effective by Design®

CHROMATE[®]

4300 Microplate Reader Specifications

Photometric

Optical Measurement Range:	0.0 to 4.0 Absorbance units (A).
Photometric Accuracy:	+/- 1%.
Stability:	drift of no more than 0.005A in 8 hours.
Light Source:	Remote halogen lamp source with lamp saver feature.
Wavelengths:	Standard: 405, 450, 492, and 630nm. 6-filter: 405, 450, 492, 545, 600, and 630nm. Filter options from 405nm to 700nm.
Filter Type:	IAD hardcoat interference, 10nm half bandpass.
Vessel:	Standard 96-well microtiter plates, or strip trays.

Electronic

Power Requirements:	115V or 230V AC, 50-60Hz (auto-sensing).
PC connection:	USB Port.
Speed:	Reads absorbances of 96 wells in about 12 seconds.
Plate Transport:	Stepper motor.

Software

PC interface with ChroMate[®] Manager software - included. (PC not included)

Calculation Modes:	Single point calibration, point-to-point curve fit, polynomial regression, linear and sigmoidal regression (log & linear), cutoff absorbance, multipoint % absorbance.
Additional Features:	User-programmable open system, selectable plate formatting, alphanumeric test naming, automatic interpretation options, duplicate well options, curve plotting and editing, flags and error messages.

Certifications:	Other
Enclosure:	NRTL Listed, CE Mark.
Dimensions:	All metal enclosure approx. 7.5x8.0x16.5 (19x20.3x42cm) weighs 10lbs. (4.5kg)



Awareness Technology, Inc.



Declaration of Conformity

Product Identification
Product name : ChroMate, Microplate Reader
Model/Type : P4300 Series
EDMS Code : 20.10.01.01.00
Class : Other IVD Devices – Self-declared

Manufacturer
Name : Awareness Technology, Inc.
Address : P.O. Box 1679
Palm City, Florida 34991
Country : USA

Authorized Representative in Europe
Representative:
Name : Emergo Europe
Address : Molenstraat 15
2513 BH The Hague
Country : The Netherlands
Telephone : +31 70 345 8570
Fax Number : +31 70 346 7299

Means of Conformity

Awareness Technology, Inc. declares that the product listed is in conformity with the Annex III, essential requirements and provisions of Council Directive:

98/79/EC

and is in conformance with the following standards:

EN 61326-1 EMC / EN 61010-1 Safety

Place and Date:	Signature Awareness Technology, Inc.	February 4, 2009
Signature :		
Name :	Steve Andrus	Chris Mauer
Title :	Quality Manager	Compliance Engineer

IW-8, Intelispeed washer

DESCRIPTION

Intelispeed Washer **IW-8** is designed for washing of standard flat-bottom 96 well plates and microstrips. The unit is fully programmable ensuring multi-step solution ripening, aspiration (aspiration, combination of aspiration/liquid dispensing and soaking, as well as soaking cycle during a particular period of time).

The unit has 100 user-defined programs. Standard version is supplied with 8-channel washing head for dispensing/aspiration, 3 bottles for washing and rinsing solutions, a waste bottle and bottle with filter. Optional 4-channel washing solution weight logger, **4 CHW Logger** is available.


The unit is designed for washing standard 96-well plates during analyses.

The unit provides:

- Washing mode
- Rinsing mode
- Mixing mode
- Double aspiration
- Possibility of additional solution mixing during time gap between two work cycles
- Possibility to use microtest plates by different manufacturers, ensured by automated plate set up (adjusting to different depths of plate wells)
- Plate and strip washing mode
- User-defined programs with adjustable parameters
- Saving work programs

The unit is designed for use in closed laboratory rooms at temperatures from +10°C to +35°C and relative humidity up to 80% at +25°C decreasing linearly to 50% relative humidity at 35°C.

4-channel washing solution weight logger, **4 CHW Logger** provides automatic control of rinsing solution and waste volumes. The washer shows remaining volume for each bottle as percentage and gives a warning message in case of low solution volume or full waste bottle when **4 CHW Logger** is connected.

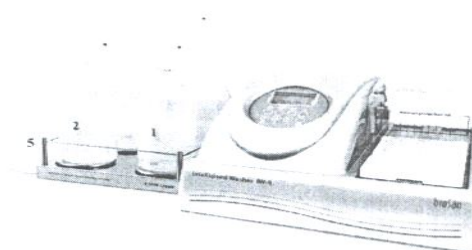

CAT. NUMBER

BS-060106-AAI	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-060106-AAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-060106-AA4	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-060106-AAJ	100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
IVD certified	IVD certified
BS-060106-IVD1	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-060106-IVD2	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-060106-IVD3	100VAC 50/60Hz US plug
Russian language interface	Russian language interface
BS-060106-A02	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-060106-AK	IQ OQ document
BS-060106-BK	PQ document

SPECIFICATIONS

Minimum dispense volume	25 µl
Maximum dispense volume	1600 µl
Dispense increment	25 µl
Dispensing accuracy	±2.5%
Allowed residual liquid volume in plate well	not more than 2 µl
Number of wells washed simultaneously	8
Aspiration time	0.2–3 s
Number of washing cycles for each channel	1–15
Aspiration/dispensing speed	3 levels
Max. number of channels in a program	2
Choice of 3 washing liquid bottles	+
Soaking time	0–300 s (increment 10 s)
Shaking time	0–150 s (increment 5 s)
Number of washed rows	1 – 12
Time of plate single wash (350 µl), not more	45 s
Number of programs	101
Plate platform and washing head movement	automated
Indication of operation modes	8-line LCD
Overall dimensions (W×D×H)	375 × 345 × 180 mm
Weight	9.6 kg
Input current/power consumption	12 V DC, 1.8 A / 22 W
External power supply	Input AC 100–240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V