


ECOLOGICAL THERMOMETERS - MERCURY FREE

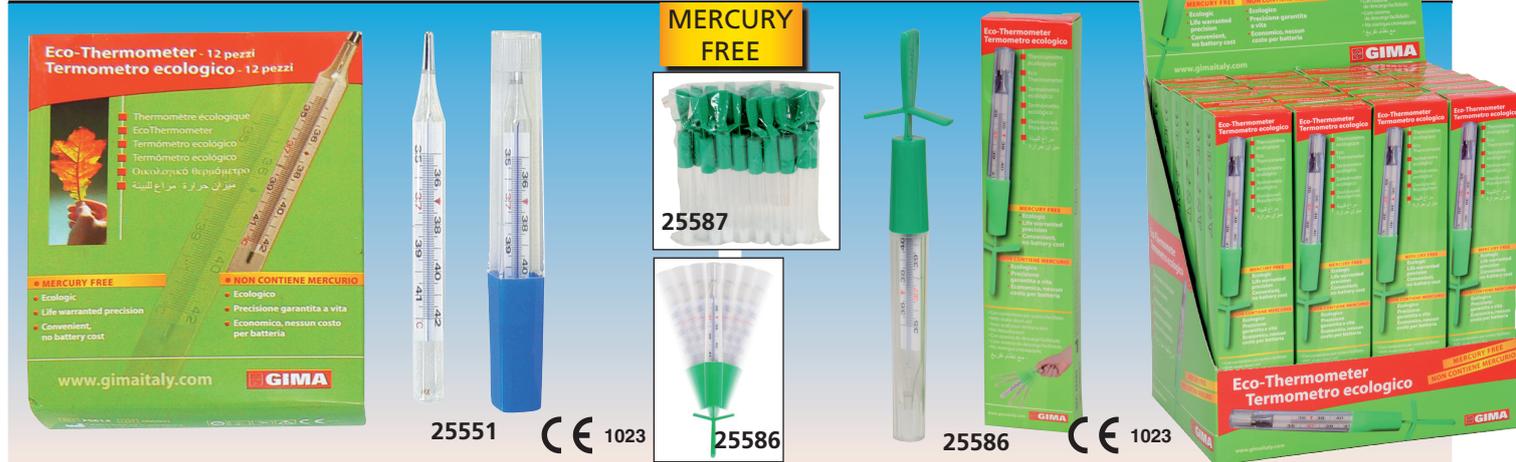

• 25551 ECOLOGICAL OVAL THERMOMETER - box of 12
 • 25587 SHAKER for ecological thermometers - box of 24
 Mercury free clinical thermometer with gallium alloy instead of mercury. Safe, precise and functional. Glass structure.

• 25586 ECOLOGICAL OVAL THERMOMETER with shaker - box
 • 25589 ECOLOGICAL OVAL THERMOMETER with shaker display box of 24 pcs.
 Same as 25551 but supplied with a shaker to help shake down gallium after use.

POCKET EAR THERMOMETER

• 25579 POCKET EAR THERMOMETER
 Small, easy to clean, cover free design ear thermometer. Home use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Measurement Range: 34-44 °C (93.2-111.2 °F) - ±0.2 °C (±0.4 °F)
 Response time: 1-2 seconds
 Battery: Lithium 3 V (CR2032) - life approx 4,000 measurements
 Size - weight: 114x35x40 mm - 35 g (including batteries)



BABY THERMOMETERS

60 SECONDS CE 0197



• 25555 PANDA DIGITAL THERMOMETER °C - hang box water-proof, fever alarm

30 SECONDS CE 0476

• 25566 FROG DIGITAL THERMOMETER °C - hang box - flexible tip

WIRELESS THERMOMETER

• 25548 TEMP SITTER - baby wireless thermometer
 Accurate and innovative thin thermometer. Transmission to mother smartphone APP (iOS and Android). To be placed under baby armpit. High temp alarm can be set in the APP. Waterproof and material of safe quality. Supplied with 10 adhesives to fix thermometer to baby armpit.

• 25547 ADHESIVE TO FIX TEMP SITTER - box of 10 - spare

25548 25548
 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery life: 3,000 hours, not replaceable
 Measurement range: 25-45 °C (±0.05 between 35-38.5 °C) Size: 51x32x7 mm




NIPPLE-LIKE DIGITAL THERMOMETER

• 25569 NIPPLE-LIKE DIGITAL PACIFIER THERMOMETER °C
 Individually packed in cardboard box, memorizes last temperature. Auto power-off. Display range 32.0°C - 42.0°C, with accuracy ±0.1°C.
 1.5 V button battery included.



25569

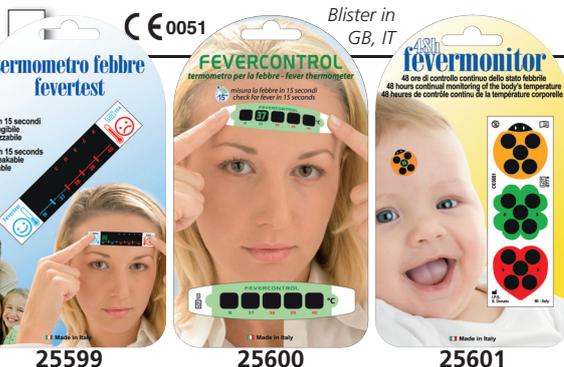

LIQUID CRYSTAL THERMOMETERS

Non toxic, mercury free, safe, unbreakable, reliable, long lasting, easy to read, liquid crystal thermometers. 10 languages manual. Made in Italy.

REUSABLE FOREHEAD THERMOMETERS

• 25599 FEVERTEST - bag of 10 blister
 It indicates the normal temperature or fever in 15 seconds.
 • 25596 FEVERTEST BULK - box of 100 - hospital use
 • 25600 FEVERCONTROL - bag of 10 blister
 It indicates temperature in 15 seconds with graduation of 0.5 °C. Safe, fast, accurate, non toxic, unbreakable.

BODY TEMPERATURE MONITOR

• 25601 48h FEVER MONITOR - bag of 10 blister of 3 pcs.
 Innovative "continual" fever indicator for 48h monitoring.



25596



Notified Body 1023
INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Inc.,
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic

EC Certificate - Production Quality Assurance No. 19 0248 QS/NB

The quality system of manufacturer

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.

**No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City,
Jiangsu 214194 China**

has been certified as meeting the requirements of

Directive 93/42/EEC
on medical devices, Annex V

for the following product category(ies):

Mercury free clinical thermometer

The Notified Body No. 1023 declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex V. The Notified Body has audited this system with limitation to those aspects of manufacture concerned with the conformity of the devices with metrological requirements. This part of quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subjected to periodical surveillance.

Valid from: 2021-03-23
Valid until: 2024-05-21
First Issued: 2019-05-22
Revision: a



Date: 2021-03-23

Mgr. Jiří Heš
Representative of the Notified Body No. 1023



Notified Body 1023
INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Inc.,
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic

Annex to EC Certificate No. 19 0248 QS/NB
issued for manufacturer:

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City,
Jiangsu 214194 China

Product(s):

Name: Mercury free clinical thermometer
Trade name(s): AIESI; APTEO; EUROSIREL; EVOLU; FarmaMed;
FLAEM; GIMA; ia; Lamotherm; Med+s; Sanitec;
Tecnico; UNIFAMILY
Model(s): CR.W00
Class: Im
GMDN: 34343

Facility(ies):

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu 214194 China



Date: 2021-03-23
Revision: a


Mgr. Jiří Heš
Representative of the Notified Body No. 1023



Notified Body 1023
INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Inc.,
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic

Annex to EC Certificate No. 19 0248 QS/NB
issued for manufacturer:

Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City,
Jiangsu 214194 China

Certificate History:

Revision	Date	Reference Number	Action
	2019-05-22	803602800	Certification
a	2021-03-23	803602897	Adding new brand names



Date: 2021-03-23
Revision: a

Mgr. Jiří Heš
Representative of the Notified Body No. 1023

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.

Add: No.43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei town, Wuxi city, Jiangsu, 214194 China

European representative : Lotus NL B.V.

Add: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel: 0031626669008

Product: Mercury free Clinical thermometer

Model: CR.W00

Classification: Im According to Rule 5, Annex IX of MDD 93/42/EEC amended by 2007/47/EC

Harmonized Standards:

EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008+A1:2013, EN ISO 14971:2012, EN 12470-1:2000+A1:2009, GB1588:2001, ISO 719:1985.

Conformity Assessment Route: Annex V, MDD 93/42/EEC amended by 2007/47/EC

We herewith declare that the above mentioned products meet the provisions of the Council Directive 93/42/EEC amended by 2007/47/EC for medical devices. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer.

Notified Body: INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Inc.

Address: trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin Czech Republic

EC certificate No.: 19 0248 QS/NB

Date of issue: 2019-05-22

date of validity: 2024-05-21

Version: H

Ding Yan Ping / General Manager

Signature:

Ding Yanping

Date:

June 25th 2019

WUXI MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO., LTD
无锡市医用仪表厂有限公司

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 10.10.2011	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

DM330-3	Sfigmomanometro ad aneroide standard LOGIKO VISUAL
----------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione della pressione arteriosa.

Caratteristiche principali

Scala 0-300 mmHg. Rilascio massimo dell'aria a rubinetto chiuso: 4mmHg/minuto. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260mmHg a 15mmHg tempo di deflazione massimo: 10 secondi. Scala graduata di 2mmHg in 2mmHg con tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Sfondo del manometro di colore bianco, numeri blu e lancetta di colore nero. Parti metalliche cromate. Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente). Bracciale in nylon con chiusura a velcro e anello in metallo. Monopalla in PVC con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Ogni sfigmomanometro viene confezionato in scatola di cartone stampato.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	WENZHOU KANGJOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I con funzione di misura
Codice di classificazione GMDN	16156
Codice di classificazione CND	C9006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala	0-300 mmHg ogni 2 mmHg
Tempo di deflazione massimo	10 Sec.

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Bracciale	Nylon
Monopalla	PVC
Lattice	Assente

DIMENSIONI

Manometro	Diametro 50 mm
Bracciale	Per conferenza del braccio 26/36 Cm

VARIANTI

DM330 – Senza fonendoscopio	DM333 – Con fonendoscopio
DM331 – Con bracciale senza D/RING	DM332 – Versione bambini



Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex V
(Devices in class I with measuring function)

No. G2M 067329 0010 Rev. 01

Manufacturer: **Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd.**
81 Liuzhai Luodong South Street, Yongzhong
325000 Wenzhou, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC-Representative: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY

Product Category(ies): **Aneroid Sphygmomanometer**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for the manufacture in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system covers those aspects of manufacture concerned with the metrological requirements of the respective devices / device categories and conforms to the requirements of this Directive. It is subject to periodical surveillance. See also notes overleaf.

Report No.: SH1852011

Valid from: 2018-12-17

Valid until: 2023-10-01

Date, 2018-12-17

Stefan Preiß



Benannt durch/Designated by
 Zentralstelle der Länder
 für Gesundheitsschutz
 bei Arzneimitteln und
 Medizinprodukten
 www.zlg.de
 ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System
 Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex V
 (Devices in class I with measuring function)

No. G2M 067329 0010 Rev. 01

Facility(ies):

Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd.
 81 Liuzhai Luodong South Street, Yongzhong, 325000 Wenzhou,
 Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nanjing Kangju Medical Instrument Co.,Ltd.
 27 Huashan Road Gaochun Economy Zone, 211300 Nanjing,
 Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TÜV SÜD
 ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



A4 / 07.17

piuma
Up3

Prevenzione del decubito

fino al III stadio



Valvola
CPR

H: 13 cm

8 elementi
centrali
microforati

Funzione
cuscino
nei primi
3 elementi

17 elementi

Compressore
fissabile al letto

Connettore veloce
e tappo funzione trasporto



Funzioni

Allarmi

Visivi e sonori



ALTERNATO



STATICO



BASSA PRESSIONE

Cod. **LAD470** Kit materasso Nylon® + PVC, compressore e coperta Nylon® + PU
Cod. **LAD471** Kit materasso Nylon® + TPU, compressore e coperta Nylon® + PU
OPTIONAL Cod. **LAR702** Coperta bielastica, antimicrobica, impermeabile,
traspirante e verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco

	L:	P:	H:	
Materasso	196 cm	86 cm	13 cm	160 Kg
Compressore	30 cm	13,5 cm	11 cm	-

piuma
Up3

Prevenzione del decubito

fino al IV stadio



Valvola
CPR

H: 20,3 cm

8 elementi
centrali
microforati

Funzione
cuscino
nei primi
4 elementi

20 elementi

Compressore
fissabile al letto

Connettore veloce
e tappo funzione trasporto



Funzioni

Allarmi

Visivi e sonori



ALTERNATO



STATICO



BASSA PRESSIONE

Cod. **LAD475** Kit materasso Nylon® + PVC, compressore e coperta Nylon® + PU
Cod. **LAD476** Kit materasso Nylon® + TPU, compressore e coperta Nylon® + PU
OPTIONAL Cod. **LAR703** Coperta bielastica, antimicrobica, impermeabile,
traspirante e verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco

	L:	P:	H:	
Materasso	200 cm	86 cm	20,3 cm	200 Kg
Compressore	30 cm	13,5 cm	11 cm	-

piuma
Up4

Prevenzione del decubito

fino al IV stadio



Valvola
CPR

H: 20,3 cm

8 elementi
centrali
microforati

Funzione
cuscino
nei primi
4 elementi

20 elementi

Compressore
fissabile al letto

Connettore veloce
e tappo funzione trasporto



Funzioni

Allarmi

Visivi e sonori



TEMPO
DI CICLO



ALTERNATO



STATICO



MAX
FIRM



SEAT
INFLATE



BASSA
PRESSIONE



MANCANZA
CORRENTE



ASSISTENZA
TECNICA

Cod. **LAD480** Kit materasso Nylon® + PVC, compressore e coperta Nylon® + PU
Cod. **LAD481** Kit materasso Nylon® + TPU, compressore e coperta Nylon® + PU
OPTIONAL Cod. **LAR703** Coperta bielastica, antimicrobica, impermeabile,
traspirante e verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco

	L:	P:	H:	
Materasso	200 cm	86 cm	20,3 cm	200 Kg
Compressore	30 cm	13,5 cm	11 cm	-

piuma
Up4

Prevenzione del decubito

fino al IV stadio



Valvola
CPR

H: 20,3 cm

8 elementi
centrali
microforati

Funzione
cuscino
nei primi
4 elementi

21 elementi

Compressore
fissabile al letto

Connettore veloce
e tappo funzione trasporto



Funzioni

Allarmi

Visivi e sonori



TEMPO
DI CICLO



ALTERNATO



STATICO



MAX
FIRM



SEAT
INFLATE



BASSA
PRESSIONE



MANCANZA
CORRENTE



ASSISTENZA
TECNICA

Cod. **LAD491** Kit materasso Nylon® + TPU, compressore e coperta Nylon® + PU
OPTIONAL Cod. **LAR705** Coperta bielastica, antimicrobica, impermeabile,
traspirante e verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco

	L:	P:	H:	
Materasso	208 cm	86 cm	20,3 cm	200 Kg
Compressore	30 cm	13,5 cm	11 cm	-

Serie
piuma
Up

Sistemi antidecubito

per terapie domiciliari e a lungo termine

LEVITAS®



La cura e la prevenzione delle piaghe da decubito

La cura e la prevenzione delle lesioni da decubito prevede iter specifici, con cure locali e sistemiche da valutare caso per caso, in termini generali è opportuno prevedere sia il ricorso a manovre di frequente mobilizzazione del paziente che l'utilizzo, costante, di ausili volti a ridurre e ridistribuire la pressione di appoggio.

E proprio con la finalità di rispondere con specificità alle esigenze di prevenzione di tutti coloro che, per malattia, anzianità o decorso postoperatorio, sono costretti ad uno stato di immobilità, Moretti Spa ha aggiornato ed ampliato la propria linea Piuma Up di Levitas.

Il marchio "Piuma Up" firma oggi una gamma ampia, aggiornata e specializzata di materassi ad aria con compressore, grazie ai quali predisporre una soluzione antidecubito dinamica, per pazienti con lesioni da decubito fino al IV stadio.

La linea Piuma Up di Levitas by Moretti Spa

La linea si propone di rispondere con specificità anche alle casistiche più problematiche e complesse e si compone di sette diversi kit composti da materasso, compressore e coperta coprimaterasso (solo Piuma Up 3 e 4).

La gamma "Piuma Up" offre quattro diverse soluzioni:

Piuma Up e Piuma Up 1

per i livelli di decubito al I stadio

Piuma Up 2

per i livelli di decubito fino al II stadio

Piuma Up 3 e Piuma Up 4

per i livelli di decubito fino al IV stadio



Prevenzione del decubito
fino al I stadio

H: 7,6 cm



130 celle

Compressore
fissabile al letto

Funzione



ALTERNATO

Cod. LAD462 Kit materasso a bolle e compressore Piuma Up

	L:	P:	H:	
Materasso	200 cm	90 cm	7,6 cm	135 Kg
Compressore	27 cm	13 cm	10,5 cm	-



Prevenzione del decubito
fino al I stadio

H: 15,2 cm



260 celle

Compressore
fissabile al letto

Funzione



ALTERNATO

Cod. LAD464 Kit materasso a bolle e compressore Piuma Up 1
OPTIONAL Cod. LAR306 Coperta standard in PU

	L:	P:	H:	
Materasso	200 cm	90 cm	15,2 cm	145 Kg
Compressore	27 cm	13 cm	10,5 cm	-



Prevenzione del decubito
fino al II stadio

H: 10,2 cm



20 elementi

Compressore
fissabile al letto

Funzione



ALTERNATO

Cod. LAD463 Kit materasso in Nylon® + PVC e compressore Piuma Up 2
OPTIONAL Cod. LAR304 Coperta standard in PU
OPTIONAL Cod. LAR305 Coperta bielastica

	L:	P:	H:	
Materasso	200 cm	86 cm	10,2 cm* 12 cm**	145 Kg
Compressore	27 cm	13 cm	10,5 cm	-

*solo elemento **inclusa base di supporto

I vers. - 02-2021 - Moretti Service&Consulting



DISTRIBUITI DA



www.morettispa.com



CE Conformi al nuovo regolamento
MDR 2017/745 EU

LAD464
Materasso antidecubito a bolle con compressore e regolazione PIUMA - UP
Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Il PIUMA-UP è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 260 celle, di altezza 15,2 cm, particolarmente confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci in metallo plastificato permettono di appendere il compressore all'estremità del letto. Disponibile coperta opzionale dedicata in PU con lacci di fissaggio

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35226
Codice di classificazione CND	Y033306
Codice nomenclatore DM 332/99	04.33.06.018
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.33.06.015
Repertorio dei Dispositivi Medici	1732747

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220V / 50-60 Hz
Fusibile interno	T1AL - 250V
Classificazione elettrica	Classe II Tipo BF
Potenza	18W
Pressione erogata	40-100 mmHg
Uscita d'aria	6-7 l/min
Rumorosità	32-34 dbA
Tempo di un ciclo completo	6 Min
Grado di Protezione	IP 21

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Cavo Alimentazione	200 Cm
Peso Max Paziente	145 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Materasso	PVC Medicaie
DIMENSIONI	
Dimensioni compressore	27x13x10,5 cm
Peso compressore	1,1 Kg
Dimensioni materasso (senza risvolti)	Circa 200x90x15,2 cm + 50 Cm Risvolto
Peso materasso	4,6 Kg
Altezza cella gonfia	15,2 cm
Spessore totale materiale	0,70 mm
Numero Celle	260
Confezionamento	Scatola di Cartone.
COMPONENTI	
LAR054	Materasso a bolle
LAR242	Compressore
ACCESSORI	
LAR306	Coperta standard in PU con lacci di fissaggio

Siete in → Kyara → Sanitari → Contenitori per urine - padelle - vasi



Contenitore per urine - Urinale in polietilene - Uomo

Capacità: 1000 ml

CODICE PRODOTTO: ST590

Categoria: Contenitori per urine - padelle - vasi