



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1289 din "28" 04 2022

OE participanți la procedura de achiziție

Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1637662036151 privind *Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022* din 23.11.2021, vă comunică decizia din 27.04.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Cod	Denumire Lot	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model Producător/ de Origine	art/ Tara	Producător	Tara de Origine	Ofertant
20	20-36151	Micro-ghid cateter coronarian cu dublu lumen	5	11960	12916,80	59 800,00	64 584,00	FineDuo® Dual Catheter NC-D724	Lumen	Japonia	KANEKA CORPORATION	DataControl SRL
21	21-36151	Baloane PTCA semicompliante	130	1090,00	1177,20	141 700,00	153 036,00	Biosensors PowerLine™		Switzerland	Biosensors Intencional	Tribestar Farm

32	32-36151	Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS	150	10440	10440,00	1 566 000,00	1 566 000,00	Ultimaster™ Tansei Sirolimus Eluting Coronary Stent System DE-RQ2209KSM DE-RQ2212KSM DE-RQ2215KSM DE-RQ2218KSM DE-RQ2221KSM DE-RQ2224KSM DE-RQ2228KSM DE-RQ2233KSM DE-RQ2238KSM DE-RQ2509KSM DE-RQ2512KSM DE-RQ2515KSM DE-RQ2518KSM DE-RQ2521KSM DE-RQ2524KSM DE-RQ2528KSM DE-RQ2533KSM DE-RQ2538KSM DE-RQ2709KSM DE-RQ2712KSM DE-RQ2715KSM DE-RQ2718KSM DE-RQ2721KSM DE-RQ2724KSM DE-RQ2728KSM DE-RQ2733KSM DE-RQ2738KSM DE-RQ3009KSM	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	DataControl SRL
----	----------	--	-----	-------	----------	--------------	--------------	---	--------	-----------------------	-----------------

37	37-36151	Stent-graft coronarian	2	13409,00	13409,00	26 818,00	26 818,00	PK.Papirus	Elveția	BIOTRONIK AG	CAVATEH SRL	M
41	41-36151	Set pompă cu manometru tip "pistol"	125	315,00	378,00	39 375,00	47 250,00	42.04.40052	China	SCW MEDICATH LTD	Labromed Laborator SRL	
44	44-36151	Conectoare Y	20	135,00	135,00	2 700,00	2 700,00	42.03.10001	China	SCW MEDICATH LTD	Labromed Laborator SRL	
53	53-36151	Seringi pentru injectare substanță contrast	20	38	41,04	760,00	820,80	42.07.10002	China	SCW MEDICATH LTD	Labromed Laborator SRL	
56	56-36151	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	50	1969	2126,52	98 450,00	106 326,00	Angio-Seal™ VIP Closure Device 610132 610133	SUA	TERUMO MEDICAL CORPORATION	DataControl SRL	
57	57-36151	Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale	50	2450	2646,00	122 500,00	132 300,00	FEMOSEAL™ C11202	SUA	TERUMO MEDICAL CORPORATION	DataControl SRL	
67	67-36151	Ochelari cu radioprotectie	2	5040	6048,00	10 080,00	12 096,00	Lead eyeware Art.: model: Panorama 700	Turcia	Aktif x-ray	DataControl SRL	
70	70-36151	Cateter suport periferic armat	10	1800	1944,00	18 000,00	19 440,00	Navicross® Support Catheter WS*NS350G3HM WS*NS35093HM WS*NS350N3HM WS*NS35153HM	Belgia	TERUMO CORPORATION	DataControl SRL	

						WS*NA350G3HM		
						WS*NA35093HM		
						WS*NA350N3HM		
						WS*NA35153HM		

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Set introducător puncție radial profil ultra-subțire

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde cerințelor "cu profil ultra subțire: diametre externe la 6F < 2.5 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului". Teaca prezentata de 6F are diametrul extern de 2.65 mm.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: solicitat Ac de puncție metalic de 21-22 G, oferit coduri pentru Entry Needle Diameter 20 G, solicitat Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm, oferit coduri cu Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 16 cm (RM*RSSJ10PQ, RM*ESSJ10SQ, RM*RS6J10PQ, RM*ES6J16PQ, RM*ES6J16SQ, RM*ES6J16SQ).

Lotul 2 Set introducător puncție radial lung

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde cerințelor "Ac de puncție metalic de 21 G. Mini-ghid diametrul de 0.018". Setul prezentat are ac de puncție 18 G si mini-ghid de 0.038".
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 3 Set introducător puncție femural scurt

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde cerințelor "Rezistența la kinking, si inel rotativ de sutură pentru fixare la piele". Teaca prezentata nu este rezistentă la kinking si nu are inel rotativ de sutura pentru fixare la piele, locul suturii fiind preconizat pe side-port.
- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: În catalogul produselor Lepu Medical se ofera teaca in lungimi de 5-11, si nu de 7-13, dupa cum s-a solicitat. A fost solicitată mostra. Mostra a fost evaluată, nu este rezistentă la kinking.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Ac de puncție metalic de 18 G. Mini-ghid de 0.035-0.038", de 45-50 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 4, 5, 6, 7, 8, 9 F, lungimi 7-13 cm, oferit coduri CARE CORESPUND PRECUM SI CODURI CARE NU CORESPUND cu Teaca dimensiuni disponibile: 10, 11 F, Mini-ghid de 0.025", Ac de puncție metalic de 20 G.
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 4 Set introducător puncție femural lung

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde "mini-ghid otel lungime 80 cm, teaca lungime 23-25 cm si inel rotativ de sutura pt fixare la piele". Mini-ghidul are lungime 45 cm, teaca lungime 11 cm si nu are inel rotativ de sutura pentru fixare la piele, locul suturii fiind preconizat pe side-port.

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: mostra prezentata nu corespunde s-a solicitat lungime 80 cm s-a prezentat de 45 cm; Teacă dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F s-a prezentat de 4 F; Teacă, lungime 23-25 cm s-a prezentat de 11 cm;

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 5 Catetere diagnostic angiografice

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 4 F =1.07 mm, oferit Inner Diameter Of The Shaft 0.041 in / 1.03 mm, solicitat Lungimea disponibila a catetelor: 100 si 125 cm, oferit coduri cu lungimea catetelor 80 cm (RQ-4CR2508M, RQ-4CR2508M*), oferit coduri cu lungimea catetelor 65 cm (RQ-4SPS04GM, RQ-4SP008GM), oferit coduri cu lungimea catetelor 90 cm (RQ-4SP0089M), nu au fost oferite urmatoarele curburii: ULT, IMA, Simmons.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: nu ofera lungimea catetelor de 125 cm si nu se ofera toate varietatile de curburi solicitate ULT, Simmons.

Lotul 6 Catetere diagnostice coronare

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungimea catetelor va fi de: 100 și 110 cm, oferit coduri pentru Lungimea catetelor va fi de: 65, 80, 90, 100 și 110 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 7 Ghid hidrofilic moale tip standard

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Conform catalogului produselor Lepu Medical, ghidul Ultraskin nu corespunde cerințelor "diametre 0.025" si 0.038" si nu este disponibil in lungimi <150 cm" s-a oferit de 150 și 180.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungimi: 80-260 cm., oferit Lungimi: 50-300 cm (RF-GA35053M, RF-GA35303M).

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungimi: 80-260 cm. Diametre: 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: drept, angulat, oferit Lungimi: 150-260 cm. Diametre: 0.035". Configurații vârf: angulat (J-curved).

Lotul 8 Cateter ghid pentru coronare

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat forme AL, AR, JL, JR, IMA, LCB, RCB, MP, RDC, SBS. Dispune doar de formele: AL, AR, JL, JR, ".

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

Lotul 9 Catetere ghid pentru abord radial

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

Lotul 10 Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungime 90 cm, oferit coduri cu lungimea catetereilor D*= 90 cm, K+ = 55cm, W++ = 47 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 11 Ghiduri pentru angioplastie Tip soft

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Incarcatura vârfului 0.6-1 gf, oferit coduri cu 0.6, 1, 3.6 gf (TW-DS4181A).

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 12 Ghid pentru angioplastie coronariană tip standard

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde parametrilor tehnici solicitați "Ghid pentru angioplastie coronariană", "Diametrul de 0.014". Ghidul prezentat nu este destinat pt angioplastie coronariană, este un ghid mai gros, de 0.035".

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrilor tehnici solicitați "Ghid pentru angioplastie coronariană", "Diametrul de 0.014". Ghidul propus nu este destinat pt angioplastie coronariană, este un ghid mai gros, disponibil în diametre de 0.018", 0.025", 0.032" și 0.035".

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Solicitam mostra pentru aprecierea suportului și rezistenței la kinking. Mostra a fost prezentată cu întârziere. Nu corespunde deoarece sa solicitat - Fara desprinderea spirelor în timpul modelării vârfului. Sa oferit mostra cu desprinderea spirelor în timpul modelării vârfului.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 13 Ghid tip extrasupport

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu ușurința a stenozelor. Construit din Nitinol, ofera un excelent suport și rezistența la Kinking. Diametrul de 0.014". Lungime de 180-200cm. Varf atraumatic disponibil în varianta soft-pentru menținerea formei în vas. S:TRadioopacitate distală: 3 cm. Prezența de 2 markeri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. Conform catalogului produselor Lepu Medical, ghidul Balancun nu corespunde parametrului de baza solicitat "Extra-support, shaft-ul pana la varf sa fie puternic". Acesta este un ghid cu suport moderat.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 14 Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Incarcatura varfului 0.8-3.8 gf pentru suport mediu, oferit coduri cu 0.6, 1, 3.6 gf, solicitat Lungime 180-200 și 300 cm., oferit 180 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 15 Ghid pentru angioplastie cu suport inalt

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Incarcatura varfului ≥ 3.6 gf., oferit coduri cu 0,6, 1, 3.6 gf, solicitat Lungime 180-200 și 300 cm., oferit 180 cm.
 - Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
 - Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
 - Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Incarcatura vârfului de la 3 până la 20 gf., oferit Fielder- tip load - 1.0 g, Fielder FC tip load - 0.3 g, Fielder XT tip load - 0.8 g.
 - Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
 - Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: solicitat Incarcatura vârfului 1-1.5 gf, oferit coduri cu 0,6, 1, 3.6 gf, solicitat Disponibil lungimi de 180-190cm., oferit 180 cm.
 - Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
 - Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Lotul 18 Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport inalt**
- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
 - Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Lotul 19 Micro-ghid cateter coronarian**
- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, conform catalogului produsului Navitan, acoperirea hidrofilica este de 70 cm, s-a solicitat 60 cm. S-a solicitat cu posibilitate de insurubare, dar acesta nu da posibilitatea de insurubare.
 - Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
 - Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 21 Baloane PTCA semicompliante

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: corespunde: oferit Solarice, iar codul SPL este de la modelul vechi Sprinter care este scos din linia de producere. Codurile pentru Solarice este SLC. SA SOLICITAT Diametre balon: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, Sa oferit coduri pentru mai multe marimi Diametre balon: 2.25 mm, 3.25 mm, 3.75 mm. Lungimi balon: 06 mm, 12 mm.

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: SA SOLICITAT Diametre balon: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Sa oferit Diametre balon: 1.5 mm, 1.75 mm, 2.00 mm.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 22 Baloane semicompliante de lungimi mari

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Lungimea shaft 145 cm s-a oferit 142. Lungimea balonului s-a solicitat 20-40 s-a oferit 10-30 mm.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Lungimea shaft 145 cm s-a oferit 142.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 23 Baloane semicompliante monorail sau OTW

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat diametru 1,5-5,0 mm s-a oferit 1.5 -4.00 mm; L 8-40 mm s-a oferit 10-30 mm.

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat diametru 1,5-5,0 mm s-a oferit 2.5 -4.00 mm; L 8-40 mm s-a oferit 8-30 mm.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 24 Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicitat Diametre disponibile: 1.2, 1.5, 2.0 mm s-a oferit 1,5-2,0 mm.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat Diametre disponibile: 1.2. 1.5. 2.0 mm s-a oferit 1,25 -1,5, 2,0 mm; lungime disponibilă de 8 mm, până la 20 mm.

S-a oferit 10-40 mm.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 25 Baloane PTCA noncompliant

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). s-a oferit 2.1 F (0,69 mm). s-a solicitat Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pina la 5.0 mm s-a oferit de la 2.0 pînă la 4.00 mm.
- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicita Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pina la 5.0 mm s-a oferit de la 2.0 pînă la 4.50 mm; Lungimi disponibile de la 6 pina la 30 mm s-a oferit de la 8- 25 mm. s-a solicitat Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). s-a oferit 2.1 F (0,70) mm.
- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicitat Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). s-a oferit 0,7366 mm.
- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 26 Balon non-compliant de diametre mari

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicita Dimensiuni: diam. disponibile de la 4.0 pina la 6.0 mm s-a oferit de la 2.0 pînă la 4.50 mm. Lungimi disponibile de la 6 pina la 30 mm s-a oferit de la 8- 25 mm.
- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 27 Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicita Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pina la 5.0 mm s-a oferit de la 2.0 pînă la 4.50 mm. Lungimi disponibile de la 6 pina la 30 mm s-a oferit de la 8- 25 mm.

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicita Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pînă la 5.0 mm s-a oferit de la 1.5 pînă la 4.50 mm. Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm s-a oferit 135 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 28 Balon „cutting”

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 29 Balon farmaceutic activ

- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime cateter 145 cm, s-a oferit de 142 cm.

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat lungime de la 15 la 30 mm, oferit coduri cu lungimea catetelor 14 cm (FLC P20 014 B12, FLC P22 014 B12, FLC P25 014 B12, FLC P27 014 B12, FLC P30 014 B12, FLC P32 014 B12, FLC P35 014 B12, FLC P37 014 B12, FLC P40 014 B12), oferit coduri cu lungimea catetelor 40 cm (FLC P25 040 B12, FLC P30 040 B12, FLC P35 040 B12, FLC P40 040 B12), nu au fost regăsite confirmări pentru cerințele tehnice: Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm, Compatibil cu ghid de 0.014”.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

Lotul 30 Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antistenoza- Everolimus polimer

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrul tehnic solicitat "cu eliberare substanta antistenoza-Everolimus > 100 µg/cm²". Stentul propus este cu eliberare de substanta Sirolimus 1,4 µg/mm².

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 31 Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antistenoza- Everolimus polimer

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 32 Stent coronarian farmaceutic activ SIROLIMUS

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrul tehnic solicitat, conform catalogului produsului FlexyRap: „Grosime strut: 80 µm, substanta activa: Sirolimus

în doza 3.0-4.0 µg/mm” și “Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni”. Are grosime 60 µm, doza Sirolimus de 1.0 µg/mm și timpul de degradare de 7-9 luni.

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrului tehnic solicitat „Grosime strut: 80 µm, substanta activa: Sirolimus în doza 3.0-4.0 µg/mm”. Are grosime 62-65 µm, doza Sirolimus de 1.4 µg/mm.

Lotul 33 Stent coronarian farmaceutic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrului tehnic solicitat „substanta activa: Sirolimus în doza >=1.25 µg/mm”. Are doza Sirolimus de 1.0 µg/mm, conform catalogului produsului.

- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrului tehnic solicitat “Lungimi stent de la 8 până la 48 mm”. Are lungimi disponibile 9-49 mm. S-a solicitat Design de celule hybrid cu amestec de celule închise la margini și celule deschise la mijlocul stentului s-a oferit desing celule deschise. Polimer bioabsorbabil s-a oferit polimer biostabil (durabil/non absorbabil).

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Conform catalogului stentului Orsiro, nu corespunde parametrului tehnic solicitat “Lungimi stent de la 8 până la 48 mm”. Are lungimi disponibile 9-40 mm. Diametre diabolice de la 2.0 până la 4.5 mm s-a oferit 2.0 până la 4.00 mm.

Lotul 35 Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungime utila shaft 120-140 cm, sa oferit Lungime utila shaft 142 cm.

Lotul 36 Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- biolimus

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: nu corespunde: solicitat Material stent: aliaj cobalt-crom. Oferit oțel inox 316L STAINLESS STEEL.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 38 Cateter pentru aspirare oculuzii temporara

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: nu a fost demonstrat lungimea portului RX - rapid exchange (20 cm), solicitat Marker non-radiopaci situați la 90, 100 și 110 cm din distal, oferit Marker non-radiopaci situați la 90, 100 din distal.

- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat rapid exchange (20 cm), oferit rapid exchange (17,5 cm), solicitat Marker non-radiopaci situați la 90, 100 și 110 cm, oferit fără Marker non-radiopaci.

Lotul 39 Cateter pentru trombaspirație

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată. (40 s-a prezentat 30)
- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: oferit 2 modele, modelul ASAP LP nu corespunde deoarece sa solicitat fara stilet detașabil oferit cu stilet detașabil.

Lotul 40 Set inflator cu manometru de presiuni mici

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat tub de extenzie minim 30 cm, oferit tub de extenzie 25 cm.
- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Continut: indeflator, valva hemostatica, tub de extenzie minim 30 cm, torquer, introducător fir ghid 0,014 inch, oferit cod BIDD6000 - indeflator.

Lotul 41 Set pompă cu manometru tip "pistol"

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 42 Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat tub de extenzie minim 30 cm, oferit tub de extenzie 25 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat capacitate rapida de a ajunge la presiunea de 35 atm, Tub de extenzie minim 30 cm, oferit presiunea de 30 atm, Tub de extenzie minim 25 cm.

Lotul 43 Dispozitiv digital de umflare

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

Lotul 45 Ac punctie

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat disponibilitate de calibru 18-22 G, lungime de 4-7 cm, oferit IN4000: și IN4002 cu 18G 7 CM. Nu conține informații referitor la Ghid compatibili: 0.018"-0.038".

Lotul 46 Manifold cu 3 robineti

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Manifold cu 3 robineti, oferit model A15 care conține 6 coduri dintre care 2 coduri sunt pentru Manifold cu 2 robineti (LPJD502N, LPJD502F), nu are Posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de

aceasta. Nu s-a răspuns la clarificare: prezentare catalog cu marcarea modelului oferit și Contine: Confectionat din polycarbonate. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 1 pana la 5 porturi. Lumen intern de 2.36 mm. Posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremități.

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 47 Tub injectare substanță de contrast

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: solicitat Din PVC, nu prezintă materialul în catalog pentru PVC sunt alte coduri. S-au solicitat lungimi disponibile 51, 76, 122, 150, 183 cm. S-a oferit 50, 75, 120, 150, 180 cm.

Lotul 48 Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Mark 7 Arterion"

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu sa răspuns la clarificare: prezentare catalog cu marcarea modelului oferit și Contine: 1. Seringa 150 ml. Material: polycarbonat transparent. Prevezuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). 2. Tub umplere. Material: polietilena cu densitate mica, Lungime totala 40mm. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului sau de o autoritate competenta.

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu sa răspuns la clarificare: Material: policarbonat transparent. Prevezuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). 2. Tub umplere. Material: polietilena cu densitate mica, Lungime totala 40mm. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului sau de o autoritate competenta.

Lotul 49 Set sterili getabili pentru angiografie

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat mostra;

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat mostra;

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde: 1. ghidul angiografic trebuie sa fie minim. 175 cm dar se ofera de 150 cm; 2. câmpul adeziv de la cele patru orificii este cu lipici cu 2 fețe dar acesta se exclude conform specificațiilor; 3. câmpul superabsorbant trebuie să fie cu 6 straturi și să absoarba 500 ml dar este cu 3 straturi și absoarbe aproximativ 150 ml.

- Oferta operatorului economic **Tehnomedica** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%, oferit 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x330 cm, integru, impermeabil 100%.

Lotul 50 Set sterili getabili pentru angiografie prin abord radial

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat mostra;

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat mostra;

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035" oferit Ghid angiografic 150 cm, J3, 0,035".

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 51 Câmp sterili super absorbant

- Oferta operatorului economic **Medgloballarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde "din 3 straturi", se propune din 2 straturi. Se propune lipici cu fata dubla, dar acesta se exclude conform specificațiilor tehnice.

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde "din 3 straturi", se propune din 1 strat. Capacitatea de absorbție este < 2 ml/dm², nu are strat adeziv aplicat pe margine.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat mostra;

- Oferta operatorului economic **Tehnomedica** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător, oferit Product Performance Critical Product Area / Product Performance Less Critical Product Are - 1,8., solicitat strat impermeabil pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni,, oferit 40 microni.

Lotul 52 Mănuși biogel

- Oferta operatorului economic **Tehnomedica** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: sa solicitat non-alergene, oferit Contra-indications: this product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic responses. Allergenicity: Biogel gloves are produced to have low levels of aqueous extractable protein and have been shown to have a low potential for inducing allergic contact dermatitis or 'type IV allergy'.

Lotul 54 Capot (halat) chirurgical sterili

- Oferta operatorului economic **Medgloballarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: solicitat polipropilen, oferit Polyurethane, solicitat Lungimea halatului minim 140 cm din umeri pana la poale, oferit pentru mărimea XL - 135 cm (+-2%), nu este specificat în documentația tehnică dacă va fi ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza, dar este indicat în specificații tehnice.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 55 Extensie pentru cate-ghiduri

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Dimensiuni disponibile: 5, 6, 7 si 8 F. 2 markeri radioopaci in distalitate, oferit Dimensiuni disponibile: 6, 7 F. 1 marker radioopac in distalitate.

Lotul 56 Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat mostra;

Lotul 58 Sistem de comprese dupa punctie radiala

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 62 Set electrod endocardial pentru stimulare temporara

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 63 Șort de radioprotecție

- Oferta operatorului economic **MEDEXCOM-TEH SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra; nu corespunde echivalent în Pb 0.25 mm dorsal. Sortul propus ofera doar protecție frontala si nu ofera protecție dorsala.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

Lotul 64 Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă)

- Oferta operatorului economic **MEDEXCOM-TEH SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu s-a prezentat mostra costumului in intregime, s-a prezentat doar mostra fustei, nu si a vestei. Nu corespunde echivalent in Pb 0.5 mm (fusta). Are. echivalent in Pb de 0.35 mm.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Echivalent in Pb: 0.50 mm frontal / 0.25 mm dorsal (vestă); 0.50 mm (fustă)., Disponibile în mărime S, M, L., ofertă Echivalent in Pb: 0.35 mm frontal / 0.25 mm dorsal. Disponibile în mărime M.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 65 Guler radioprotecție tiroidian

- Anulara lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice (**Costum radioprotecție din 3 piese (vestă + fustă+guler)**), la solicitarea beneficiarului final.

Lotul 66 Paravan radioprotecție cu sticla

- Oferta operatorului economic **MEDEXCOM-TEH SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 67 Ochelari cu radioprotecție

- Oferta operatorului economic **MEDEXCOM-TEH SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a evaluat mostra: nu corespunde "sa ofere protecție laterala extinsa prin insertii aditionale in cadru". Nu ofera protecție laterala extinsa si nu are insertii laterale in cadru.

Lotul 68 Viziere cu radioprotecție

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat mostra;

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 69 Teacă-ghid armată

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Valva hemostatică de tip "cross-cut". Configurații: Straight, Hockey Stick, MP, RDC, LIMA. Diametrul intern: 5 Fr – 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – 0,087" (2,2 mm); 7 Fr – 0,100" (2,5 mm); 8 Fr – 0,114" (2,9 mm)., oferit coduri pentru Valva hemostatică de tip "cross-cut" și Tuohy-Borst Valve. Configurații: Straight, Hockey Stick, MP, RDC, nu a oferat LIMA. Diametrul intern: 5 Fr – 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – 0,087" (2,2 mm); 7 Fr – 0,101" (2,5 mm); 8 Fr – 0,115" (2,9 mm).

Lotul 71 Cateter suport periferic flexibil

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungimi disponibile: 90, 135 și 150 cm. Lumen ghid de 0.014", 0.018" și 0.035". Compatibil teacă 5 F. Presiune maximă infuzie: 300 psi., oferit 65, 90, 135 și 150 cm, Guidewire Compatibility de 0,035". Minimum Introducer Sheath Compatibility 4 F. Maximum Injection Pressure 750 psi - NAVICROSS® 0.035".

Lotul 72 Ghid periferic hidrofilic, de tip stift

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Ghid de tip stift din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Lungimi disponibile de la 150 până la 300 cm., oferit denumire comercială fără a indica exact modelul oferat, pentru Hydrophilic Coated Guidewire, producătorul în catalog prezintă următoarea specificație tehnică: Diametru 0.025" - 0.032". Lungimi disponibile de la 150 până la 180 cm.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Diametru 0.035". Lungimi disponibile de la 150 până la 300 cm. Lungimea vârfului flexibil: 30 mm., oferit coduri pentru Diametru 0.035", 0.02", 0.025", 0.038", Lungimi disponibile de la 80 până la 300 cm., Lungimea vârfului flexibil: 30 mm, 80 mm, 10 mm.
- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 73 Ghid periferic schimb dispozitive

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Diametrul 0,035", Lungimi disponibile 260 si 300 cm., oferit coduri pentru Diametrul 0,035", 0,018", 0,014". Pentru Diametrul 0,035" a oferit doar Lungimi disponibile 260, deși codurile conțin Lungimi disponibile 180 si 300 cm doar pentru Diametrul 0,018" și 0,014".

Lotul 74 Ghid periferic segmente supra- și infrapalnice.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Diametre disponibile de 0.014" si 0.018", oferit Diametrul 0,035", 0,018", corespund 6 coduri din 10 (nu corespund codurile:RA*CA35185CM, RA*CA35265CM, RA*CS35185CM, RA*CS35265CM) solicitat lungimi de 180, 260 si 300cm, pentru Diametrul solicitat 0,018", 0,014" nu au lungimea 260 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 75 Ghid periferic ocluzii cronice calcificate

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungimi disponibile: 200, 235 și 300 cm, oferă Lungimi disponibile: 200, 180 și 300 cm, nu oferă 235 cm. Solicitat Configurații vârfl: drept și preformat., oferit Configurații vârfl: drept.

Lotul 76 Micro-ghid cateter

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Cateter de 2,4 Fr, Cateter de 2,7 Fr, Cateter de 2,8 Fr, oferit coduri pentru Cateter de 2,4 Fr, Cateter de 2,7 Fr. Cateter de 2,8 Fr, Cateter de 2,0 Fr. Solicitat compatibilitate cu microsfere de embolizare de până la 700 microni pentru Cateter de 2,4 Fr și microsfere de embolizare de până la 900 microni pentru Cateter de 2,7 Fr.,Cateter de 2,8 Fr. oferit compatibilitate cu microsfere de embolizare de până la 600 + - 75 microni pentru Cateter de 2,4 Fr și microsfere de embolizare de până la 800 + - 75 microni pentru Cateter de 2,7 Fr.,Cateter de 2,8 Fr.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat compatibilitatea cu catetere de 2,4 Fr., de 2,7 Fr. Și de 2,8 Fr. oferit doar 2,8 Fr. Pe toată dimensiunea (2,8 Fr-2,8 Fr), Care nu corespunde la presiune solicitat presiune maximă – 900 psi, oferit 800 psi.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 77 Micro-ghid cateter manevrabil

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: este disponibil doar în varianta OTW (s-a cerut OTW si Rx), are secțiunea varfului 0.8mm (s-a cerut 0.75mm), lumen intern 0.021” (s-a cerut 0.015”), radiopacitate distala - 2 markeri situati la distanta 13.5mm (s-a cerut radiopacitate distala 8 mm).

Lotul 78 Stent-graft periferic

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: nu corespunde: solicitat Stentul este din oțel inoxidabil, oferit The cobalt-chrome stent. Solicitat Diametru: până la 9 mm, lungime până la 30 mm, ofertă Diametru: până la 10 mm, lungime până la 58 mm. Nu oferă nr. de catalog astfel sub denumirea comercială sunt coduri care nu corespund (BGP2710_1, BGP2710_2, BGP3710_1, BGP3710_2, BGP5710_1, BGP5710_2).

Lotul 79 Dispozitiv recuperare corp strain

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 80 Balon OTW 0.014” pentru angioplastie periferică

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: parametrii tehnici solicitati "Lungimi balon: 30 – 250 mm... Diametre disponibile balon: 1.5-5.0 mm". Baloanele oferite au lungimi între 40-150 mm și diametre disponibile între 2.0-4.0 mm.

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungimi balon: 30 – 250 mm., oferit 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220, solicitat Diametre disponibile balon: 1.5-5.0 mm, oferit Diametre disponibile balon: 1.5-4.0 mm, nu a oferit codurile exacte ceea ce face imposibil de evaluat oferta și de constatat cu certitudine abaterile.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 81 Balon OTW 0.018” pentru angioplastie periferică

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungimi disponibile cateter: 45, 90, 130 si 150 cm, oferit Lungimi disponibile cateter: 90, 130 si 150 cm, solicitat Presiune nominală 8 atm. RPB: 12-16 atm., oferit Nominal Pressure (NP) atm * 6., solicitat Lungimi disponibile balon de la 20 pînă la 300 mm., oferit de la 20 pînă la 200 mm. solicitat Diametre disponibile balon de la 2 pînă la 9 mm, oferit Diametre disponibile balon de la 2 pînă la 7 mm.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 82 Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrul tehnic solicitat "disponibil în varianta OTW și RX". Este disponibil doar în varianta OTW.
- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrul tehnic solicitat "Lungimi disponibile balon de la 20 pînă la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 3 pînă la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm". Balonul Joker 035 are lungimi disponibile de 20-150 mm, diametre de 4-8 mm și presiunea nominală de 6 atm.
- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrul tehnic solicitat "disponibil în varianta OTW și RX". Conform catalogului produselor Medtronic, este disponibil doar în varianta OTW.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungime utilă: 90 sau 135 cm., oferit coduri pentru Lungime utilă: 65, 90 sau 135 cm. Nu a fost demonstrat cerința Core-wire din oțel-inox.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 83 Balon medicamentos pentru angioplastie periferică

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Presiune nominală: 8 atm, oferit 6 bar.

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Presiune nominală: 8 atm., oferit Nominal pressure: 6 atm. Solicitat Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm, oferit Usable catheter length 80 cm, 135 cm.

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibiție neointimală., oferit FreePac – Paclitaxel and Urea (Excipient). Solicitat Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm., oferit Lungimi disponibile cateter: 80, 40, 130 cm. solicitat Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") și 4-8 mm (0.035"), oferit Diametre disponibile: 4-12 mm (0.035"). solicitat RPB: 12-14 atm, oferit RPB: 9-14 atm, solicitat Compatibile cu introducător de 5-7 Fr, oferit Recommended Introducer Sheath (F) de 5-9 Fr.

Lotul 84 Sistem de protecție împotriva emboliilor

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Dimensiuni vasculare de referință: 4.0-7.00 mm, Lungimea cateterului 190 cm., oferit Dimensiuni vasculare de referință: 2.0-7.00 mm, Lungimea cateterului 190/320 cm. Nu a prezentat nr. de catalog ceea ce face imposibilă evaluarea și identificarea necorespunderilor, conține coduri care corespund și coduri care nu corespund (SPD2-050-320, SPD2-060-320 ect.), corespund 4 coduri din 10.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Dimensiuni vasculare de referinta: 4.0-7.00 mm, oferit Dimensiuni vasculare de referinta: 3.0-6.50 mm. Nu a fost demonstrată cerința: Diametrul standard al porilor: 100 micrometri.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

Lotul 85 Stenturi periferice balon expandabile

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungimi 12, 18 mm, RBP 13-14 atm. Se ofera lungimi 12, 19 mm, RBP 15 atm.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Diametre disponibile: 5, 6, 7 mm. Lungimi disponibile: 12, 18 mm, oferit Diametre disponibile: 5, 6, 7 mm. Lungimi disponibile: 15, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm, solicitat Presiune nominala balon: 8-10 atm, oferit Presiune nominala balon: 6 atm, solicitat RBP: 13-14 atm, oferit RBP: 13-14 pentru diametrele 5, 6 mm și RBP: 12 pentru diametrul 7 mm., nu a oferit codul produsului, nu poate fi făcută evaluarea conformității conform codului produsului, conține coduri care nu corespund cerințelor solicitate.

Lotul 86 Stenturi periferice autoexpandabile

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat diametre 5-10 mm, lungimi 40-150 mm. Se ofera diametre 7-10, lungimi 30-80 mm.

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm., oferit Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8 mm. Lungimi disponibile: de la 20 la 200 mm. Solicitat Lungimi shaft: 120-135 cm., oferit Catheter Length 80 cm, 120cm.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legii.

Lotul 87 Stenturi autoexpandabili pentru carotida

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat cu celule închise, oferit CGuard™ EPS Micronet ® combines the benefits of open cell conformability with the Micronet ® closed cell plaque scaffolding providing continuous embolic prevention, solicitat compatibil cu cate-ghid de 7F, oferit 8F, solicitat Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm., oferit denumirea comercială care conține coduri și pentru diametru de 10 și lungimi de 20, 60.

Lotul 88 Stenturi cu meșă dublă pentru carotida

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrilor tehnici solicitați "Compatibil cu teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm". Conform catalogului produselor InspireMD, stentul CGuard este compatibil cu teaca de 6 Fr sau cu cateter de ghidare de 8 Fr, cu lungimea de shaft 135 cm.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Lungimi 25-45 mm., oferit Lungimi 20-50 mm. (coduri care nu corespund RDS-0520-143RX, RDS-0840-143RX).

Lotul 89 Embosphere microsphere

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol), oferit acrylic polymer, solicitat Microsfere codate pe culori

de dimensiune 75, 200, 400, 600, 800, și 1100 μm., oferit dimensiuni 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900 și 900-1200, solicitat Sfere compresibile >30%, oferit - Microsferele Embosphere sunt particule flexibile care permit compresie temporară de 20 până la 30% pentru a facilita trecerea prin microcatetere. nu a prezentat modelul exact al produsului deși sunt 12 modele sub denumirea comercială Embosphere® M.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

Lotul 1 Set introducător puncție radial profil ultra-subtire

Lotul 2 Set introducător puncție radial lung

Lotul 3 Set introducător puncție femural scurt

Lotul 4 Set introducător puncție femural lung

Lotul 5 Catetere diagnostic angiografic

Lotul 6 Catetere diagnostic coronare

Lotul 7 Ghid hidrofilic moale tip standard

Lotul 8 Cateter ghid pentru coronare

Lotul 9 Catetere ghid pentru abord radial

Lotul 10 Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”

Lotul 11 Ghiduri pentru angioplastie Tip soft

Lotul 12 Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard

Lotul 13 Ghid tip extrasupport

Lotul 14 Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar

Lotul 15 Ghid pentru angioplastie cu suport inalt

Lotul 16 Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in CTO

Lotul 17 Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar

Lotul 18 Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport inalt

Lotul 19 Micro-ghid cateter coronarian

Lotul 22 Baloane semicompliante de lungimi mari

Lotul 23 Baloane semicompliante monorail sau OTW

Lotul 24 Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale

Lotul 25 Baloane PTCA noncompliante

Lotul 26 Balon non-compliant de diametre mari

Lotul 27 Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate

Lotul 28 Balon „cutting”

Lotul 29 Balon farmacologic activ

Lotul 30 Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer

Lotul 31 Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer

Lotul 33 Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil

- Lotul 35 Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer
- Lotul 36 Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- biolimus
- Lotul 38 Cateter pentru aspirare ocluzii temporara
- Lotul 39 Cateter pentru trombaspiratie
- Lotul 40 Set inflator cu manometru de presiuni mici
- Lotul 42 Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"
- Lotul 43 Dispozitiv digital de umflare
- Lotul 45 Ac puncție
- Lotul 46 Manifold cu 3 robineti
- Lotul 47 Tub injectare substanță de contrast
- Lotul 48 Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Mark 7 Arterion"
- Lotul 49 Set steril getabil pentru angiografie
- Lotul 50 Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial
- Lotul 51 Câmp steril super absorbant
- Lotul 52 Mănuși biogel
- Lotul 54 Capot (halat) chirurgical steril
- Lotul 55 Extensie pentru cate-ghiduri
- Lotul 58 Sistem de compresie după puncție radiala
- Lotul 62 Set electrod endocardial pentru stimulare temporara
- Lotul 63 Șort de radioprotecție
- Lotul 64 Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă)
- Lotul 65 Guler radioprotecție tiroidian
- Lotul 66 Paravan radioprotecție cu sticla
- Lotul 68 Viziere cu radioprotecție
- Lotul 69 Teacă-ghid armată
- Lotul 71 Cateter suport periferic flexibil
- Lotul 72 Ghid periferic hidrofilic, de tip stiff
- Lotul 73 Ghid periferic schimb dispozitive
- Lotul 74 Ghid periferic segmente supra- și infrapoplitee.
- Lotul 75 Ghid periferic ocluzii cronice calcificate
- Lotul 76 Micro-ghid cateter
- Lotul 77 Micro-ghid cateter manevrabil
- Lotul 78 Stent-graft periferic
- Lotul 79 Dispozitiv recuperare corp strain
- Lotul 80 Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică
- Lotul 81 Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică
- Lotul 82 Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică
- Lotul 83 Balon medicamentos pentru angioplastie periferică
- Lotul 84 Sistem de protecție împotriva emboliilor

- Lotul 85 Stenturi periferice balon expandabile
- Lotul 86 Stenturi periferice autoexpandabile
- Lotul 87 Stenturi autoexpandabil pentru carotida
- Lotul 88 Stenturi cu meșă dublă pentru carotida
- Lotul 89 Embosphere microsphere

Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7:

Lotul 65 Guler radioprotectie tiroidian, la solicitarea beneficiarului final.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :

Lotul 59 Transductor de presiune invaziva

Lotul 60 Set linie ECG


Lotul 61 Stimulator cardiac extern monocameral temporar

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția în regim de urgență o nouă procedură de achiziție publică doar după revizuirea specificațiilor tehnice de către specialiștii cooptați, iar beneficiarii urmează să asigure necesarul pentru loturile anulate până la contractarea repetată.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **11.05.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru

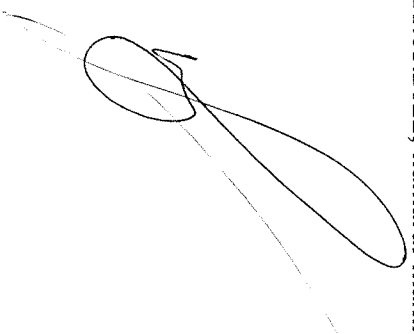

Gheorghe GORCEAG

