


3-PIN MONOPOLAR HANDLE AND ELECTRODES Ø 4 mm

• **30480 AUTOCLAVABLE MB HANDLE Ø 4 mm - 100 times**
Autoclavable handle up to 100 times for Ø 4 mm shaft electrodes with 3 m silicone cable and blade electrode.

- **30482 NEEDLE ELECTRODE Ø 4 mm** 30482
 - **30483 BLADE ELECTRODE Ø 4 mm** 30483
 - **30484 BALL ELECTRODE Ø 4 mm** 30484
- S/S electrodes autoclavable 100 times.
Sold in box of 5.
Length 5.5 cm.



3-PIN MONOPOLAR HANDLES FOR ELECTRODES Ø 2.4 mm

VALLEYLAB CONNECTOR HANDLES with 2 "click" push-buttons GIMA autoclavable electrosurgery pencils with CUT-COAG switch have been studied and tested to offer maximum reliability and functionality to the operator. MB handles are provided with a 3 Pin plug Valleylab type fitting all Gima mono-bipolar Diatermo MB (80, 120, 122, 132, 160, 200, 240, 300, 380, 400) and most of bipolar electrosurgical units: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschmann, Bovie, Martin, Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, Valleylab, Led, Erbe...

■ AUTOCLAVABLE HANDLES

- **30554 MB AUTOCLAVABLE HANDLE - 100 times**
Autoclavable handle with 2 large "click" push-buttons, provided with a 3 meter long silicone cable and a blade electrode. It can be autoclaved up to 100 times (electrode 20 times).
- **30545 MB AUTOCLAVABLE HANDLE - 100 times**
Same as code 30554 but with a 5 m long silicone cable
- **30550 PRIMA MB AUTOCLAVABLE HANDLE - 60 times**
Autoclavable handle with 2 large "click" push-button, provided with a 3 meter long silicone cable and a blade electrode. It can be autoclaved up to 60 times.
- **30548 STAR AUTOCLAVABLE HANDLE - 30 times**
Same as code 30554 but autoclavable up to 30 times (electrode is autoclavable up to 20 times).
- **30539 ORION PLUS AUTOCLAVABLE HANDLE - 100 times**
Same as 30554, but with a screw clamp locking system ensuring a safe contact and adapting to slightly different electrode diameters. High insulation to prevent liquid damage.
- **30536 SURGEON AUTOCLAVABLE HANDLE - 100 times**
Autoclavable, waterproof handle with ergonomic grip. Coloured ring that indicates CUT and COAG push buttons. Provided with 3 m cable and blade electrode.

■ SINGLE USE HANDLE

- **30551 KIRKY SINGLE-USE HANDLE - STERILE**
Single-use handle with "click" push-buttons for cut and coag. Includes blade electrode and 3.20 m cable.
- **30553 GIMA SINGLE-USE HANDLE - STERILE**
Same as 30551 with 3 m cable.



1-PIN MONOPOLAR HANDLES FOR ELECTRODES Ø 2.4 mm

1 pin plug HANDLES for diatermo 50, 80, 106, 108

These handles are provided with a 1 Pin socket (4 mm) fitting all Gima Diatermo and most of electrosurgical units in the market. These handles **do not have push-buttons**.

- **30515 SURGEON 1 PIN AUTOCLAVABLE HANDLE - 100 times**
Autoclavable, waterproof handle with ergonomic grip. Provided with 3 m cable and blade electrode
- **30519 AUTOCLAVABLE 50-80-106-108 HANDLE**
Autoclavable handle without buttons, provided with a 3 meter long cable and a blade electrode. It can be autoclaved up to 100 times.
- **30518 KIRKY SINGLE-USE 50-80-106-108 HANDLE - STERILE**
Single-use handle without button with blade electrode with 4 mm PIN connection.



DISPOSABLE GROUND PADS - WITH/WITHOUT CABLE



| GIMA code | DISPOSABLE GROUND PADS WITH SOLID GEL - without cable | Minimum order |
|-----------|---|---------------|
| 30491 | REM GROUND PADS - pediatric | box of 25 |
| 30487 | REM GROUND PADS - pediatric | box of 100 |
| 30492 | GROUND PADS - adult | box of 25 |
| 30489 | GROUND PADS - adult | box of 100 |
| 30493 | REM GROUND PADS - adult | box of 25 |
| 30488 | REM GROUND PADS - adult | box of 100 |
| 30495 | REM NON WOVEN GROUND PAD - ad/ped | box of 100 |

Pads need cable 30563 for Gima diatermo or other cable see below

| DISPOSABLE GROUND PADS WITH CABLE - 3m | | |
|--|--------------------------------|-----------|
| 30476 | PADS WITH CABLE Ø 6.3 mm plug | box of 25 |
| 30478 | PADS WITH CABLE Valleylab type | box of 25 |

All plates and cables are individually packed

CONNECTION CABLES FOR DISPOSABLE GROUND PADS

CABLES TO CONNECT GROUND PADS TO ELECTROSURGERY UNITS

The bipolar universal connection cables are supplied with a bipolar clamp for connection to disposable ground pads with a tab (dimensions 22-25 mm).


Various connectors make the cables compatible with numerous electrosurgical devices.

The cable can be fixed to the surgical sheet during the operation thanks to a metal sliding clamp.

Latex free. Individually packed in sealed polyethylene pouch compliance to 93/42/EEC

Medical Device Class I.

30563



Connection to electronic unit

Connection to disposable ground plates

COMPATIBLE ELECTROSURGERY UNITS

• 30563 CONNECTION CABLE FOR PLATES - 5 m - Universal jack mono plug 6.3 mm

Aesculap: TM, TM401
 Alexandra: D205, E300, 500D, 102/201, 2020/E, 202, MICRO180
 ALSA: All
 MF100, MF360/A360, 380100, 180
 Berchtold: Elektrotom 200, 390, 400, 540
 Birtcher: 772, 773, 737, 737XL, 774

Bovie: Bovie CSV, URO, BS, 400/400, 400SR, X10, X10L
 Burdick: U-7, SU-8
 Cameron-Miller: 26-1290
 Cobe: TS-403
 Concept: 9600, 9700, 9800, 9900
 Dolley: COBII 203T, 502, 503T, 505T
 Ems Davol: System 2000, 5000

Faset: Serie COBI
 Gima: all models
 GPS: all models
 I Cuatro: Megeri1
 Lamidey: Series Subtilec: All
 Series Surgilec: All
 Led: all models
 Martin: all models

Neomed: Series 3000, 3000A, 3002, 3006; 3010, 3020
 Philips: TS-403
 Ritter/Mdt: Solide State 400, 400B, 400SR
 Sidevan: Seb2
 Soxil: BP 2000, X10
 Thackray: T300S
 Torry: Lem 300 CST

• 30546 CONNECTION CABLE FOR PLATES - plug with spacer - 5 m - Universal jack mono plug 6.3 mm



Erbe: ACC, ICC, VIO, T

• 30547 CONNECTION CABLE FOR PLATES VALLEYLAB TYPE - 5 m - Universal Valleylab connection

Aspenlabs: Excalibur
 Valleylab: REM type devices
 Bowa

Conmed
 Erbe ICC International
 Erbe ACC International
 Erbe VIO International

AUTOCLAVABLE METAL AND RUBBER PLATES



- 30566 METAL PLATE - needs cable 30563
- 30563 CABLE FOR PLATES - 5 m
- 30559 CABLE FOR PLATES - 2.5 m
- 30564 SURGEON NEUTRAL PLATE 16x12 cm - with cable
- 30561 ROD NEUTRAL ELECTRODE with cable for 30625*

*Available on request for other electrocautery

- 30555 FLEXI STEEL RUBBER PLATE 18x21 cm - needs cable 30560
- 30556 FLEXI STEEL REM RUBBER PLATE - needs cable 30560
- 30560 CABLE FOR RUBBER STEEL PLATES 30555 and 30556
- 30574 REM RUBBER PLATE 20x15 cm - needs cable 30575
- 30575 CABLE FOR RUBBER PLATES 30573 and 30574



BIPOLAR CABLES FOR MAJOR BRANDS



Quality highly flexible silicone bipolar cables 3 m long (10").
Autoclavable at 134°C for minimum 20 times.
Recommended EtO sterilization for max extended life.

Suitable for most generators, with connector for European or US forceps. Multilingual box and manual: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE PL, RO,GR, HR, Arabic

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <p>30642 BIPOLAR CABLE ADAPTOR</p> | <p>Connector to forceps</p> | <p>Connector to electro-surgical unit</p> | <p>Connector to forceps</p> | <p>Connector to electro-surgical unit</p> <p>Pin distance 29 mm</p> | | | | | | |
| | GIMA Code | 30632 | 30618 | 30640 | 30637 | 30643 | 30618+ 30642 | 30617 | 30644 | 30639 |
| Connector to forceps | EU | US | EU | US | EU | US | EU | US | EU | EU |
| Compatibility brand/model | GIMA: MB 240, MB 380 VALLEYLAB, CONMED, CODMAN, OLYMPUS | | GIMA: MB 120 F, MB 200 F, MB 200 D, MB 200T, MB 300 D, MB 400 D, MB 300T, MB 400T LED: SURTRON 120, 200, 200T, 300, 300T, 400, 400T VALLEYLAB, EMC, DOLLEY | | GIMA: MB 122, MB 160, MB 200, MB 202 | | GIMA: MB 80 D, MB 120 D, MB 160 D LED: SURTRON 80, 120, 160 | | MARTIN, BERCHTOLD, AESCULAP, WOLF | ERBE, SELECT, DOWNS, SIEMENS |


DISPOSABLE BIPOLAR FORCEPS - VALLEYLAB CABLE

- 30300 DISPOSABLE JEWELER FORCEPS - 11.5 cm - tip 0.5 mm
 - 30302 DISPOSABLE STRAIGHT FORCEPS - 20 cm - tip 1.0 mm
 - 30304 DISPOSABLE STRAIGHT FORCEPS - 15 cm - angled tip 1.0 mm
 - 30306 DISPOSABLE BAYONET FORCEPS - 20 cm - tip 1.0 mm
- Disposable bipolar forceps are supplied with 3 m cable.
Valleylab plug (same connector as 30640).
Sterilization by Ethylene Oxide (EtO).




BIPOLAR SCISSORS

- 30310 BIPOLAR SCISSORS - 18 cm (7") - curved
Needs bipolar cable 30315
- 30315 ETHICON SILICONE BIPOLAR CABLE - 3 m (10')
For bipolar scissors. Connector 2.5 mm
Compatibility: Valleylab, Conmed, Codman, Olympus, other.



BIPOLAR ARTERY SEALER

- 30320 BIPOLAR ARTERY SEALER - 26 cm (10.5")
Needs bipolar cable 30325
- 30325 SILICONE BIPOLAR ARTERY SEALER CABLE - 3 m (10')
Connector 4 mm, Banana plug.
Compatibility: Valleylab, Conmed, Codman, Olympus, other.



FOOTSWITCHES AND BOARDS


| | |
|---|--|
| GIMA code | FOOTSWITCHES FOR 50, 80, 106, MB 120, 122, 132, 160, 200, 202, 200 TOUCH |
| 30577 | MB waterproof footswitch - 2m cable |
| 30578 | MB waterproof footswitch - 3m cable |
| ANTIEXPLOSION FOOTSWITCH FOR MB 120, 122, 132, 160, 200, 202 | |
| 30602 | Double antiexplosion, water proof MB footswitch |
| ANTIEXPLOSION FOOTSWITCHES FOR MB 240, 300D, 300T, 380, 400, 400D, 400T | |
| 30603 | Double antiexplosion, water proof footswitch - MB240-380 |
| 30604 | Double antiexplosion, water proof footswitch - MB250-400-300D-400D |
| 30608 | Double antiexplosion, water proof footswitch - MB300-400 TOUCH |
| MAIN BOARD | |
| 30557 | Main board - specify model and serial number of diatermo with order |
| 30558 | Output board for MB 240, 250, 380, 400 - specify as above |



30602-3-4-8
It allows selection from pedal of CUT and COAG functions
Antiexplosion and waterproof.

UNIVERSAL HIGH QUALITY INSULATED BIPOLAR FORCEPS

EUROPEAN CONNECTOR BIPOLAR FORCEPS




CE 1639 FDA ISO 13485


| GIMA code | Model | Connector | Length | | Tip style | Application | Tip size |
|-----------|--------------------------|-----------|---------|--------|------------|------------------|-------------------|
| | | | cm | inches | | | |
| 30645 | BINNER | EU | 22 cm | 8½" | ANGLED | ENT | - |
| 30646 | BINNER | EU | 18 cm | 7" | STRAIGHT | ENT | - |
| 30647 | BINNER | EU | 18 cm | 7" | ANGLED | ENT | - |
| 30648 | BINNER | EU | 19 cm | 7¾" | ANGLED 45° | ENT | - |
| 30650 | STRAIGHT | EU | 18 cm | 7" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30656 | STRAIGHT with irrigation | EU | 18 cm | 7" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30651 | STRAIGHT | EU | 20 cm | 7¾" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30658 | STRAIGHT | EU | 20 cm | 7¾" | STRAIGHT | GENERAL | 2 mm round points |
| 30652 | STRAIGHT | EU | 18 cm | 7" | ANGLED | GENERAL | 1 mm round points |
| 30653 | STRAIGHT | EU | 20 cm | 7¾" | ANGLED | GENERAL | 1 mm round points |
| 30657 | BAYONET | EU | 16.5 cm | 6½" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30654 | BAYONET | EU | 18 cm | 7" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30655 | BAYONET | EU | 20 cm | 7¾" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30659 | BAYONET | EU | 22 cm | 8¾" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30663 | BAYONET | EU | 24 cm | 9½" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30660 | STRAIGHT | EU | 18 cm | 7" | ANGLED | GENERAL | 0.3 mm points |
| 30661 | STRAIGHT | EU | 18 cm | 7" | STRAIGHT | GENERAL | 0.3 mm points |
| 30662 | STRAIGHT | EU | 20 cm | 7¾" | STRAIGHT | GENERAL | 0.3 mm points |
| 30664 | ADSON | EU | 12.1 cm | 6" | STRAIGHT | GENERAL | 1 mm round points |
| 30665 | JEWELER 5 | EU | 11.5 cm | 4½" | STRAIGHT | OPHTHALMIC/MICRO | 0.25 mm points |
| 30666 | JEWELER 5 | EU | 11.5 cm | 4½" | ANGLED | OPHTHALMIC/MICRO | 0.25 mm points |
| 30667 | STRAIGHT | EU | 15 cm | 6" | STRAIGHT | OPHTHALMIC/MICRO | 0.5 mm points |
| 30668 | STRAIGHT | EU | 15 cm | 6" | ANGLED | OPHTHALMIC/MICRO | 0.5 mm points |
| 30669 | Mc PHERSON | EU | 10.2 cm | 4" | STRAIGHT | OPHTHALMIC/MICRO | 0.5 mm points |



US CONNECTOR BIPOLAR FORCEPS

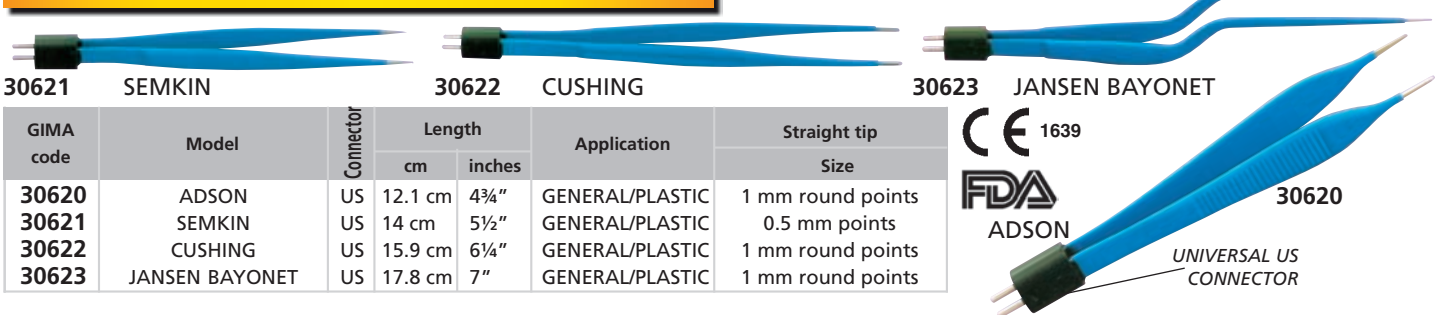

| GIMA code | Model | Connector | Length | | Application | Straight tip Size |
|-----------|----------------|-----------|---------|--------|-----------------|-------------------|
| | | | cm | inches | | |
| 30620 | ADSON | US | 12.1 cm | 4¾" | GENERAL/PLASTIC | 1 mm round points |
| 30621 | SEMKIN | US | 14 cm | 5½" | GENERAL/PLASTIC | 0.5 mm points |
| 30622 | CUSHING | US | 15.9 cm | 6¼" | GENERAL/PLASTIC | 1 mm round points |
| 30623 | JANSEN BAYONET | US | 17.8 cm | 7" | GENERAL/PLASTIC | 1 mm round points |




EUROPEAN NON-STICK BIPOLAR FORCEPS

NON-STICK BIPOLAR FORCEPS

Thanks to new Ag-Tech non-stick technology, the forceps stay clean, virtually eliminating the need for cleaning during

coagulation. A tip material with excellent thermal properties prevents the sticking of tissues. The non-stick effect is permanent and will not reduce with the use of forceps.

| GIMA code | Model | Connector | Length | | Tip style | Tip size |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----------|
| | | | cm | inches | | |
| 30460 | STRAIGHT | EU | 15 | 6" | STRAIGHT | 1 mm |
| 30461 | STRAIGHT | EU | 18 | 7" | STRAIGHT | 1 mm |
| 30462 | STRAIGHT | EU | 20 | 7¾" | STRAIGHT | 1 mm |
| 30464 | STRAIGHT | EU | 18 | 7" | ANGLED | 1 mm |
| 30465 | STRAIGHT | EU | 20 | 7¾" | ANGLED | 1 mm |
| 30468 | BAYONET | EU | 18 | 7" | STRAIGHT | 1 mm |
| 30469 | BAYONET | EU | 20 | 7¾" | STRAIGHT | 1 mm |
| 30472 | JEWELER | EU | 11.5 | 4.5" | STRAIGHT | 0.7 mm |
| 30473 | JEWELER | EU | 11.5 | 4.5" | ANGLED | 0.7 mm |
| 30474 | ADSON | EU | 12.1 | 4¾" | STRAIGHT | 1 mm |




HEINE ORIGINAL BULBS

| HEINE BULBS | HEINE ref. | GIMA code | Compatible with following HEINE products |
|---|------------|-----------|--|
|  Xenon 2.5 V | 035 | 31769 | Transilluminator Finoff alpha ⁺ F.O. and F.O. SP Laryngoscopes - Sanalon handle Glaucotest |
|  Xenon 2.5 V | 037 | 31771 | K100 and Beta [®] 100, Beta [®] 100 vet otoscopes Laryngeal mirrors F.O. mini 2000 otoscope Alpha [®] and Alpha F.O. otoscopes Mini/mini 3000/Alpha/Beta tongue holders |
|  Xenon 3.5 V | 049 | 31787 | F.O. Alpha ⁺ , Beta 100, K 100, Beta 100 vet otoscopes; Alpha ⁺ , Beta [®] tongue holders |
|  | 038 | 31773 | Miroflex ophthalmoscope HFR2 spot retinoscope Delta [®] 10 dermatoscope |
|  | 041 | 31774 | Fibrilux mini otoscope Mini 2000 combilamp Mini 1000, 2000 cliplamp |
|  | 042 | 31780 | Alpha [®] ophthalmoscope Mini 2000 ophthalmoscope Alpha [®] Focalux, Mini 2000 Focalux Mini Miroflex ophthalmoscope |
|  | 056 | 31770 | Minilux otoscope Mini 2000 otoscope |
|  | 069 | 31781 | Beta [®] 200, 200 M2, 200S ophthalmoscopes - XHL 2.5 V |
|  | 077 | 31772 | Beta [®] 200, 200 VET, 400; K 180 otoscopes Lambda 100 retinometer Delta [®] 10 plus dermatoscope |
|  | 070 | 31783 | Beta 200, 200 M2, 200S ophthalmoscopes - XHL 3.5V |
|  | 078 | 31784 | Beta 200, 200 Vet, K180 otoscopes lambda 100 retinometer otoscopes - XHL 3.5V |
|  | 084 | 31782 | K180 [®] ophthalmoscope - 2.5 V |
|  | 105 | 31776 | Mini 3000 F.O. otoscope |
|  | 106 | 31777 | Mini 3000 ophthalmoscope |
|  | 107 | 31778 | Mini 3000 combilamp and cliplamp - XHL 2.5 V |
|  | 109 | 31779 | Mini 3000 dermatoscope |
|  | 110 | 31775 | Mini 3000 otoscope |
|  | 089 | 31786 | Alpha ⁺ , Beta 200 retinoscopes |

WELCH ALLYN BULBS

| WELCH ALLYN BULBS | W. A. ref. | GIMA code | Compatible with following WELCH ALLYN products |
|---|------------|-----------|--|
|  | 00200-U | 32120 | Anoscopes: 38800, 380, 385, 395 Illuminators: 41000, 26030 Old products: 235, 77900, 26000, 20100, 21600, 42700, 40510 |
|  | 03000-U | 32123 | Ophthalmoscope: 11710, strabismoscope: 12400, episcope: 47300 Old ophthalmoscope: 11600, 11605, 11610 Retinoscope: 18000 |
|  | 03100-U | 32124 | Otoscopes: 25020, 21700, 20200 Handle: 73500, holder: 28100 Illuminators: 27000, 27050, 26530, 41100, 43300 Old otoscopes: 25000, 25200, 20000 |
|  | 03300-U | 32125 | Ophthalmoscope: 11511-11500 |
|  | 03400-U | 32126 | Otoscopes: 24011-24020-24000-24031-21110/1 Handle: 73550, Illuminators: 27200-27250-41110 |
|  | 03800-U | 32127 | Pan optic: 11810-11820-11800 |
|  | 04100-U | 32128 | Exam light: 48400-48410 |
|  | 04200-U | 32129 | Exam light: 48600, 48610-48625-48635, 48700 |
|  | 04400-U | 32130 | Ophthalmoscopes: 11400-11411-11470-11475 |
|  | 04700-U | 32131 | Laryngo: 680, 690, 692 (size 1-2) Old laryngo: 634, 664, 674, 684, 694 (check size) |
|  | 04800-U | 32132 | Laryngo: 680 (size 2-4), 690, 692 (size 3-4) Old laryngo: 634, 640, 664, 674, 684, 694 (check size) |
|  | 04900-U | 32133 | Ophthalmoscope: 11720, 11730, 11735, 11620, 11630 |
|  | 06000-U | 32134 | Laryngo handles: 60813, 60814, 60713, 60815, 60803, 60804 |
|  | 06500-U | 32135 | Macroview otoscope: 23810, 23820 |
|  | 07800-U | 32136 | Handle: 73211, 73210, 78000, 73200 |


RIESTER ORIGINAL BULBS

| RIESTER BULBS | RIESTER ref. | GIMA code | Bulb | Compatible with following RIESTER products |
|---|--------------|-----------|----------------|--|
|  | 10421 | 31850 | Vacuum 2.7 V | Otoscope uni [®] /speculight |
|  | 10424 | 31851 | Vacuum 2.5 V | May-ophthalmoscope uni [®] |
|  | 10487 | 31825 | XL 3.5 V xenon | Otoscope ri-scope [®] L1 |
|  | 10488 | 31852 | Vacuum 2.7 V | Pen-scope [®] and e-scope [®] otoscope |
|  | 10489 | 31560 | XL 2.5 V | Otoscope pen-scope [®] / ri-scope [®] L1 and e-scope [®] |
|  | 10590 | 31853 | XL 2.5 V | Otoscope uni [®] |
|  | 10600 | 31854 | XL 2.5 V | Otoscope ri-mini [®] , ri-scope [®] L2/L3 and e-scope [®] |
|  | 10605 | 31562 | XL 2.5 V | Ophthalmoscope ri-mini/ ri-scope [®] L1, L2, L3, e-scope [®] , ri-derma [®] |
|  | 10607 | 31855 | XL 3.5 V | Ri-scope [®] otoscope L2, L3 |
|  | 10608 | 31826 | XL 3.5 V | Ri-scope [®] ophthalmoscope L1, L2, L3 |
|  | 14041 | 31561 | LED 3.7 V | E-scope F.O otoscope |
|  | 14051 | 31563 | LED 3.7 V | E-scope ophthalmoscopes |



COMPATIBLE GERMAN BULBS

| GIMA BULBS | GIMA code | Compatible with the following products |
|---|-----------|--|
| LARYNGOSCOPE BULBS - MADE IN GERMANY | | |
|  | 34324 | Conventional laryngoscope SMALL bulb 2.7 V Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek and most of conventional laryngoscopes in the market (generally used for blades N° 00, 0, 1) |
|  | 34325 | Conventional laryngoscope LARGE bulb 2.7 V Gima, Riester, And, Kawe, Truphatek, Timesco and most of conventional laryngoscopes in the market (generally used for blades N° 2, 3, 4) |
|  | 34485 | Xenon halogen bulb for F.O. Laryngoscope and otoscope Gima, And, Kawe and most of F.O. laryngoscopes in the market. Compatible for products that use Heine Bulb # 035 |
| OTOSCOPE-OPHTHALMOSCOPE BULBS - MADE IN FRANCE-GERMANY | | |
|  | 31795 | Xenon halogen otoscope bulb Heine mini 3000 otoscopes |
|  | 31796 | Xenon halogen F.O. otoscope bulb Heine mini 3000 F.O. otoscopes |
|  | 31449 | Otoscope bulb 2.5V Parker otoscopes and some otoscopes of Riester, Timesco and Kawe |
|  | 31446 | Ophthalmoscope bulb 2.5V Parker ophthalmoscope Parker diagnostic sets |
|  | 31478 | Xenon halogen bulb for otoscope 2.5V Gimalux otoscopes, Kawe and Riester mini otoscopes Compatible for products that use Heine bulb #037 |
|  | 31479 | Halogen bulb for ophthalmoscope and dermatoscope 2.5V Parker halogen ophthalmoscope |
|  | 31428 | Xenon halogen ophthalmoscope bulbs 3.5 V Gima Xenon - halogen diagnostic sets - ophthalmoscope |
| OTO-OPHTHALMO-DERMATOSCOPE BULBS - OTHER COUNTRIES | | |
|  | 31188 | Halogen Dermatoscope bulb 2.5 V Gima dermatoscope Compatible for products that use Heine Bulb #038 |
|  | 31427 | Xenon halogen otoscope bulbs 3.5 V Gima Xenon - halogen diagnostic sets - otoscope |



| | | | |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Reg. Number | 10164 - M | Valid From | 2021-10-14 |
| First issue date | 2012-10-15 | Last change date | 2021-10-14 |
| Valid until | 2024-10-14 | | |

Quality Management System Certificate **ISO 13485:2016**

We certify that the Quality Management System of the Organization:

GIMA S.p.A.

Is in compliance with the standard UNI CEI EN ISO 13485:2016 for the following products/services:

Management of design and production, packaging and service of:

General non-active, non-implantable medical devices (except: injection, infusion, transfusion and dialysis; disinfecting, cleaning, rinsing; IVF, ART; ingestion), Devices for wound care, Non-active dental devices and accessories (except dental implants), General active medical devices (except: extra-corporal circulation, infusion and haemopheresis; stimulation or inhibition, rehabilitation devices and active prostheses; IVF, ART; software; medical gas supply systems and parts thereof), Monitoring devices, Devices for imaging and thermo therapy (except: ionizing radiation, lithotripsy), In Vitro Diagnostic Medical Devices (IVD).

Trade and service of: General non-active, non-implantable medical devices (except: IVF, ART; ingestion), Devices for wound care, Non-active dental devices and accessories (except dental implants), General active medical devices (except IVF, ART), Devices for imaging (except ionizing radiation), Monitoring devices, Devices for radiation therapy and thermo therapy (except: ionizing radiation, lithotripsy), In Vitro Diagnostic Medical Devices(IVD)

Chief Operating Officer
Giambiero Belcredi

The maintaining of certification is subject to annual surveillance and dependent upon the observance of Kiwa Cermet Italia contractual requirements.

This certificate is composed of 1 page.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico,
soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia
(BO)

Tel +39.051.459.3.111

Fax +39.051.763.382

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it

CERMET

GIMA S.p.A.

Registered Headquarters

- Via Grossi, 2 20121 Milano Italia

Certified Sites

- Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) - Italia





| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Pagina / Page 1 di / of 12

Certificato CE del Sistema di Garanzia della Qualità *EC Quality Assurance System Certificate*

Si certifica che, sulla base dei risultati degli audit effettuati, il Sistema di garanzia di Qualità della Produzione dell'Organizzazione/ *We certify that, on the basis of the audits carried out, the Production Quality Assurance System of the Organization:*

GIMA S.p.A.

Sede Operativa / Operational Headquarter:

Via Marconi, 1
20060 Gessate, MI - Italia

Sede Legale / Registered Headquarter

Via Tommaso Grossi, 2
20121 Milano, MI - Italia

è conforme ai requisiti applicabili della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni, Allegato V, attuata in Italia con Dlgs. 46 del 1997/02/24 e successive modifiche ed integrazioni per le seguenti tipologie di Dispositivi Medici / *Is in compliance with the applicable requirements of 93/42/EEC Directive as amended, Annex V, transposed in Italy by Dlgs. 46 of 1997/02/24 as amended for the following Medical Devices:*

Dispositivi attivi per l'aspirazione di sostanze e liquidi / *Active substances and liquids suctioning devices*
Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / *Sterile Single use gynaecology and ENT devices*
Dispositivi per aerosolterapia / *Aerosol therapy devices*
Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / *Blood pressure measuring devices*
Dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno / *Oxygen saturation measuring devices*
Dispositivi per la misurazione della temperatura corporea / *Body temperature measuring devices*
Dispositivi per la misurazione di parametri fisiologici / *Physiological parameters measuring devices*
Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / *Respiratory care and resuscitation devices*
Dispositivi per terapia termica / *Thermic therapy devices*
Kit di strumentario chirurgico monouso sterile / *Sterile single use surgical instrument kit*
Strumentario chirurgico monouso sterile / *Sterile single use surgical instrument*

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Rif. rapporto di audit/ *Ref. audit report:* del/dated 1-2/3/2021

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:25/05/2021 10:11:29



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476



| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi attivi per l'aspirazione di sostanze e liquidi / Active substances and liquids suctioning devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1104

Marca / Brandname:

VEGA / SUPER VEGA / TOBI / SUPER TOBI / TOBI CLINIC / TOBI HOSPITAL / CLINIC PLUS / HOSPI PLUS

Modello / Model:

Aspiratori chirurgici / Surgical aspirators

Codici / Codes:

28220 ; 28216 ; 28209 ; 28214 ; 28210 ; 28232 ; 28211 ; 28202 ; 28212 ; 28233 ; 28243 ; 28234 ; 28222 ; 28194 ; 28224 ; 28196 ; 28208 ; 28198 ; 28190 ; 28200 ; 28191 ; 28192 ; 28201 ; 28231 28203 ; 28215 ; 28204 ; 28193 ; 28183 ; 28182

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices

Classe di rischio / Risk class:

I s - Limitatamente agli aspetti relativi al mantenimento della sterilità / restricted to the aspects concerned the maintenance of sterile conditions

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Modello / Model:

Kit ORL sterile / Sterile ENT kit

Codici / Codes:

31456

Modello / Model:

Kit pap test / Pap smear kit

Codici / Codes:

29704

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:25/05/2021 10:11:56





| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Pagina / Page 3 di / of 12

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices

Modello / Model:

Spatula cervicale monouso sterile in plastica o legno / Disposable sterile plastic or wooden cervical spatula

Codici / Codes:

29745 ; 29748-29749

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile perno centrale - mix / Disposable sterile vaginal speculum central pin - mix

Codici / Codes:

29991

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile perno centrale - piccolo, medio, grande / Disposable sterile vaginal speculum central pin - small, medium, large

Codici / Codes:

29946 ; 29947 ; 29948

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile tache - mix / Disposable sterile vaginal speculum tache - mix

Codici / Codes:

29987

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile vite centrale - mix / Disposable sterile vaginal speculum middle screw - mix

Codici / Codes:

29995

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile vite laterale - mix / Disposable sterile vaginal speculum side screw - mix

Codici / Codes:

29986

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:25/05/2021 10:12:15



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

CERMET



| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile vite laterale (piccolo, medio, grande) / Disposable sterile vaginal speculum side screw - small, medium, large

Codici / Codes:

29983; 29984 ; 29985 ; 29976; 29977, 29978

Modello / Model:

Tampone di trasporto in plastica sterile / Sterile plastic transport swab

Codici / Codes:

29753

Marca / Brandname:

Gimabrush Ball / Gimabrush / Gima Collector

Modello / Model:

Spazzolini cervicali monouso sterile / Sterile disposable cervical brushes

Codici / Codes:

29735 ;29736 ; 29737

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Modello / Model:

Proctoscopio adulti / Adult proctoscope

Codici / Codes:

25957

CERTIFICATE



Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

23

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2021-05-24

Scadenza /
Valid until

2024-05-26

Ultima modifica /
Last change date

2021-05-24

Pagina / Page 5 di / of 12

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per aerosolterapia / Aerosol therapy devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1102

Modello / Model:

Aerosol a pistone adulti e bambini / Adult and Kids compressor nebulizers

Codici / Codes:

28091 ; 28092

Marca / Brandname:

EOLO / CORSIA

Modello / Model:

Aerosol professionale a pistone / Professional compressor nebulizers

Codici / Codes:

28097; 28105

Marca / Brandname:

MISTRAL

Modello / Model:

Aerosol professionale a pistone per uso domiciliare / Professional compressor nebulizers for home healthcare environment

Codici / Codes:

28102

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:25/05/2021 10:12:51



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476



Reg. Numero /
Reg. Number MED 26036

Revisione /
Revision 23

Primo rilascio /
First issue date 2006-10-25

Valido da /
Valid from 2021-05-24

Scadenza /
Valid until 2024-05-26

Ultima modifica /
Last change date 2021-05-24

Pagina / Page 6 di / of 12

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices

Classe di rischio / Risk class:

I m - Limitatamente agli aspetti relativi ai requisiti metrologici / restricted to the aspects concerned the metrological requirements

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0104

Marca / Brandname:

BOSTON / DALLAS / GIMATONO / LONDON / ROMA / TOKIO / TECNICO PROFEXIONAL / DAYTON

Modello / Model:

Sfigmomanometri Aneroidi / Aneroid Sphygmomanometers

Codici / Codes:

32731 ; 32747; 32749 ; 32719 ; 32725; 32726 ; 32709; 32727; 32728; 32738; 32734 ; 32693/10965 ; 32735 ; 32745

Marca / Brandname:

SIRIO

Modello / Model:

Manometro Aneroidi / Aneroid manometer

Codici / Codes:

32904

Marca / Brandname:

YTON

Modello / Model:

Sfigmomanometri Aneroidi / Aneroid Sphygmomanometers

Codici / Codes:

32720; 32703; 32693; 32701

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MDS 7010

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:25/05/2021 10:13:13



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

CERMET



| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices

Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali DA POLSO / DA BRACCIO / Digital Sphygmomanometers WRIST / ARM

Codici / Codes:

32926 ; 32924; 32924 SC

Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali SENZA MERCURIO / Digital Sphygmomanometers WITHOUT MERCURY

Codici / Codes:

32800; 32801

Marca / Brandname:

DOMINO

Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali / Digital Sphygmomanometers

Codici / Codes:

32803; 32804

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno / Oxygen saturation measuring devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

Modello / Model:

Pulsoximetri / Pulse oximeters

Codici / Codes:

34266; 34282; 34285, 34285-10997, 34340; 34342; 34265; 35091; 35092; 35093; 35095; 35090 ; 35100

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 25/05/2021 10:13:36



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476



| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della temperatura corporea / Body temperature measuring devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

Marca / Brandname:

DIGIT / DIGIT KIDS FARMAMED

Modello / Model:

NUB -Termometri clinici digitali / Digital clinical thermometers

Codici / Codes:

10980

Marca / Brandname:

FARMAMED / LINEA F / CARREFOUR / GS /PBpharma / 36.2 T&B / SUCCHIOTTO °C / BASALE / GIMA

Modello / Model:

Termometri clinici digitali classici e flessibili / Digital clinical thermometers classic and flexible

Codici / Codes:

25560; 305026-10945; 25561; 25560-10907; 305027-10946 ; 25608

Marca / Brandname:

FARMAMED / LINEA F / GIMA

Modello / Model:

WATERPROOF- Termometri clinici digitali / Digital clinical thermometers

Codici / Codes:

25563 ; 25562

Marca / Brandname:

PBpharma /GIMA

Modello / Model:

Termometri clinici digitali auricolari e frontali multifunzione / Digital clinical ear and ahaed multifunction thermometers

Codici / Codes:

25580 ; 25585

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:25/05/2021 10:13:57





| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione di parametri fisiologici / Physiological parameters measuring devices

Classe di rischio / Risk class:

I m - Limitatamente agli aspetti relativi ai requisiti metrologici / restricted to the aspects concerned the metrological requirements

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1301, MD 0104

Modello / Model:

Altimetro - Plicometro - Metro per neonati / Height meter - Skinfold caliper - Baby measuring meter

Codici / Codes:

27335 ; 27344; 27331

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / Respiratory care and resuscitation devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0101, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Modello / Model:

Cannule di Guedel sterili / Sterile Guedel airways

Codici / Codes:

34431, 34432, 34433, 34434, 34435, 34436, 34437, 34438; 34383; 34439

Modello / Model:

Maschere in silicone autoclavabili / Maschere autoclavabili in silicone GIMA PLUS / Silicone autoclavable face masks / Silicone autoclavable face masks GIMA PLUS

Codici / Codes:

34220, 34221, 34222, 34223, 34224, 34225 ; 34252, 34253, 34254, 34255; 34250

Modello / Model:

Maschere laringee riutilizzabili / Reusable laryngeal airway masks

Codici / Codes:

34424; 34425, 34426, 34427, 34428, 34429

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:25/05/2021 10:14:45





| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / Respiratory care and resuscitation devices

Modello / Model:

Palloni rianimatori in silicone / Kit Palloni rianimatori in silicone adulti / Silicone resuscitators / Adult silicone resuscitators kit

Codici / Codes:

34245, 34246, 34247; 34248, 34277, 34249 ; 34244

Modello / Model:

Reservoir monouso (sacche ossigeno) e valvola / Oxygen reservoir and valve

Codici / Codes:

34257; 34258; 34275; 34279

Modello / Model:

Valvola PEEP e adattatore / Valvola antireflusso e posteriore / Peep valve and adapter / Non-rebreathing valve and intake valve

Codici / Codes:

34227 ; 34228 ; 34259 ; 34256

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per terapia termica / Thermic therapy devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1403

Modello / Model:

Ghiaccio istantaneo TNT / PE / TNT / PE instant ice cold pack

Codici / Codes:

34110 ; 34111



| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Kit di strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument kit

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Radiation

Modello / Model:

Kit per rimozione sutura / kit procedurale sutura / Suture removal pack / Suture procedure pack

Codici / Codes:

38950 ; 38951

Tipologia / Medical Devices:

Strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument

Classe di rischio / Risk class:

I s - Limitatamente agli aspetti relativi al mantenimento della sterilità / restricted to the aspects concerned the maintenance of sterile conditions

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Radiation

Modello / Model:

Forbici per bende di Lister / Forbici chirurgiche standard / Lister bandage scissors / Standard surgical scissors

Codici / Codes:

388xx

Modello / Model:

Pinza di Magill / Pinza di Hartmann per orecchio / Magill forceps / Hartmann ear forceps

Codici / Codes:

388xx

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Radiation

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:25/05/2021 10:15:40



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

CERTIFICATE



| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Reg. Numero / Reg. Number | MED 26036 | Revisione / Revision | 23 |
| Primo rilascio / First issue date | 2006-10-25 | Valido da / Valid from | 2021-05-24 |
| Scadenza / Valid until | 2024-05-26 | Ultima modifica / Last change date | 2021-05-24 |

Pagina / Page 12 di / of 12

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument

Modello / Model:

Forbici di Mayo / Forbici di Metzenbaum / Forbici Iris / Forbice ombelicale / Forbice per chirurgia orecchio di Bellucci / Pinze per medicazione standard / Pinze di Hunter-Splinter / Pinze emostatiche di Adson / Pinze emostatiche Halstead-Mosquito / Pinza per dissezione McIndoe / Pinze di Pean / Pinza di Spencer-Wells / Pinza portatamponi di Foerster / Portaghi di Hegar- Mayo / Portaghi di Crile-Wood / Mayo scissors / Metzenbaum scissors / Iris scissors / Umbilical scissors / Bellucci ear scissors / Standard dressing forceps / Hunter-Splinter forceps/ Adson haemostatic forceps/ Halstead-Mosquito dissection forceps / McIndoe dissection forceps/ Pean forceps / Spencer-Wells forceps/ Foerster polypus forceps/ Hegar-Mayo needle holder / Crile-Wood needle holder

Codici / Codes:

388xx ; 389xx

La lista completa dei codici, relativi ai modelli certificati, è disponibile presso Kiwa Cermet Italia./ The complete list of the codes related to the certificated models is available at Kiwa Cermet Italia. Il presente Certificato è soggetto al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia ed è valido solo per le tipologie di dispositivi sopra identificate soggette a sorveglianza/ This Certificate is subject to Kiwa Cermet Italia regulations and it is valid only for the above mentioned Medical Devices that are subject to survey. L'allegato tecnico è parte integrante del presente Certificato./ The technical sheet is an integrating part of this Certificate.

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 25/05/2021 10:16:08



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

