

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / **DECLARATION OF CONFORMITY**

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / Medical Device	Codice/ Code
BISTURI RETTO - 17,5 cm <i>STRAIGHT BLADE SCALPEL - 17,5 cm</i>	26703

Classe di rischio I (Non Sterile), in accordo all'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., (recepita in Italia con D.lgs 46/97, e ss.mm.ii.), dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo:

Risk class I (Not Sterile), according to the Annex IX, Directive 93/42/EEC and further amendments (enforced in Italy by Leg. Decree No. 46/97 and further amendments), declares, under its own responsibility, that this medical device:

- è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., come da fascicolo tecnico conservato in Azienda;
comply with essential requirements and dispositions of the Directive 93/42/EEC and further amendments, as per the Technical Documentation filed in the Company;
- è fabbricato in accordo al Sistema Qualità che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato VII della sopra citata direttiva.
is manufactured according to the Quality System which satisfies requirements of the Annex VII of the above mentioned directive.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)





DICHIARAZIONE/DECLARATION

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / <i>Medical Device</i>	Codice/ <i>Code</i>
BISTURI RETTO - 17,5 cm <i>STRAIGHT BLADE SCALPEL - 17,5 cm</i>	26703

dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. **e che, in accordo alla MDCG 2020-2, sarà reso conforme al Regolamento (UE) 2017/745 per cambio classe entro maggio 2024.**

declares, under its own responsibility, that this medical device comply with Directive 93/42/EEC and further amendments and that, in accordance with MDCG 2020-2, will be made compliant with the Regulation (EU) 2017/745 for class change by May 2024.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)



GIMA

STRAIGHT BLADE SCALPEL - 17,5 cm

Code: 26703

Category: Scalpels, probes, hooks, others

Unit of sale: 1 pc.

Minimum order: 1

Type: Medical device

Class: I

NSIS: 1706535

CND: L9099

EAN13: 8023279267037

Description: STAINLESS STEEL SCALPELS.

Instructions: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabic.





ООО «МиниМед», 241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4740 от 29.05.2017

Паспорт

Посуда мерная лабораторная для клинических исследований стеклянная по ТУ 9464-013-52876351-2014

Цилиндры мерные с носиком на пластмассовом основании

1. Назначение

Предназначены для точного дозирования нелетучих жидкостей в лабораторной практике.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Вместимость, см ³	Допустимая погрешность, см ³	Цена деления, см ³
Цилиндр 3-25-2	25	± 0,5	0,5
Цилиндр 3-50-2	50	± 1,0	1,0
Цилиндр 3-100-2	100	± 1,0	1,0
Цилиндр 3-250-2	250	± 2,0	2,0
Цилиндр 3-500-2	500	± 5,0	5,0

1. Цилиндры изготовлены по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
2. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 ().
3. Исполнение 3 - с носиком и пластмассовым основанием, класс точности 2.
4. Буква «Н» в маркировке, обозначает наливной, вымеряемый «по наполнению».

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМедПром», 242600, Россия, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5.

Изготовитель гарантирует соответствие цилиндров мерных с носиком на пластмассовом основании требованиям ТУ 9464-013-52876351-2014 и ГОСТ 1770-74 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.



GIMA

ANATOMY FORCEPS - 16 cm

Code: 26691

Category: Forceps

Unit of sale: 1 pc.

Minimum order: 1

Type: Medical device

Class: I

NSIS: 141832

CND: L031310

EAN13: 8023279266917

Description: Stainless Steel anatomy forceps - 16 cm



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / **DECLARATION OF CONFORMITY**

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / Medical Device	Codice/ Code
PINZA ANATOMIA - 16 cm <i>ANATOMY FORCEPS - 16 cm</i>	26691

Classe di rischio I (Non Sterile), in accordo all'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., (recepita in Italia con D.lgs 46/97, e ss.mm.ii.), dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo:

Risk class I (Not Sterile), according to the Annex IX, Directive 93/42/EEC and further amendments (enforced in Italy by Leg. Decree No. 46/97 and further amendments), declares, under its own responsibility, that this medical device:

- è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., come da fascicolo tecnico conservato in Azienda;
comply with essential requirements and dispositions of the Directive 93/42/EEC and further amendments, as per the Technical Documentation filed in the Company;
- è fabbricato in accordo al Sistema Qualità che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato VII della sopra citata direttiva.
is manufactured according to the Quality System which satisfies requirements of the Annex VII of the above mentioned directive.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)





DICHIARAZIONE/DECLARATION

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / <i>Medical Device</i>	Codice/ <i>Code</i>
PINZA ANATOMIA - 16 cm <i>ANATOMY FORCEPS - 16 cm</i>	26691

dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. **e che, in accordo alla MDCG 2020-2, sarà reso conforme al Regolamento (UE) 2017/745 per cambio classe entro maggio 2024.**

declares, under its own responsibility, that this medical device comply with Directive 93/42/EEC and further amendments and that, in accordance with MDCG 2020-2, will be made compliant with the Regulation (EU) 2017/745 for class change by May 2024.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / **DECLARATION OF CONFORMITY**

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / Medical Device	Codice/ Code
PINZA ANATOMIA - 14 cm <i>ANATOMY FORCEPS - 14 cm</i>	26705

Classe di rischio I (Non Sterile), in accordo all'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., (recepita in Italia con D.lgs 46/97, e ss.mm.ii.), dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo:

Risk class I (Not Sterile), according to the Annex IX, Directive 93/42/EEC and further amendments (enforced in Italy by Leg. Decree No. 46/97 and further amendments), declares, under its own responsibility, that this medical device:

- è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., come da fascicolo tecnico conservato in Azienda;
comply with essential requirements and dispositions of the Directive 93/42/EEC and further amendments, as per the Technical Documentation filed in the Company;
- è fabbricato in accordo al Sistema Qualità che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato VII della sopra citata direttiva.
is manufactured according to the Quality System which satisfies requirements of the Annex VII of the above mentioned directive.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)





DICHIARAZIONE/DECLARATION

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / <i>Medical Device</i>	Codice/ <i>Code</i>
PINZA ANATOMIA - 14 cm <i>ANATOMY FORCEPS - 14 cm</i>	26705

dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. **e che, in accordo alla MDCG 2020-2, sarà reso conforme al Regolamento (UE) 2017/745 per cambio classe entro maggio 2024.**

declares, under its own responsibility, that this medical device comply with Directive 93/42/EEC and further amendments and that, in accordance with MDCG 2020-2, will be made compliant with the Regulation (EU) 2017/745 for class change by May 2024.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)



GIMA

ANATOMY FORCEPS - 14 cm

Code: 26705

Category: Forceps

Unit of sale: 1 pc.

Minimum order: 1

Type: Medical device

Class: I

NSIS: 141832

CND: L031310

EAN13: 8023279267051

Description: Stainless Steel anatomy forceps - 14 cm



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / **DECLARATION OF CONFORMITY**

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / Medical Device	Codice/ Code
PINZA ANATOMIA - 12 cm <i>ANATOMY FORCEPS - 12 cm</i>	26690

Classe di rischio I (Non Sterile), in accordo all'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., (recepita in Italia con D.lgs 46/97, e ss.mm.ii.), dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo:

Risk class I (Not Sterile), according to the Annex IX, Directive 93/42/EEC and further amendments (enforced in Italy by Leg. Decree No. 46/97 and further amendments), declares, under its own responsibility, that this medical device:

- è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., come da fascicolo tecnico conservato in Azienda;
comply with essential requirements and dispositions of the Directive 93/42/EEC and further amendments, as per the Technical Documentation filed in the Company;
- è fabbricato in accordo al Sistema Qualità che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato VII della sopra citata direttiva.
is manufactured according to the Quality System which satisfies requirements of the Annex VII of the above mentioned directive.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)





DICHIARAZIONE/DECLARATION

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / <i>Medical Device</i>	Codice/ <i>Code</i>
PINZA ANATOMIA - 12 cm <i>ANATOMY FORCEPS - 12 cm</i>	26690

dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. **e che, in accordo alla MDCG 2020-2, sarà reso conforme al Regolamento (UE) 2017/745 per cambio classe entro maggio 2024.**

declares, under its own responsibility, that this medical device comply with Directive 93/42/EEC and further amendments and that, in accordance with MDCG 2020-2, will be made compliant with the Regulation (EU) 2017/745 for class change by May 2024.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)



GIMA

ANATOMY FORCEPS - 12 cm

Code: 26690

Category: Forceps

Unit of sale: 1 pc.

Minimum order: 1

Type: Medical device

Class: I

NSIS: 141832

CND: L031310

EAN13: 8023279266900

Description: Stainless Steel anatomy forceps - 12 cm





DECLARATION OF CONFORMITY

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

GIMA Single Registration Number (SRN):

Medical Device (Trade Name and description)	Code	Basic UDI-DI code
SCISSORS STRAIGHT BLUNT/BLUNT - 16cm	26856	802327900L0104990000000VD

Risk class I (Not sterile), according to the Rule 1 Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745 (MDR), declares, under its own responsibility, that this medical device:

- comply with essential requirements and dispositions of Regulation (EU) 2017/745 (MDR), as from the Technical File filed at the company;
- common Specifications have not been used for the compliance of the above medical device;

Gessate, 5/28/2021

GIMA S.p.A.

The legal Representative
(Nicola Manzoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Manzoni', is written over a horizontal line.



GIMA

SCISSORS STRAIGHT BLUNT/BLUNT - 16cm

Code: 26856

Category: Scissors

Unit of sale: 1 pc.

Minimum order: 1

Type: Medical device

Class: I

NSIS: 142041


CND: L010499

EAN13: 8023279268560



Description: STAINLESS STEEL SURGICAL SCISSORS.

Instructions: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabic.

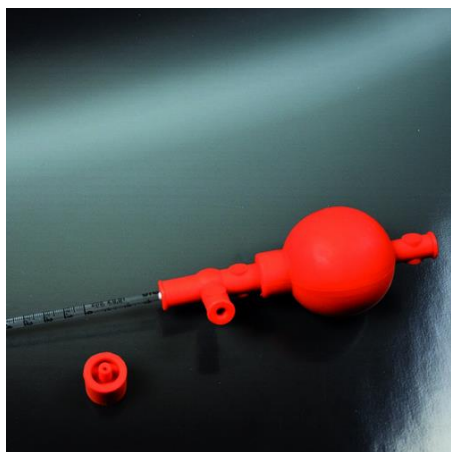

PIPETTE FILLERS

In red rubber, provided with three spheric glass valves: air exhaust, liquid filling and dispensing. Universal model can be used with all pipettes. Complete with rubber adapter to use pipettes with capacities more than 20 ml.

Cod.

3800

CERTIFICATO N° 505DM09

CERTIFICATE N° 505DM09

Si certifica che il
this is to certify that

Sistema di Gestione per la Qualità

Quality Management System

messo in atto da
implemented by

APTACA S.p.A.

Via Monte Bianco, 4 – IT 20900 MONZA (MB)

nella Sede Operativa di
Operative Unit

Regione Monforte, 30 – IT 14053 CANELLI (AT)

è conforme alla norma
is in compliance with the standard

UNI CEI EN ISO 13485-2021 (ISO 13485-2016)

per i seguenti Processi
concerning the following kinds of Processes

Gestione della fabbricazione e immissione in commercio di tamponi sterili per il prelievo di campioni biologici in orifizi naturali e in ambito chirurgico. Progettazione e fabbricazione di dispositivi medico diagnostici per laboratori di analisi e dispositivi medici di classe I non sterile.

Commercializzazione di dispositivi medici invasivi e non di classe IIa, Is, I e diagnostici in vitro.

Management of the manufacturing and placing on the market of sterile tampons for sampling of biological specimens in natural orifice and in surgical field.

Design and manufacturing of diagnostic-medical devices for laboratories of analysis and non-sterile class I medical devices.

Marketing of invasive and non-invasive medical devices of class IIa, Is, I and in-vitro diagnostics.

Il presente Certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite dai Regolamenti per la certificazione in vigore applicabili.

This Certificate shall satisfy the requirements established in the Rules for the certification in force applicable.

In caso di discordanza tra le lingue utilizzate nella traduzione del contenuto del presente certificato, fare riferimento alla lingua italiana

In cases of discrepancy between the languages used in the translation of the content of this certificate, please refer to the Italian language

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
MANAGING DIRECTOR



Dr. Ing. Roberto Cusolito

Data di Prima Emissione
First Issue Date
2007-10-30

Data di Prima Emissione ITALCERT
First Issue Date ITALCERT
2011-10-30

Data di Rinnovo
Renewal Date
2023-10-24

Data di Scadenza
Expiration Date
2026-10-29



SGQ N° 023A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ООО «ОВЕСТ»

Юридический адрес: Россия, 302006, г. Орел
ул. Московская, 98 пом. 4

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 102

Дата изготовления – ноябрь 2022 г

Дата выдачи паспорта 6 декабря 2022 г.

Ериш пробирочный (искусственная щетина) 280x100x25

ТУ 9677-004-11976371-03

ОКП 96 7762

Тип: А-1

Количество: 3000 шт

Контроль показателей качества:

Наименование контролируемых показателей	Норма по ТУ	Заключение
Общая длина	260 мм-280 мм	Выдерживают
Длина рабочей части	60-70 мм, но не более 100 мм	Выдерживают
Диаметр рабочей части	22мм- 25 мм	Выдерживают

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Заключение: Данная продукция соответствует обязательным требованиям ТУ.

Ответственный за приемку





GIMA

ANATOMY FORCEPS - 20 cm

Code: 26752

Category: Forceps

Unit of sale: 1 pc.

Minimum order: 1

Type: Medical device

Class: I

NSIS: 141832

CND: L031310

EAN13: 8023279267525

Description: Stainless Steel anatomy forceps - 20 cm



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / **DECLARATION OF CONFORMITY**

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / Medical Device	Codice/ Code
PINZE ANATOMIA - 20 cm <i>ANATOMY FORCEPS - 20 cm</i>	26752

Classe di rischio I (Non Sterile), in accordo all'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., (recepita in Italia con D.lgs 46/97, e ss.mm.ii.), dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo:

Risk class I (Not Sterile), according to the Annex IX, Directive 93/42/EEC and further amendments (enforced in Italy by Leg. Decree No. 46/97 and further amendments), declares, under its own responsibility, that this medical device:

- è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., come da fascicolo tecnico conservato in Azienda;
comply with essential requirements and dispositions of the Directive 93/42/EEC and further amendments, as per the Technical Documentation filed in the Company;
- è fabbricato in accordo al Sistema Qualità che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato VII della sopra citata direttiva.
is manufactured according to the Quality System which satisfies requirements of the Annex VII of the above mentioned directive.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)



DICHIARAZIONE/DECLARATION

La Società GIMA S.p.A., con sede operativa in Gessate (MI), in Via Marconi 1, e sede legale in Milano, in Via Tommaso Grossi 2, in qualità di fabbricante del dispositivo medico:

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

Dispositivo medico / <i>Medical Device</i>	Codice/ <i>Code</i>
PINZE ANATOMIA - 20 cm <i>ANATOMY FORCEPS - 20 cm</i>	26752

dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tale dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. **e che, in accordo alla MDCG 2020-2, sarà reso conforme al Regolamento (UE) 2017/745 per cambio classe entro maggio 2024.**

declares, under its own responsibility, that this medical device comply with Directive 93/42/EEC and further amendments and that, in accordance with MDCG 2020-2, will be made compliant with the Regulation (EU) 2017/745 for class change by May 2024.

Gessate, 4/1/2020

GIMA S.p.A.

Il legale Rappresentante
The legal Representative
(Nicola Manzoni)





STERILE LOOPS



182908
STERILE
Sterile polystyrene loop open “L” shaped.
Individually wrapped.



Sterile polystyrene loop 1 microlitre.
STERILE

18285	In bags of 5 pcs
18286	In bags of 20 pcs



Sterile polystyrene loop 10 microlitres.
STERILE


18287	In bags of 5 pcs.
18288	In bags of 20 pcs
182871	Individually wrapped

Chi siamo

Il gruppo VACUTEST KIMA ha una esperienza di quaranta anni, che gli è valsa una eccellente reputazione, nel campo della produzione di articoli per laboratori di analisi.

Contact Information

🏠 Via dell'industria 12, 35020
Arzergrande (PD) Italy
☎ +39 049 9719511
📞 +39 049 9719542 / 049 9719543
✉ info@vacutestkima.it
[Privacy](#)
[Whistleblowing](#)

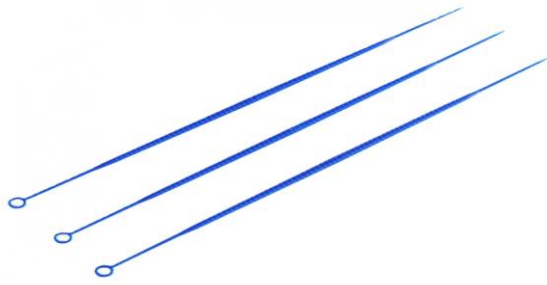

Inoculating Loops

Disposable inoculating loops for collection and inoculation by streaking or puncture method. Smooth loop surfaces allows easy streaking. No rough plastic edges, flashing or burrs on the loop head. Loops do not cut or gouge the agar surface during streaking. Being both sterile and disposable eliminates the risk of cross contamination. All loops are free of any lubricants and do not contaminate any media. Color-coded sizes for easily identification.

Packages:

20pcs/zip-lock pack,50x20pcs/box,10x1000pcs/ctn

10pcs/zip-lock pack,100x10pcs/box,10x1000pcs/ctn

5pcs/zip-lock pack,100x5pcs/box,10x500pcs/ctn

Individual peel pack,500pcs/box,10x500pcs/ctn

Cat No.	Description	Qty/Case(pcs)
Rigid Loops		
620601	Inoculating loops, PS, natural color,1ul	10000
620602	Inoculating loops, PS, blue color,10ul	10000
620603	Inoculating loops, PS, yellow,1ul +10ul	10000
Flexible Loops		
620604	Inoculating loops, ABS, white,1ul	10000
620605	Inoculating loops, ABS, blue,10ul	10000
620606	Inoculating loops, ABS, yellow,1ul +10ul	10000

BOEN HEALTHCARE CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: GM03-BN23


Product Name: Inoculating Loops			Specification: Flexible, 1μL				
Lot. No.: 20230501			MFG. Date: 2023-05				
EXP. Date: 2028-04			Raw Material: ABS				
Standard: Enterprise Standard							
Package: 20pcs/bag, 10000pcs/carton							
Quantity: 500000pcs				Report Date: 2023.06.10			
Item	Technical Requirement	Inspection Level	Sample	AQL		Defect Qty	Result
Dimension	1μL	5pcs/lot	5pcs	0		0	Pass
				Ac	Re		
				0	1		
Appearance	No burr, black dot, dust, scratch, flash≤0.5mm, no oil spot, breakage. The color should be without obvious color difference.	GB/T 2828.1-2012 Normal test Level II	800pcs	1.5		1	Pass
				Ac	Re		
				21	22		
Function	The loops are no flash edge, capacity is 1μL	10pcs/lot	10pcs	0		0	Pass
				Ac	Re		
				0	1		
Package	The printing should be clean and clear.	1 outer box/lot	1 outer box	0		0	Pass
				Ac	Re		
				0	1		
Conclusion	The product meets all the requirement by out test.						

Inspector: Tom Li

Date: 2023.06.10

Checker: Leo Sun

Date: 2023.06.10

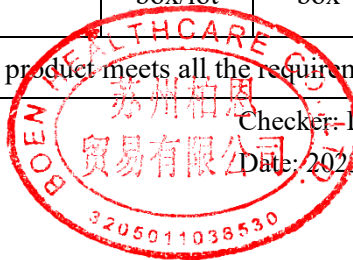

BOEN HEALTHCARE CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: GM03-BN23

Product Name: Inoculating Loops			Specification: Flexible, 10μL				
Lot. No.: 20230501			MFG. Date: 2023-05				
EXP. Date: 2028-04			Raw Material: ABS				
Standard: Enterprise Standard							
Package: 20pcs/bag, 10000pcs/carton							
Quantity: 500000pcs				Report Date: 2023.06.10			
Item	Technical Requirement	Inspection Level	Sample	AQL		Defect Qty	Result
Dimension	10μL	5pcs/lot	5pcs	0		0	Pass
				Ac	Re		
				0	1		
Appearance	No burr, black dot, dust, scratch, flash≤0.5mm, no oil spot, breakage. The color should be without obvious color difference.	GB/T 2828.1-2012 Normal test Level II	800pcs	1.5		0	Pass
				Ac	Re		
				21	22		
Function	The loops are no flash edge, capacity is 10μL	10pcs/lot	10pcs	0		0	Pass
				Ac	Re		
				0	1		
Package	The printing should be clean and clear.	1 outer box/lot	1 outer box	0		0	Pass
				Ac	Re		
				0	1		
Conclusion	The product meets all the requirement by out test.						

Inspector: Tom Li

Date: 2023.06.10

Checker: Leo Sun

Date: 2023.06.10



CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001 & UNI CEI EN ISO 13485

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
14.01.2021



CODICE ARTICOLO: **2120/SG**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



CONTENITORE GRADUATO PER URINE DA 150 ML

Tappo a vite inserito, in polietilene di colore rosso, che ne garantisce la perfetta tenuta con bordo zigrinato per una apertura e chiusura facile e sicura. Contenitore con superficie di scrittura. Ottima resistenza alle basse e alte temperature e buona resistenza agli agenti chimici. Prodotto in Polipropilene medicale (PP). Sterile, in confezione singola. Dispositivo Latex-Free e apirogeno. Conforme alla norma UNI EN 14254.

150 ML GRADUATED URINE CONTAINERS

Red inserted screw cap in polyethylene which guarantees the perfect leak-proof, with milled rim allowing a safe and easy opening/closing. Container with writing surface. Excellent high and low temperatures resistance and chemical agents. Manufactured in medical PP. Sterile, individually wrapped. Latex free and pyrogen free device. Compliant with UNI EN 14254.

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	STERILE / STERILE RAGGI BETA / BETA RAYS	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Volume nominale contenitore (ml)	150	Nominal volume container (ml)
Scala graduata	MIN. 20ML – MAX 100ML	Graduated scale
Incrementi scala graduata (ml)	20	Intervals graduated scale (ml)
Temperature tollerate contenitore	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range - container
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +80°C	Temperature range - cap
Dimensioni contenitore (mm)	Ø 58 x 72	Dimensions - container (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 61 x 13	Dimensions – cap (mm)
Peso contenitore (gr.)	9,0	Weight - container (gr.)
Peso tappo (gr.)	5,8	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” atto a contenere un campione biologico umano (urina) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W05010203 (Contenitori per raccolta di urina).

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1897926/R

Codice EDMA > 51021002 - Sterile urine containers

*Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” adapted to contain a human biological sample (urine) in order to perform diagnostic analysis laboratory. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W05010203 (Urine collection, containers).

Code EDMA > 51021002 - Sterile urine containers.

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 250
Quantity (pcs):

Confezione interna (pz): singola
Internal packing (pcs): individually

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 35,5 x 55 x 45,7
External box dimensions (cm):

Peso (Kg): 5,5
Weight (Kg):

Volume (m³): 0,089
Volume (m³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays



Plastic Petri Dishes

Single use Petri Dish for microbiological procedures, as well suspension culture or plant cell culture. Made of non-cytotoxic virgin polystyrene, excellent optical clarity. Engineered for optimum flatness to provide uniform agar thickness. Single or more vent are available : no vented for anaerobic and long-term work, single vent for limiting gas exchange, multi vented for improving gas exchange.

t No.	Description Qty/Case(pcs)
620201	Plastic Petri Dish, 35x15mm 1000
620202	Plastic Petri Dish, 40x13mm 1000
620203	Plastic Petri Dish, 55x15mm 1000
620204	Plastic Petri Dish, 60x15mm, 800
620205	Plastic Petri Dish, 70x15mm 800
620206	Plastic Petri Dish, 90x15mm, 500
620207	Plastic Petri Dish, 90x15mm, 2grid/ 500
620208	Plastic Petri Dish, 90x15mm, 3grid 500
620209	Plastic Petri Dish, 150x15mm 500
620210	Plastic Petri Dish, 90x15mm, Quad Plate 500

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001 & UNI CEI EN ISO 13485

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
08.10.2017



CODICE ARTICOLO: **10362/SG**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Provetta cilindrica da 15 ml

Non graduate, prodotte in polistirolo cristallo (PS) ad alta trasparenza ottica. Con tappo a vite di colore rosso con bordo zigrinato per una apertura e chiusura facile e sicura che ne garantisce la perfetta tenuta. Dispositivo Latex-free Sterili in confezioni da 150 pezzi

15 ml cylindrical test tubes

Not graduated, manufactured in crystal polystyrene (PS) with high clarity. Red screw cap which guarantees the perfect leak-proof, with milled rim allowing a safe and easy opening/closing. Latex-free device. Sterile in bags of 150 pieces

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	<i>Raw material – Test tube</i>
Materiale impiegato tappo	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	<i>Raw material - cap</i>
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	<i>Temperature range - test tube</i>
Temperature tollerate tappo	MIN -10°C MAX +121°C	<i>Temperature range - cap</i>
Dimensioni provetta (mm)	Ø 16 x 120	<i>Dimensions - test tube (mm)</i>
Dimensione tappo (mm)	Ø 20,5 x 16	<i>Dimensions – cap (mm)</i>
Peso provetta (gr.)	5,4	<i>Weight - test tube (gr.)</i>
Peso tappo (gr.)	1,6	<i>Weight – cap (gr.)</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" atto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva, espettorato, pus, etc) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020102 (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi)

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1245919/R

Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" adapted to contain a human biological sample (for example urine, blood, semen, saliva, sputum, pus, etc) in order to perform diagnostic analysis laboratory. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050301020102 (Samples analyses, plastic tubes without additives).

EDMA code > 51091001 - Other containers for samples of human origin

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 3.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

For a maximum centrifuge speed of 3,000 r.p.m to be kept for 20" max

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 1.050
Quantity (pcs):

Confezione interna (pz): 150
Internal packing (pcs):

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 52,5 x 37,5 x 35
External box dimensions (cm):

Peso (Kg): 8,5
Weight (Kg):

Volume (m³): 0,069
Volume (m³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays



Sterile **Microcentrifuge tube**

Manufactured from robust virgin-polypropylene, clarity for better visual inspection
Flat cap with a beveled edge comfortable for opening and closing
Frosted writing area on tube for labeling and writing
Clear molded graduations on tube for 1.5ml&2ml
Flat top with a writable surface
Precise lid sealing for lowest evaporation rates during storage
RNase, DNase, DNA and Pyrogen free available upon required.

Cat. No.	Description	Qty/Case
664101	0.5ml Microcentrifuge tube with snap cap, PP, clear,sterile	10000
664102	1.5ml Microcentrifuge tube with snap cap, PP, clear,sterile	5000
664103	2.0ml Microcentrifuge tube with snap cap, PP, clear,sterile	5000

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
26.07.2022



ARTICOLO: **Provette coniche graduate da 50ml - Sterili**
ITEM: **50ml conical graduated test tubes - Sterile**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Provette sterili, fondo conico per un totale recupero del campione. Tappo a vite, di colore rosso, che ne garantisce la perfetta tenuta con bordo zigrinato per una apertura e chiusura facile e sicura. Graduazione precisa con numerazione ben visibile. Ottima resistenza alle basse e alte temperature e buona resistenza agli agenti chimici. Prodotte in Polipropilene medicale (PP) particolarmente trasparente. Autoclavabili, Apirogene e Latex-Free. RCF max = 8.500 g. (rotore angolo fisso) - 4.000 g. (rotore basculante).

Sterile test tubes conical bottom for a complete sample collection. Red screw cap which guarantees the perfect leak-proof, with milled rim allowing a safe and easy opening/closing. Accurate graduation, clearly visible. Excellent high and low temperatures resistance and chemical agents. Manufactured in medical PP, particularly transparent. Autoclavable, pyrogen and latex free. RCF max= 8,500 g. (fixed angle rotor) - 4,000 g. (swing bucket). Sterili, in bags of 100 pieces

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	STERILE / STERILE Raggi Beta / Beta rays	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	Polipropilene / Polypropylene	Raw material – Test tube
Materiale impiegato tappo	Polipropilene / Polypropylene	Raw material - cap
Temperature tollerate provetta	min -80°C max +121°C	Temperature range - test tube
Temperature tollerate tappo	min -80°C max +121°C	Temperature range - cap
Scala graduata (ml)	5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	Graduated scale (ml)
Dimensioni provetta (mm)	Ø 30 x 115	Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 34,5 x 12,5	Dimensions – cap (mm)
Peso provetta (gr.)	9,3	Weight - test tube (gr.)
Peso tappo (gr.)	2,2	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 Anni / Years	Shelf life



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

						Scatola / Box		
REF.	Colore tappo Cap colour	Etichetta Label	Sterile R	R.D.M.	Confezione interna Internal packing	Quantità Quantity	Dimensioni Dimensions	Peso (Kg.)
10351/SG	Rosso Red		✓	1896906/R	Sacchetti da 100 pz Bags of 100 pcs	600 pcs	45 x 45 x 53 cm 0,107 m ³	8,5
10351/TA/SG	Azzurro Light blue		✓	1896912/R	Sacchetti da 100 pz Bags of 100 pcs	600 pcs	45 x 45 x 53 cm 0,107 m ³	8,5
10351/E/SG	Rosso Red	✓	✓	1896905/R	Sacchetti da 100 pz Bags of 100 pcs	600 pcs	45 x 45 x 53 cm 0,107 m ³	8,6
10351/SG/CS	Rosso Red		✓	1896910/R	Confezione singola Individually wrapped	600 pcs	45 x 45 x 53 cm 0,107 m ³	8,7

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro “contenitore di campione” atto a contenere un campione biologico umano (sangue, urine, feci, pus, espettorato, saliva, sperma, cellule, unghie, capelli) al fine di effettuare esami diagnostici di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020102 (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi).

Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin

Basic UDI-DI (Global Model Number – GMN): 805577609FT02STETUBE01Y8

*In Vitro Diagnostic Medical Device “specimen receptacles” adapted to contain a human biological sample (blood, urine, faeces, pus, sputum, saliva, semen, cells, nails, hair) to perform in vitro diagnostic analysis laboratory. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND) > W050301020102 (Samples analyses, plastic tubes without additives).

EDMA code > 51091001 - Other containers for samples of human origin

Basic UDI-DI (Global Model Number – GMN): 805577609FT02STETUBE01Y8

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Destinato esclusivamente ad uso professionale -

Utilizzare esclusivamente per effettuare analisi diagnostiche di laboratorio su campioni biologici umani in contesti sanitari.

Dispositivo senza funzione di misura.

L'eventuale presenza di scala graduata è da intendersi a scopo indicativo e senza funzione metrologica

Non variare la destinazione d'uso. In caso di dubbio circa la destinazione d'uso, Vi preghiamo di contattare il Fabbricante.

Prima dell'utilizzo controllare la perfetta chiusura del dispositivo se applicabile

Manipolare utilizzando dispositivi di protezione individuale: pericolo di contaminazione

Dopo il prelievo conservare il campione come prescritto dalla metodica analitica e consegnare al Laboratorio entro il tempo massimo previsto dalla stessa.

Non utilizzare il Dispositivo in caso di evidenti segni di rottura, lesioni, fessurazioni che potrebbero comprometterne il corretto uso

Non avvicinare il Dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare

Non utilizzare e smaltire il Dispositivo scaduto o con la confezione non integra

Non riutilizzare: Dispositivo monouso. L'eventuale riutilizzo potrebbe causare la contaminazione del campione.

Nel caso di dispositivo sterile (radiazioni ionizzanti) o asettico: stato microbiologico garantito a confezione integra. Non ri-sterilizzare

Utilizzare il Dispositivo unicamente con accessori compatibili e/o in dotazione (tappi, supporti, ecc.)

Non esporre direttamente ai raggi solari; proteggere dall'umidità (U.R. max 75% a 26°C)

Conservare in luogo asciutto, temperatura min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Smaltire secondo le normative vigenti, pericolo di infezione.

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Provette: velocità di rotazione in centrifuga (max 20 minuti, temperatura ambiente): PMMA r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) – PS r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) – PP r.p.m 5.000 (R.C.F. min 4.000 x g)– TPX r.p.m 4.500 (R.C.F. min 3.200 x g).

- For professional use only -

Use only for laboratory diagnostic analysis of human biological samples in healthcare settings.

Device without measuring function.

Any presence of a graduated scale is intended for indicative purposes and without a metrological function.

Do not vary the intended purpose of the device. Please contact the Manufacturer in the evenience of doubts concerning the intended purpose.

Before use check the perfect closure of the device if applicable.

Handle using personal protective equipment: risk of contamination.

After collection, store the sample as prescribed by the analytical method and deliver to the Laboratory within the maximum time specified by the same.

Do not use the Device in case of evident signs of breakage, injuries, cracks that could compromise its correct use.

Keep out of flame or heat sources which might damage the device.

Do not use after expiry date or if packing is opened.

Do not re-use: Disposable Device. Any reuse could cause sample contamination.

If sterile (ionizing radiations) or aseptic Device: Microbiological status in undamaged pack.

Do not re-sterilize.

Use the Device only with compatible and / or supplied accessories (caps, supports, etc.)

Do not put under direct sun rays; store in a dry, cool place (U.R. max 75% at 26°C)

Store in dry place, temperature range: min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Disposal according to applicable regulations, risk of infection.

Before use with particular substances check the resistance/compatibility chart in our catalogue.

Test tubes: centrifuge rotation speed (max 20 minutes, room temperature):

PMMA r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) – PS r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) – PP r.p.m 5.000 (R.C.F. min 4.000 x g)– TPX r.p.m 4.500 (R.C.F. min 3.200 x g).



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS (UNI EN CEI ISO 15223-1)

	Marchio CE <i>CE Mark</i>		Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro <i>In Vitro diagnostic medical device</i>		Consultare le istruzioni per l'uso <i>Consult instructions for use</i>
	Data di produzione <i>Date of manufacture</i>		Data di scadenza <i>Use-by date</i>		Lotto <i>Batch code</i>
	Codice articolo <i>Catalogue number</i>		Fabbricante <i>Manufacturer</i>		Monouso <i>Do not re-use</i>
	Utilizzare a confezione integra <i>Do not use if package is damaged</i>		Proteggere dall'umidità <i>Keep dry</i>		Non esporre ai raggi del sole <i>Keep away from sunlight</i>
	Sterile irradiato <i>Sterilized using irradiation</i>				

BOEN HEALTHCARE CO., LTD


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: GM03-BN23

Product Name	Cover Glass	Specification	24x24mm
Quantity	1200bxs	Test Quantity	25bxs
Lot. No.	20230401	Mfg. Date	20230401
Exp. Date	20260331	Report Date	2023.05.15
Inspection Standard	JB/T 8230.4-1997		
Technical Requirement			Conclusion
The size of cover glass is 24x24mm.			Meet the requirement
The cover glass is colorless and transparent.			Meet the requirement
The surface should be smooth and thickness should be uniformity.			Meet the requirement
The cover glass should be clean, no mist, fingerprint or water stains.			Meet the requirement
The edges should be smooth and without damage.			Meet the requirement
After boiled test, the microscope slide should be no blur, bubble or crack.			Meet the requirement
Conclusion: According to the requirements of JB/T 8230.4-1997, concluded that this batch pass.			

Checker: Leo Sun Date: 2023.05.15

Approved: Irene Qiao Date: 2023.05.15

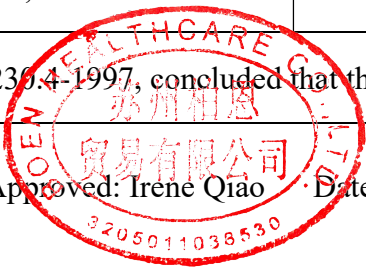

Microscope Cover Glass



Microscope Cover Glass

Hinged-lid box wrapped in Individual Vacuum Tropical Pack. 200pcs/box. Or package of 10×100pcs/Vacuum Tropical Pack.

Cat.No.	Description	Thickness (mm)		Qty/Case (bxs)
		No.1	No.2	
620801	12×12mm	0.13-0.17	0.17-0.25	100
620802	14×14mm	0.13-0.17	0.17-0.25	100
620803	16×16mm	0.13-0.17	0.17-0.25	100
620804	18×18mm	0.13-0.17	0.17-0.25	100
620805	20×20mm	0.13-0.17	0.17-0.25	100
620806	22×22mm	0.13-0.17	0.17-0.25	100
620807	24×24mm	0.13-0.17	0.17-0.25	100

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001:2008 & UNI CEI EN ISO 13485:2012

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
07.02.2015

ARTICOLO: **SACCHETTI CON FILTRO PER STOMACHER®**
ITEM: **BAGS WITH FILTER FOR STOMACHER®**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Sacchetti sterili con filtro per omogeneizzatori a battuta tipo Stomacher®

Sacchetti rigidi e trasparenti, in polietilene (PE), sterili R.

I sacchetti sono testati in base a diversi parametri, in particolare capacità di apertura, tenuta alla base e dimensioni.

Disponibili nelle versioni:

- > con filtro interno a foglio singolo sull'intera superficie (particolarmente idonei per campioni pastosi)
- > con filtro laterale (particolarmente idonei per campioni fibrosi)

Sacchetti conformi per alimenti secondo la legislazione vigente.
Dispositivi Latex Free

Conformi alla ISO 4833-2



Sterile bags with filter for Stomacher® blenders

Rigid and transparent polyethylene (PE) bags, sterile R. Bags are tested by various parameters, in detail by opening capacity, sealing at the base and dimensions.

Bags available in two different type:

- > with full surface filter (ideal for pasty sample)
- > with lateral filter (ideal for fibrous sample)

Suitable for foodstuff in accordance with applicable law.
Latex free device.

In compliance with ISO 4833-2 new standards

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella per "USI GENERALI DI LABORATORIO". Sacchetti ideali per la raccolta, la macinazione e l'omogeneizzazione dei prodotti alimentari o similari. Prodotto non soggetto a marcatura CE.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

*Intended purpose: "GENERAL LABORATORY USE". Ideal for sampling, mincing and homogenisation of foodstuff or similar.
PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.*

For professional use only.

Codice / Code: 10330

Con **filtro interno micro perforato a foglio singolo sull'intera superficie** per l'omogeneizzazione e l'automatica filtrazione del campione, particolarmente idoneo per campioni viscosi/pastosi (cioccolata, torte, formaggi...). Porosità del filtro 280 micron. Sterili.

La flora è estratta dal campione e passa attraverso il filtro durante la miscelazione. È quindi possibile pipettare dietro il filtro senza avere nessun residuo o particelle del campione.

With full-surface calibrated microperforated filter for sample homogenization and automatic filtration, particularly suitable for pasty/viscous samples (chocolate, cakes, cheese...).

Filter porosity 280 micron. Sterile.

Flora is extracted from the sample and goes through the filter during blending. You can then pipet behind the filter with no residue or particles of the sample.

FILTRAZIONE IMMEDIATA

- Filtrazione già durante l' omogeneizzazione
- Non c'è bisogno di aspettare la sedimentazione dei residui
- Soluzione senza residui/particelle, senza residui sulla piastra di Petri: rapido conteggio delle colonie
- Risultati precisi e di ottima riproducibilità

NESSUNA CONTAMINAZIONE INCROCIATA

- Sacchetti sterili
- Lo stesso sacchetto viene utilizzato per omogeneizzare, filtrare e pipettare
- Nessun contatto tra il campione e l'omogenizzatore durante l'omogeneizzazione

FACILE DA USARE

- Adatto a tutti i campioni
- Compatibile con qualsiasi omogeneizzatore
- Approvato per il contatto con alimenti

INSTANT FILTRATION


- Filtration during homogenization
- No need to wait for debris sedimentation
- Particle-free solution, no debris on the Petri dish: quick colony counting
- Precise results and excellent reproducibility

NO CROSS-CONTAMINATION

- Sterile bags
- Same bag is used to homogenize, filter and pipet
- No contact between the sample and the blender during homogenization

USER-FRIENDLY

- Adapted to all samples
- Compatible with any lab blender
- Approved for food contact

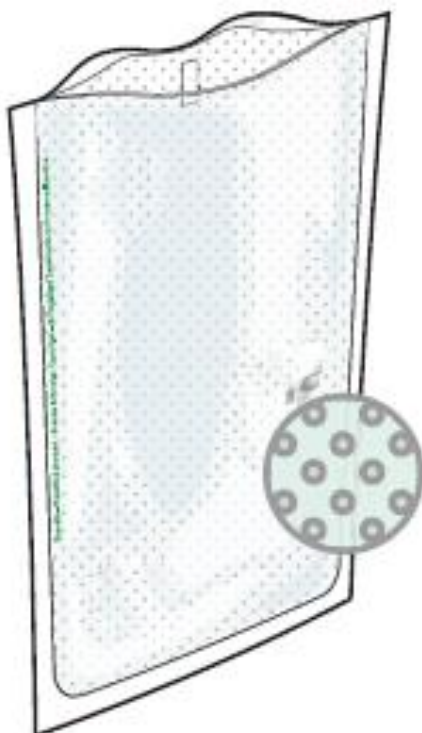

Compatibilità	Compatibility
Stomacher® 400 (o similari / or similar)	
Stato microbiologico	Microbiological status
Sterile tramite radiazioni ionizzanti 12 kGy Sterile by ionizer Rays 12 kGy	
Materiale	Raw material
Polietilene - Multilayer®, reinforced multicoated complex	
Dimensioni	Dimensions
190 x 300 mm	
VOLUME NOMINALE	NOMINAL VOLUME
400 mL	
VOLUME DI UTILIZZO	USEFUL VOLUME
50-300 mL	
POROSITÀ DEL FILTRO	FILTER POROSITY
280 micron / microns	
CONFEZIONI INTERNE STERILI	STERILE PACK OF
Sacchetti / Bags 25 pcs	
Scatola	Box
500 pcs (20 x 25 pcs) 22 x 37,5 x 26 cm - 5,75 Kg.	

Codice / Code: 10331

Con filtro interno laterale in tessuto non tessuto per l'omogeneizzazione e l'automatica filtrazione del campione, particolarmente adatto per campioni fibrosi e per prelievo con micropipetta. Porosità del filtro inferiore a 250 micron. Sterili.

La flora è estratta dal campione e passa attraverso il filtro durante la miscelazione. È quindi possibile pipettare dietro il filtro senza avere nessun residuo o particelle del campione.

With internal side non-woven filter for sample homogenization and automatic filtration, particularly suitable for fibrous samples and for pipetting. Filter porosity inferior to 250 micron. Sterile

Flora is extracted from the sample and goes through the filter during blending. You can then pipet behind the filter with no residue or particles of the sample.

Particolarmente idonei per il pipettaggio

FILTRAZIONE IMMEDIATA

- Filtrazione già durante l' omogeneizzazione
- Non c'è bisogno di aspettare la sedimentazione dei residui
- Soluzione senza residui/particelle, senza residui sulla piastra di Petri: rapido conteggio delle colonie
- Risultati precisi e di ottima riproducibilità

NESSUNA CONTAMINAZIONE INCROCIATA

- Sacchetti sterili
- Lo stesso sacchetto viene utilizzato per omogeneizzare, filtrare e pipettare
- Nessun contatto tra il campione e l'omogenizzatore durante l'omogeneizzazione

FACILE DA USARE

- Adatto a tutti i campioni
- Compatibile con qualsiasi omogeneizzatore
- Approvato per il contatto con alimenti

Particularly suitable for pipetting

INSTANT FILTRATION


- Filtration during homogenization
- No need to wait for debris sedimentation
- Particle-free solution, no debris on the Petri dish: quick colony counting
- Precise results and excellent reproducibility

NO CROSS-CONTAMINATION

- Sterile bags
- Same bag is used to homogenize, filter and pipet
- No contact between the sample and the blender during homogenization

USER-FRIENDLY

- Adapted to all samples
- Compatible with any lab blender
- Approved for food contact

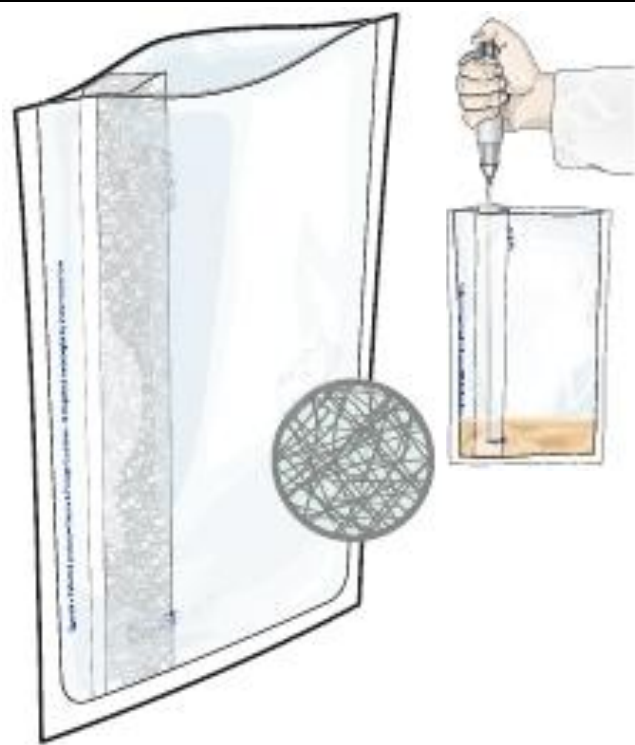

Compatibilità	Compatibility
Stomacher® 400 (o similari / or similar)	
Stato microbiologico	Microbiological status
Sterile tramite radiazioni ionizzanti 12 kGy Sterile by ionizer Rays 12 kGy	
Materiale	Raw material
Polietilene - Multilayer®, reinforced multicoated complex	
Dimensioni	Dimensions
190 x 300 mm	
VOLUME NOMINALE	NOMINAL VOLUME
400 mL	
VOLUME DI UTILIZZO	USEFUL VOLUME
50-300 mL	
POROSITÀ DEL FILTRO	FILTER POROSITY
< 250 micron / microns	
CONFEZIONI INTERNE STERILI	STERILE PACK OF
Sacchetti / Bags 25 pcs	
Scatola	Box
500 pcs (20 x 25 pcs) 37,5 x 15 x 23 cm - 4,70 Kg.	

COMPARAZIONE / COMPARISON

Ecco un confronto tra un campione* omogeneizzato in un sacchetto senza filtro e in un sacchetto con filtro. La concentrazione batterica rimane invariata dopo filtrazione

Here is a comparison of a sample* homogenized in a bag without a filter and in a bag with filter. The bacterial concentration remains the same after filtration



Risparmio di tempo:

Nessun tempo di sedimentazione richiesto

Conteggio delle colonie ottimizzato:

Nessun residuo sulla piastra di Petri

Time saver:

No sedimentation required

Colony counting optimized:

No debris on the Petri dish

* Analisi Lactobacillus in un campione di formaggio, su piastra MRS agar incubata a 30° C per 48h.

* *Lactobacillus* analysis in a cheese sample, plated on MRS agar incubated at 30°C for 48h.

SACCHETTI IDONEI PER / BAGS ADAPTED FOR

Analisi microbiologiche di cibo e prodotti agricoli (Es: carne, carne cotta, pesce, piatti pronti, frutta, verdura)

Analisi microbiologiche in campo farmaceutico (Es: pillole, compresse, blister, polveri)

Analisi microbiologiche ambientali (Es: piante, suolo, membrane di filtrazione, tessuti)

Food and agricultural microbiological analyses (Ex: meat, cooked meat, fish, prepared dishes, fruits, vegetables)

Pharmacological microbiological analyses (Ex: pills, tablets, blisters, powders)

Environmental microbiological analyses (Ex: plants, soil, filtration membranes, tissues)



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substances, check the resistance / compatibility chart on our catalogue

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays


SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
06.11.2020



ARTICOLO: **SACCHETTI PER STOMACHER®**
ITEM: **BAGS FOR STOMACHER®**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

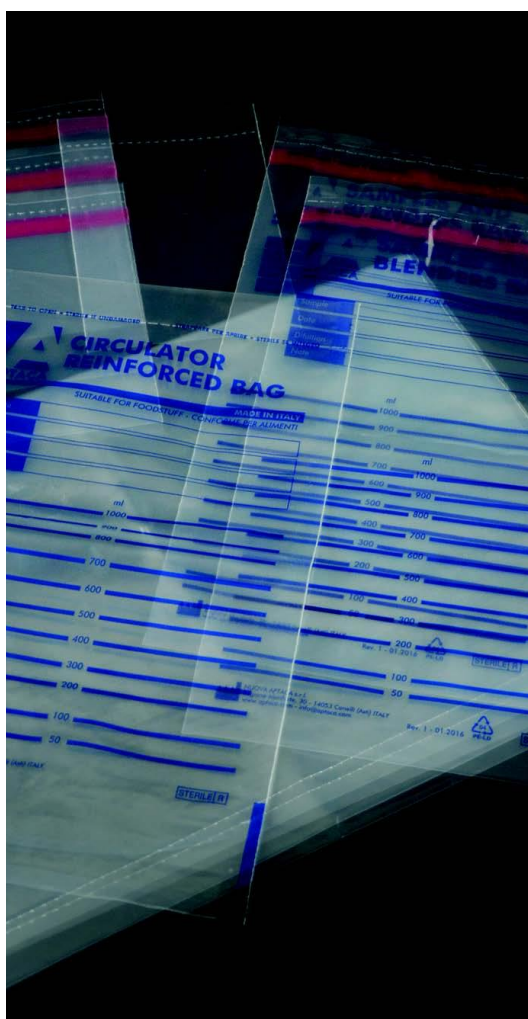

Sacchetti sterili per omogeneizzatori a battuta tipo Stomacher®

Sacchetti trasparenti, sterili R, con sigillo a strappo. Infatti per aprirli è necessario strappare lungo la linea tratteggiata posta sulla parte superiore. In tal modo l'operatore ha la certezza che il sacchetto sia sterile anche se la confezione è stata in precedenza aperta. I sacchetti sono testati in base a diversi parametri, in particolare capacità di apertura, tenuta alla base e dimensioni. I sacchetti per Stomacher® 400 sono disponibili anche nella versione con fondo interno arrotondato tipo "circulator" e rinforzato per migliorare la circolazione del campione, evitando il ristagno negli angoli. I sacchetti prodotti in LDPE hanno uno spessore di 65 µm. I sacchetti prodotti in PA/PE (Nylon) hanno uno spessore di 70 µm, ideali per sostanze particolarmente dure e per tempi di omogeneizzazione più lunghi. Sacchetti conformi per alimenti secondo la legislazione vigente. Disponibili anche nella versione "Closure bag" sigillabile tramite bioadesivo che consente l'utilizzo dello stesso sacchetto sia per il campionamento sia per l'omogeneizzazione. Dispositivi Latex Free

Sterile bags for Stomacher® blenders

Transparent bags, sterile R, with tear seal. In fact, is necessary for opening tear along the dotted line on the top. In this way the operator has the assurance that the bag is sterile, even if the package has been previously opened. Bags are tested by various parameters, in detail by opening capacity, sealing at the base and dimensions. Bags for Stomacher® 400 are also available with rounded inner bottom "circulator" type and strengthened to improve the circulation of the sample, avoiding the stagnation in the corners. Bags made in LDPE have a thickness of 65 µm. Bags made in PA/PE (nylon) have a thickness of 70 µm, ideal for particularly hard substances and for more long blending time. Suitable for foodstuff in accordance with applicable law. Available also in "Closure bag" version sealable by double sided tape that allows the use of the same bag, both for sampling and blending. Latex free device.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella per "USI GENERALI DI LABORATORIO". Sacchetti ideali per la raccolta, la macinazione e l'omogeneizzazione dei prodotti alimentari o similari. Prodotto non soggetto a marcatura CE.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Intended purpose: "GENERAL LABORATORY USE". Ideal for sampling, mincing and homogenisation of foodstuff or similar.

PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For professional use only.

Sacchetti per Stomacher® 80 / Bags for Stomacher® 80




Compatibilità	Compatibility
Stomacher® 80 & 80 MicroBiomaster (o similari / or similar)	
Stato microbiologico	Microbiological status
Sterile tramite radiazioni ionizzanti Raggi Beta 21 kGy <i>Sterile by ionizer Beta Rays 21 kGy</i>	
Materiale	Raw material
Polietilene bassa densità (LDPE) / Low Density Polyethylene (LDPE)	
Dimensioni	Dimensions
105 x 155 mm	
VOLUME	VOLUME
5 - 80 ml	
SPESSORE	THICKNESS
65 µm	
COD. 10301	
Tipo fondo	Bottom type
Quadrato / Square	
Tipo chiusura	Closure type
Standard	
COD. 10302	
Tipo fondo	Bottom type
Quadrato / Square	
Tipo chiusura	Closure type
"Closure bag" sigillabile tramite biadesivo <i>"Closure bag" version sealable by double sided tape</i>	

Sacchetti per Stomacher® 3500 / Bags for Stomacher® 3500



Compatibilità	Compatibility
Stomacher® 3500 Jumbo (o similari / or similar)	
Stato microbiologico	Microbiological status
Sterile tramite radiazioni ionizzanti Raggi Beta 21 kGy <i>Sterile by ionizer Beta Rays 21 kGy</i>	
Materiale	Raw material
Polietilene bassa densità (LDPE) / Low Density Polyethylene (LDPE)	
Dimensioni	Dimensions
380 x 510 mm	
VOLUME	VOLUME
400 - 3500 ml	
SPESSORE	THICKNESS
65 µm	
COD. 10321	
Tipo fondo	Bottom type
Quadrato / Square	
Tipo chiusura	Closure type
Standard	

Sacchetti per Stomacher® 400 / Bags for Stomacher® 400

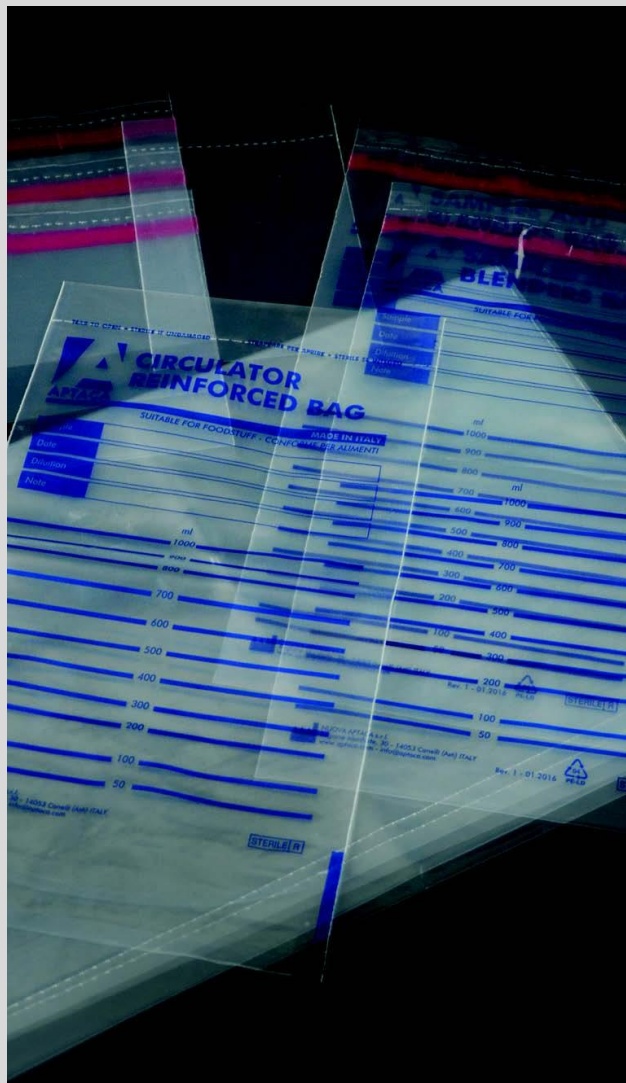

Stato microbiologico	Microbiological status
Sterile tramite radiazioni ionizzanti Raggi Beta 21 kGy <i>Sterile by ionizer Beta Rays 21 kGy</i>	
Dimensioni	Dimensions
180 x 320 mm	
VOLUME	VOLUME
80 - 400 ml	
COD. 10310	
Compatibilità	Compatibility
Stomacher® 400 Classic (o similari / <i>or similar</i>)	
Materiale	Raw material
Polietilene bassa densità (LDPE) / <i>Low Density Polyethylene (LDPE)</i>	
SPESSORE	THICKNESS
65 µm	
Tipo fondo	Bottom type
Quadrato / <i>Square</i>	
Tipo chiusura	Closure type
Standard	
COD. 10311	
Compatibilità	Compatibility
Stomacher® 400 Classic (o similari / <i>or similar</i>)	
Materiale	Raw material
Polietilene bassa densità (LDPE) / <i>Low Density Polyethylene (LDPE)</i>	
SPESSORE	THICKNESS
65 µm	
Tipo fondo	Bottom type
Quadrato / <i>Square</i>	
Tipo chiusura	Closure type
"Closure bag" sigillabile tramite biadesivo <i>"Closure bag" version sealable by double sided tape</i>	
COD. 10312	
Compatibilità	Compatibility
Stomacher® 400 Circulator (o similari / <i>or similar</i>)	
Materiale	Raw material
PA / PE (Nylon)	
SPESSORE	THICKNESS
70 µm	
Tipo fondo	Bottom type
Circulator	
Tipo chiusura	Closure type
Standard	
COD. 10313	
Compatibilità	Compatibility
Stomacher® 400 Circulator (o similari / <i>or similar</i>)	
Materiale	Raw material
PA / PE (Nylon)	
SPESSORE	THICKNESS
70 µm	
Tipo fondo	Bottom type
Circulator	
Tipo chiusura	Closure type
"Closure bag" sigillabile tramite biadesivo <i>"Closure bag" version sealable by double sided tape</i>	



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy
Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92
E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

CONFEZIONE / PACKAGING

Codice Code	Quantità Quantity	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)	Volume (m ³) Volume (m ³)	Peso (Kg.) Weight (Kg.)
10301	10 x 100 pcs	35,5 x 23,5 x 25,5	0,021	2,5
10302	10 x 100 pcs	35,5 x 23,5 x 25,5	0,021	2,5
10310	10 x 100 pcs	35 x 22,6 x 18,5	0,015	8,85
10311	10 x 100 pcs	35 x 22,6 x 18,5	0,015	9
10312	10 x 100 pcs	35,5 x 23,5 x 25,5	0,021	10
10313	10 x 100 pcs	35,5 x 23,5 x 25,5	0,021	10
10321	20 x 50 pcs	46 x 36 x 25	0,041	24

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substances, check the resistance / compatibility chart on our catalogue

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001 & UNI EN ISO 13485

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
25.11.2020



CODICE ARTICOLO: **SACCHETTI PER AUTOCLAVE IN POLIPROPILENE**

ITEM CODE: **POLYPROPYLENE AUTOCLAVE BAGS**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Sacchetti in polipropilene (PP), per sterilizzazione in autoclave, resistenti fino a 134°C. Sacchetto tipo "monopiega".

Questi sacchetti sono particolarmente utili per eliminare, mediante sterilizzazione in autoclave, sostanze patogene presenti in recipienti contaminati (pipette, provette, piastre Microtiter, ecc.).

Simbolo "BIOHAZARD" ed istruzioni per l'uso stampate direttamente sul sacchetto.

Spessore 40 my.

Polypropylene (PP) bags for autoclave sterilization, resistant up to 134°C. Bags single fold type.

These bags are particularly useful in order to remove, by autoclave sterilization process, pathogenic substances normally present in contaminated containers (pipettes, test tubes, Microtiter plates, ecc.).

"BIOHAZARD" symbol and operating instructions directly printed on the bag.

Thickness 65 my



SIMBOLO "BIOHAZARD" ED ISTRUZIONI PER L'USO STAMPATE DIRETTAMENTE SUL SACCHETTO.

STAMPA MONOCOLORE GIALLA CONFORME ALLA UNI 7545/1-10 (PANTONE 109C / RAL 1023) SU SACCHETTO TRASPARENTE.

"BIOHAZARD" SYMBOL AND OPERATING INSTRUCTIONS DIRECTLY PRINTED ON THE BAG. WRITTEN IN YELLOW COLOUR CONFORM TO UNI 7545/1-10 (PANTONE 109C / RAL 1023) PRINTED ON TRANSPARENT BAG.



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	<i>Raw material</i>
Temperatura massima di utilizzo	+ 134 °C (+273.2 °F)	<i>Max working temperature</i>
Spessore	40 MY	<i>Thickness</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

CODICE CODE	DIMENSIONI (MM) DIMENSIONS (MM)	SPESSORE (MY) THICKNESS (MY)	VOLUME (L) VOLUME (L)	QUANTITÀ PER CONFEZIONE QUANTITY FOR BOX	DIMENSIONE DELLA CONFEZIONE BOX DIMENSIONS
10570	300 x 660	40	about 15	1.000	460 x 360 x 250 mm Vol. 0,041 m ³ 15,0 Kg.
10571	400 x 660	40	about 30	1.000	460 x 360 x 250 mm Vol. 0,041 m ³ 20,0 Kg.
10572	600 x 760	40	about 80	500	460 x 360 x 250 mm Vol. 0,041 m ³ 16,5 Kg.
Tolleranze dimensionali / Dimensional tollerances: ± 5 mm					

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella per "USI GENERALI DI LABORATORIO". Prodotto adatto per effettuare la sterilizzazione in autoclave.

IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose: "GENERAL LABORATORY USE". Product suitable for autoclave sterilization.

PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For use in professional test laboratory only

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- > I contenitori riempiti con liquido non devono essere sigillati o tappati;
- > Non introdurre oggetti appuntiti, come vetreria rotta, nei sacchi per autoclave;
- > Aggiungere un po' d'acqua ai sacchi contenenti residui solidi. L'acqua vaporizzerà convogliando all'esterno l'aria residua una volta raggiunta la temperatura di sterilizzazione internamente ai sacchi;
- > Non chiudere il sacco, in quanto ciò impedirà all'aria di allontanarsi durante il processo di sterilizzazione;
- > Non sovraccaricare l'autoclave e lasciare uno spazio sufficiente alla circolazione del vapore;
- > Per la decontaminazione ed inertizzazione di rifiuti biologici particolarmente resistenti, autoclavare a +134°C

- > *Containers filled with liquid, must not be sealed or tapped;*
- > *Do not introduce sharp objects, such as broken glassware, into the autoclave bags;*
- > *Add a little high of water into the bags containing solid residues. The water will vaporize channeling outside the residual air once reached the sterilization temperature internally to the bags;*
- > *Do not close the bag as this will avoid to the air to move out during the sterilization process;*
- > *Do not overload the autoclave and leave enough space for the steam circulation;*
- > *For the decontamination and deactivation of biological waste, particularly resistant, to do autoclave process at +134 °C.*



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substances, check the resistance / compatibility chart on our catalogue

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable

SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
06.11.2020



CODICE ARTICOLO: **10591**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



SACCHETTI PER TRASPORTO CAMPIONI

In polietilene bassa densità (LDPE), realizzati in due parti, la prima perfettamente trasparente con chiusura a “clip” per contenere le provette o altri tipi di contenitori, la seconda a tasca per contenere le richieste di esame. Anche in caso di apertura accidentale delle provette o dei contenitori non si hanno perdite di liquidi biologici (garantendo in tal modo la sicurezza del personale) ed al tempo stesso si preserva la richiesta d'esame inserita nell'apposita tasca. Con simbolo e dicitura “Biohazard” in giallo. Il dispositivo è esente da lattice e/o gomma naturale (Latex-free).

BAGS FOR TRANSPORTATION OF SAMPLES

In Low Density Polyethylene (LDPE), made in 2 parts, the first one, transparent, with snap closure to contain the tubes or other types of containers, the second one, pocket-shaped, may contain the test paper request. No leakages are possible even in the occurrence of accidental opening of test tubes or containers (this way granting the users safety) and at same time prevents any damages to test paper request. provided of “biohazard” symbol and indication in yellow color. Latex free device

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLIETILENE LDPE POLYETHYLENE LDPE	<i>Raw material</i>
Temperature tollerate	MIN -50°C MAX +75°C	<i>Temperature range</i>
Dimensioni tasca a clip	15,5 x 17,5 + 2 CM	<i>Dimensions – part with snap closure</i>
Dimensione tasca aperta	15,5 x 23,5 CM	<i>Dimensions – pocket</i>
Spessore tasca a clip	50 µm	<i>Thickness - part with snap closure</i>
Spessore tasca aperta	30 µm	<i>Thickness – pocket</i>
Colore	Cod. 10591 > NEUTRO / NEUTRAL Cod. 10591/R > ROSSO / RED Cod. 10591/G > GIALLO / YELLOW	<i>Colour</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com



SIMBOLO “BIOHAZARD” STAMPATO DIRETTAMENTE SUL SACCHETTO.

STAMPA MONOCOLORE GIALLA CONFORME ALLA UNI 7545/1-10 (PANTONE 109C / RAL 1023) SU SACCHETTO TRASPARENTE.

“BIOHAZARD” SYMBOL DIRECTLY PRINTED ON THE BAG.

WRITTEN IN YELLOW COLOUR CONFORM TO UNI 7545/1-10 (PANTONE 109C / RAL 1023) PRINTED ON TRANSPARENT BAG.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella per “USI GENERALI DI LABORATORIO”. Prodotto adatto a contenere provette e contenitori per il trasporto. IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE

Il dispositivo in oggetto è stato realizzato secondo le procedure di Qualità interne ed è verificato con controlli effettuati secondo specifiche metodologie conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 e risponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di conformità previsti dalle Normative e Direttive vigenti.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Intended purpose: “GENERAL LABORATORY USE”. Product suitable for transportation of test tubes and containers. PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

The Device in object is realized in compliance with internal Quality procedures and tested by controls effected with specific methodologies in accordance with UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 13485 rules and meets the basic requirements of security and conformity provided by current regulations and directives.

For professional use only.



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substances, check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 1.000
Quantity (pcs):

Confezione interna (pz): 50
Internal packing (pcs):

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm):
External box dimensions (cm):

35 x 22.6 x 18.5

Peso (Kg): 5,72
Weight (Kg):

Volume (m³): 0,015
Volume (m³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable




XL BAGS FOR SAMPLES TRANSPORTATION

In polyethylene, made in 2 parts, the first with snap closure to contain test tubes or other types of containers, the second one, open, may contain the test paper requests. Available in 3 colours. With “BIOHAZARD” symbol and logo.

Cod.	Dim. mm bag	Dim. mm open bag
10593	200 x 290	200 x 320
10594	300 x 350	300 x 400

Serological Pipette

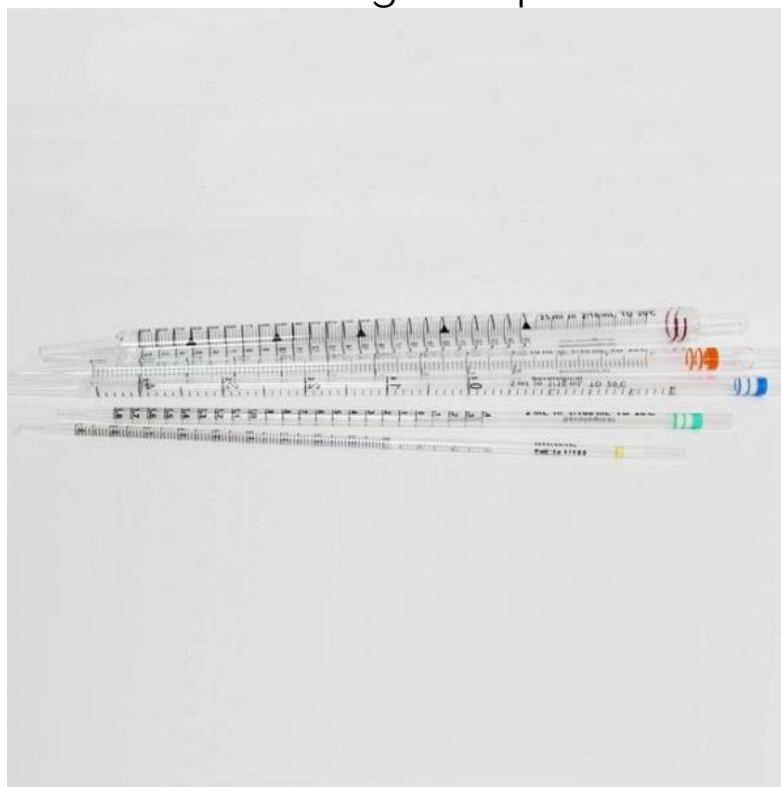

Serological Pipettes

Serological Pipette, designed for quantitatively transferring and dispensing exact volumes of liquid. Manufactured from virgin polystyrene.

Accurate graduation, easy to read, color-codes by size for identification.

Available with 6 capacity of 1, 2, 5, 10, 25 and 50ml

Serological Pipettes are supplied gamma radiation, available with bulk package or in a paper/ plastic bag.

Dnase & Rnase free.

Cat No.	Description	Qty/Case
640601	Serological Pipettes, PS, 1ml	4000
640602	Serological Pipettes, PS, 2ml	3200
640603	Serological Pipettes, PS, 5ml	1800
640604	Serological Pipettes, PS, 10ml	1200
640605	Serological Pipettes, PS, 25ml	800
640606	Serological Pipettes, PS, 50ml	800

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: GM03-BN23

Product Name	Serological Pipette	Specification	1ml
Lot. No.	10122123	Quantity	50000pcs
Mfg. Date	20221206	Exp. Date	20251205
Test Standard	Factory Standard	Report Date	2023.05.15
Item	Technical Requirement	Result	Conclusion
Appearance	The surface of serological pipette should be smooth, no black spot, no edges and other defects.	Comply	Qualified
	The color of the tube is transparent.	Comply	Qualified
	The graduation line should be clear, no blur.	Comply	Qualified
	The pipette is straight, no bend.	Comply	Qualified
Packaging	The Pasteur pipette should be sealed complete and there is no foreign matter in the bag.	Comply	Qualified
Sterile	The serological pipette should be sterile.	Comply	Qualified
Conclusion	Meet the requirement		

Inspector: Leo Sun

Date: 2023.05.15

Checker: Irene Qiao

Date: 2023.05.15



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: GM03-BN23

Product Name	Serological Pipette	Specification	2ml
Lot. No.	10222111	Quantity	4000pcs
Mfg. Date	20221105	Exp. Date	20251104
Test Standard	Factory Standard	Report Date	2023.05.15
Item	Technical Requirement	Result	Conclusion
Appearance	The surface of serological pipette should be smooth, no black spot, no edges and other defects.	Comply	Qualified
	The color of the tube is transparent.	Comply	Qualified
	The graduation line should be clear, no blur.	Comply	Qualified
	The pipette is straight, no bend.	Comply	Qualified
Packaging	The Pasteur pipette should be sealed complete and there is no foreign matter in the bag.	Comply	Qualified
Sterile	The serological pipette should be sterile.	Comply	Qualified
Conclusion	Meet the requirement		

Inspector: Leo Sun
Date: 2023.05.15

Checker: Irene Qiao
Date: 2023.05.15



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: GM03-BN23

Product Name	Serological Pipette	Specification	5ml
Lot. No.	10522122	Quantity	4000pcs
Mfg. Date	20221204	Exp. Date	20251203
Test Standard	Factory Standard	Report Date	2023.05.15
Item	Technical Requirement	Result	Conclusion
Appearance	The surface of serological pipette should be smooth, no black spot, no edges and other defects.	Comply	Qualified
	The color of the tube is transparent.	Comply	Qualified
	The graduation line should be clear, no blur.	Comply	Qualified
	The pipette is straight, no bend.	Comply	Qualified
Packaging	The Pasteur pipette should be sealed complete and there is no foreign matter in the bag.	Comply	Qualified
Sterile	The serological pipette should be sterile.	Comply	Qualified
Conclusion	Meet the requirement		

Inspector: Leo Sun
Date: 2023.05.15

Checker: Irene Qiao
Date: 2023.05.15



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: GM03-BN23

Product Name	Serological Pipette	Specification	10ml
Lot. No.	11022061	Quantity	4000pcs
Mfg. Date	20220602	Exp. Date	20250601
Test Standard	Factory Standard	Report Date	2023.05.15
Item	Technical Requirement	Result	Conclusion
Appearance	The surface of serological pipette should be smooth, no black spot, no edges and other defects.	Comply	Qualified
	The color of the tube is transparent.	Comply	Qualified
	The graduation line should be clear, no blur.	Comply	Qualified
	The pipette is straight, no bend.	Comply	Qualified
Packaging	The Pasteur pipette should be sealed complete and there is no foreign matter in the bag.	Comply	Qualified
Sterile	The serological pipette should be sterile.	Comply	Qualified
Conclusion	Meet the requirement		

Inspector: Leo Sun
Date: 2023.05.15

Checker: Irene Qiao
Date: 2023.05.15



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: GM03-BN23

Product Name	Sterile Pasteur Pipette	Specification	1ml, 3ml
Lot. No.	20230401	Quantity	1000000pcs
Mfg. Date	2023-04	Exp. Date	2026-03
Test Standard	Factory Standard	Report Date	2023.05.15
Item	Technical Requirement	Result	Conclusion
Appearance	The surface of Pasteur pipette should be sooth, no crack, no scratches, no flying edges or other defects.	Comply	Qualified
	The color is transparent, no foreign matter.	Comply	Qualified
	The graduation line is clear.	Comply	Qualified
Packaging	The Pasteur pipette should be sealed complete and there is no foreign matter in the bag.	Comply	Qualified
Sterile	The Pasteur pipette should be sterile. DNase, RNase and pyrogen free.	Comply	Qualified
Conclusion	Meet the requirement		

Inspector: Leo Sun
Date: 2023.05.15

Checker: Irene Qiao
Date: 2023.05.15



Pasteur Pipette



Pasteur Pipette

Pasteur pipette, made from medical grade LDPE.

Graduated pasteur pipette, with moulded graduations make it easy to perform quick measured liquid transfer.


Transfer pipette, with variety of volume for choices. 1ml,,3ml,5ml.

Available for E.O. sterilization or non sterile.

Bulk and individual packing or other.

Cat No.	Description	Qty/Case
640701	Pasteur pipette 1ml, with graduation, bulk pack	30000
640702	Pasteur pipette 1ml, with graduation, sterile, individual pack	30000
640703	Pasteur pipette 3ml, with graduation, bulk pack	20000
640704	Pasteur pipette 3ml, with graduation, sterile, individual pack	20000
640705	Pasteur pipette 5ml, with graduation, bulk pack	10000
640706	Pasteur pipette 5ml, with graduation, sterile, individual pack	10000

Polyester-Tipped Applicators

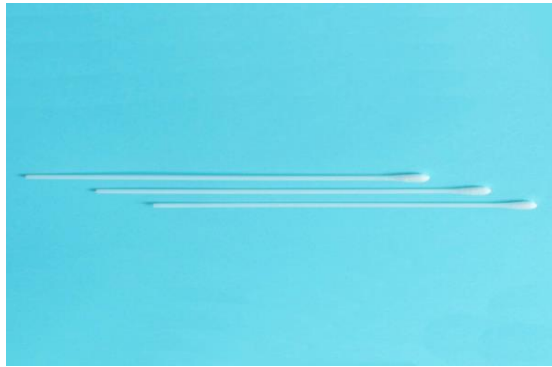

Polyester-Tipped Applicators

Featuring a diagnostic grade polyester tip, these applicators are available with a shaft made of wood, plastic or aluminum.

Choose sterile in packs of one or two applicators or nonsterile in bulk pack.

Cat. No.	Shaft Type	Size (cm)	Qty/Case (pcs)
Sterile Applicators, 2 Pack			
611601	Wood	15	1000
611602	Plastic	15	1000
Sterile Applicators, 1 Pack			
611603	Wood	15	1000
611604	Plastic	15	1000
Non sterile Applicators			
611605	Wood	15	10000
611606	Plastic	15	10000


Flocked Swab with Tube

Flocked Swab with Tube

Flocked swab, ABS stick with nylon flocked tip, color code red in polypropylene test tube ø 12×150 mm, sterile.

Suitable for most specimen, such as from throat, vaginal, skin and wound specimens.

Package: 100pcs/bag, 1000pcs/case

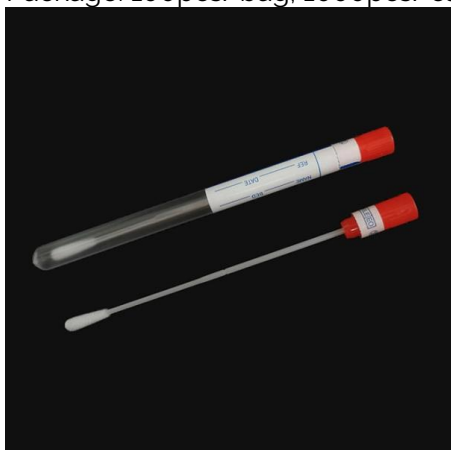

Cat No.	Description	Qty/Case
612701	Flocked Swab with Tube, Nasal type, with 8cm break point. Sterile, 100pcs/bag	2000
612702	Flocked Swab with Tube, Oral type, with 3cm break point. Sterile, 100pcs/bag	2000
612703	Flocked Swab with Tube, Oral type, with 8cm break point. Sterile, 100pcs/bag	2000

BOEN HEALTHCARE CO., LTD.

Certificate of Analysis

Report No.: GM03-BN23

Product Name	Wooden tongue depressor	Specification	Adult
Order Qty	500bxs	Inspection Date	2023.05.20
Inspection Standard	Factory Standard	Report Date	2023.05.20

Item	Technical Requirement	Result	Conclusion
Appearance	The color of the product is uniform, close to the natural color of the wood, and black or moldy is not allowed.	Comply	Qualified
	The surface of the product should be smooth, flat, and clean. No burrs, sawdust, pollution, cracks, black holes or other defects.	Comply	Qualified
Peculiar smell	No peculiar smell.	Comply	Qualified
Size	Tolerance: $\pm 10\%$	Comply	Qualified
Sterile	The product shall be sterile.	Comply	Qualified
Conclusion	Meet the requirement		

Inspector: Tom Li
Date: 2023.05.20

Checker: Leo Sun
Date: 2023.05.20



SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
18.09.2023




ARTICOLO: **PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO EPPENDORF® 5 - 200 µL**
ITEM: **TIPS FOR MICROPIPETTES EPPENDORF® TYPE 5 - 200 µL**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Technical view

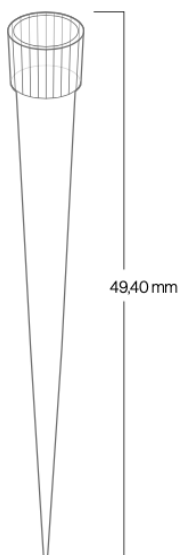





Puntali low retention realizzati in polipropilene medicale (PP) ad elevata purezza ed esente da Cadmio ed altri metalli pesanti. Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento. Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili fino a +121°C. Dispositivo Latex free. Disponibili in diversi confezionamenti:

- Non sterili in sacchetti da 1.000 pezzi
- Sterili apirogeni in confezioni da 5 pezzi o in confezione singola
- Non sterili o sterili apirogeni in rack autoclavabile con coperchio da 96 pezzi singolarmente sigillato con film trasparente per garantirne la sterilità.
- Piastrine intercambiabili (Refill) da 96 pezzi

Low retention tips made of medical polypropylene (PP) of high purity, cadmium and heavy metal free. Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process. Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable up to +121°C. Latex-free device. Available with different packaging:

- *Not sterile in bags of 1,000 pieces*
- *Sterile pyrogen free in bags of 5 pieces or individually wrapped*
- *Non sterile or sterile pyrogen free in autoclavable rack with lid of 96 pieces individually sealed by transparent film to grant its sterility.*
- *Refill trays of 96 pieces*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Materiale impiegato	Polipropilene / Polypropylene	Raw material
Temperature tollerate	min -10°C max +121°C	Temperature range
Volume	5 – 200 µl	Volume
Modello	EPPENDORF® all model	Type
Compatibilità	Gilson® Pipetman P20-100-200 - Biohit® Proline & mLine – Brand® Transferpette - Socorex® Acura & Calibra – HTL® Discovery - Nichiryo® - Thermo Scientific™ Finn timer™ and similar	Compatibility
Lunghezza totale (mm)	49,40	Total lenght (mm)
Peso (g)	0,31	Weight (g)
Validità del prodotto	3 Anni / Years	Shelf life

				Scatola / Box QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE MINIMUM SALEABLE QUANTITY		
REF	Sterile R	Colore Colour	Confezione interna Internal packing	Quantità Quantity	Dimensioni Dimensions	Peso (Kg.)
1202/E		Giallo Yellow	Sacchetti da 1000 pz Bags of 1000 pcs 	10.000 pcs (10 x 1.000 pcs)	40 x 25,2 x 29 cm 0,029 m ³	3,6
1202/E*		Giallo Yellow	Sacchetti da 1000 pz Bags of 1000 pcs 	25.000 pcs (25 x 1.000 pcs)	55,5 x 42,5 x 34 cm 0,087 m ³	8,9
1202/EN		Neutro Neutral	Sacchetti da 1000 pz Bags of 1000 pcs 	10.000 pcs (10 x 1.000 pcs)	40 x 25,2 x 29 cm 0,029 m ³	3,6
1202/E/SG	✓	Giallo Yellow	Sacchetti da 5 pz Bags of 5 pcs 	1.000 pcs (200 x 5 pcs)	29,3 x 17,5 x 24 cm 0,012 m ³	1,1
1202/E/SG/CS	✓	Giallo Yellow	Confezione singola Individually wrapped 	500 pcs	29,3 x 17,5 x 24 cm 0,012 m ³	0,7
4202/E		Giallo Yellow	Rack da 96 pz Rack of 96 pcs 	960 pcs (10 x 96 pcs)	50,5 x 14,5 x 13 cm 0,010 m ³	1,9
4202/E/SG	✓	Giallo Yellow	Rack da 96 pz Rack of 96 pcs 	960 pcs (10 x 96 pcs)	50,5 x 14,5 x 13 cm 0,010 m ³	1,9
1602		Giallo Yellow	Piastrine refill 96 pz Trays refill of 96 pcs 	480 pcs (5 x 96 pcs)	45,5 x 13 x 9 cm 0,005 m ³	0,6

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è "Per usi generici di laboratorio", dispositivi di preanalitica utilizzati per la preparazione di campioni biologici umani da testare in vitro per esami diagnostici. Unicamente per uso professionale.

Dispositivi fabbricati con Sistema Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485.

The intended purpose is "For generic laboratory uses", pre-analytical devices used for the preparation of human biological samples to be tested in vitro for diagnostic examinations. Only for professional use.

Devices manufactured with Quality System compliant with the UNI EN ISO 9001 and UNI CEI EN ISO 13485 standards.

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS (UNI EN CEI ISO 15223-1)



Data di produzione
Date of manufacture



Data di scadenza
Use-by date



Lotto
Batch code



Codice articolo
Catalogue number



Fabbricante
Manufacturer



Monouso
Do not re-use



Utilizzare a confezione integra
Do not use if package is damaged



Proteggere dall'umidità
Keep dry



Non esporre ai raggi del sole
Keep away from sunlight



Non sterile
Non-sterile



Sterile irradiato
Sterilized using irradiation



Apirogeno
Non-pyrogenic



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Destinato esclusivamente ad uso professionale -

- For professional use only -

L'eventuale presenza di scala graduata è da intendersi a scopo indicativo e senza funzione metrologica

Non variare la destinazione d'uso. In caso di dubbio circa la destinazione d'uso, Vi preghiamo di contattare il Fabbrikante.

Prima dell'utilizzo controllare la perfetta chiusura del dispositivo se applicabile

Manipolare utilizzando dispositivi di protezione individuale: pericolo di contaminazione

Non utilizzare il Dispositivo in caso di evidenti segni di rottura, lesioni, fessurazioni che potrebbero comprometterne il corretto uso

Non avvicinare il Dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare

Non utilizzare e smaltire il Dispositivo scaduto o con la confezione non integra

Non riutilizzare: Dispositivo monouso. L'eventuale riutilizzo potrebbe causare la contaminazione del campione.

Nel caso di dispositivo sterile o asettico: stato microbiologico garantito a confezione integra. Non ri-sterilizzare

Utilizzare il Dispositivo unicamente con accessori compatibili e/o in dotazione (tappi, supporti, ecc.)

Non esporre direttamente ai raggi solari; proteggere dall'umidità (U.R. max 75% a 26°C)

Conservare in luogo asciutto, temperatura min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Smaltire secondo le normative vigenti, pericolo di infezione.

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Any presence of a graduated scale is intended for indicative purposes and without a metrological function.

Do not vary the intended purpose of the device. Please contact the Manufacturer in the evenience of doubts concerning the intended purpose.

Before use check the perfect closure of the device if applicable.

Handle using personal protective equipment: risk of contamination. Do not use the Device in case of evident signs of breakage, injuries, cracks that could compromise its correct use.

Keep out of flame or heat sources which might damage the device.

Do not use after expiry date or if packing is opened.

Do not re-use: Disposable Device. Any reuse could cause sample contamination.

If sterile or aseptic Device: Microbiological status in undamaged pack.

Do not re-sterilize.

Use the Device only with compatible and / or supplied accessories (caps, supports, etc.)

Do not put under direct sun rays; store in a dry, cool place (U.R. max 75% at 26°C)

Store in dry place, temperature range: min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Disposal according to applicable regulations, risk of infection.

Before use with particular substances check the resistance/compatibility chart in our catalogue.

Tutti gli strumenti e i nomi dei produttori citati nella presente scheda tecnica sono marchi dei rispettivi proprietari e sono utilizzati all'unico fine di riferimento.

All instruments and names of Manufacturers mentioned herein are the trademarks of their respective Companies and are used for reference purposes only.

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001 & UNI CEI EN ISO 13485

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
05.10.2019



CODICE ARTICOLO: **4001/E/SG**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Technical view



PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO EPPENDORF® DA 50 - 1.000µL
Realizzati in polipropilene medicale (PP) di colore blu ad elevata purezza ed esente da Cadmio ed altri metalli pesanti. Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento. Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili fino a +121°C. Sterili confezionati in rack autoclavabili con coperchio da 96 pezzi, singolarmente sigillati con film trasparente per garantire la sterilità. Dispositivo Latex free

TIPS FOR MICROPIPETTES EPPENDORF® TYPE 50 - 1,000 µL
Made of medical polypropylene (PP), blue colour, of high purity, cadmium and heavy metal free. Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process. Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable up to +121°C. Sterile supplied in autoclavable rack with lid of 96 pieces, individually sealed by transparent film to grant its sterility. Latex-free device

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +121°C	Temperature range
Volume	50 – 1.000 µl	Volume
Colore	BLU / BLUE	Colour
Modello	EPPENDORF®	Type
Compatibilità	Gilson® Pipetman P1000 - Biohit® Proline - Brand® Transferpette - Socorex® Calibra - HTL® Discovery DV1000 - Nichiryo® - Thermo Scientific™ Finnpiquette™	Compatibility
Lunghezza totale (mm)	69,80	Total lenght (mm)
Peso (gr.)	0,68	Weight (gr.)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy
Tel. (+39 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92
E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.apraca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" atto a prelevare un campione biologico umano (per esempio urina, sperma, sangue, saliva, espettorato, pus, etc) e dispensarlo su terreni di crescita, vetrini, provette/contenitori al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503020202 (Puntali per pipette senza filtro)

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1239158/R

Classificazione EDMA: 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software

*The intended purpose is "IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE" able to collection a human biological sample (eg, urine, semen, blood, saliva, sputum, pus, etc) and dispense on growth medium, slides, tubes / containers in order to carry out analysis of laboratory diagnosis. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W0503020202 (Pipettes, tips without filter)

EDMA: 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): Quantity (pcs):	960	Confezione interna (pz): Internal packing (pcs):	96 (in PP rack)	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE MINIMUM SALEABLE QUANTITY
Misura esterna scatola (cm): External box dimensions (cm):	50,5 x 14,5 x 13	Peso (Kg): Weight (Kg):	2,450	Volume (m ³): Volume (m ³):
				0,010

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
24.04.2024



ARTICOLO: **5 ML CYLINDRICAL TEST TUBE IN PS**
ITEM: **PROVETTA CILINDRICA 5 ML IN PS**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



**PROVETTA CILINDRICA DA 5ML, NON GRADUATA,
SENZA BORDO, Ø 13 X 75 MM**

Prodotta in Polistirolo cristallo (PS) perfettamente
trasparente.
Dispositivo latex free

**5ML CYLINDRICAL TEST TUBE, NOT GRADUATED,
WITHOUT RIM, Ø 13 X 75 MM**

Manufactured in crystal polystyrene (PS) perfectly
transparent
Latex free device

Prodotto con marchio CE conforme al Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR)

CE Marked product - manufactured in compliance with Regulation (EU) 2017/746 (IVDR)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	<i>Raw material – Test tube</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	<i>Temperature range - test tube</i>
Volume (ml)	5,0	<i>Volume (ml)</i>
Dimensioni (mm)	Ø 13 x 75	<i>Dimensions - test tube (mm)</i>
Spessore (mm)	1,0	<i>Thickness (mm)</i>
Peso (gr)	2,75	<i>Weight - test tube (g)</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 3 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

						Scatola / Box		
REF.	Tappo Cap	Etichetta Label	UDI-DI	R.D.M.	Confezione interna Internal packing	Quantità Quantity	Dimensioni Dimensions	Peso (Kg.)
1375			8055776090269	2330453/R	Sacchetti da 1.000 pcs Bags of 1,000 pcs	4.000 pcs	55,5 x 42,5 x 34 cm 0,087 m ³	11,8
1375/E		✓	8055776092133	2330630/R	Sacchetti da 1.000 pcs Bags of 1,000 pcs	4.000 pcs	55,5 x 42,5 x 34 cm 0,087 m ³	11,9
1375/T	✓ Azzurro Light blue		8055776092188	2330634/R	Sacchetti da 1.000 pcs Bags of 1,000 pcs	4.000 pcs	55,5 x 42,5 x 34 cm 0,087 m ³	14,2
1375/T/E	✓ Azzurro Light blue	✓	8055776092195	2330635/R	Sacchetti da 1.000 pcs Bags of 1,000 pcs	4.000 pcs	55,5 x 42,5 x 34 cm 0,087 m ³	14,3

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro "contenitore di campione" atto a contenere un campione biologico umano (sangue, urine, feci, pus, espettorato, saliva, sperma, cellule, unghie, capelli) al fine di effettuare esami diagnostici di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) / European Medical Device Nomenclature (EMDN) > W050301020102 (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi).

Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin

Basic UDI-DI (Global Model Number – GMN): 805577609F102TESTUBES01QU

In Vitro Diagnostic Medical Device "specimen receptacles" adapted to contain a human biological sample (blood, urine, faeces, pus, sputum, saliva, semen, cells, nails, hair) to perform in vitro diagnostic analysis laboratory. For professional use only.

National classification of medical devices (CND) / European Medical Device Nomenclature (EMDN) > W050301020102 (Samples analyses, plastic tubes without additives).

EDMA code > 51091001 - Other containers for samples of human origin

Basic UDI-DI (Global Model Number – GMN): 805577609F102TESTUBES01QU

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Destinato esclusivamente ad uso professionale -

Utilizzare esclusivamente per effettuare analisi diagnostiche di laboratorio su campioni biologici umani in contesti sanitari.

Dispositivo senza funzione di misura.

L'eventuale presenza di scala graduata è da intendersi a scopo indicativo e senza funzione metrologica

Non variare la destinazione d'uso. In caso di dubbio circa la destinazione d'uso, Vi preghiamo di contattare il Fabbrikante.

Prima dell'utilizzo controllare la perfetta chiusura del dispositivo se applicabile

Manipolare utilizzando dispositivi di protezione individuale: pericolo di contaminazione

Dopo il prelievo conservare il campione come prescritto dalla metodica analitica e consegnare al Laboratorio entro il tempo massimo previsto dalla stessa.

Non utilizzare il Dispositivo in caso di evidenti segni di rottura, lesioni, fessurazioni che potrebbero comprometterne il corretto uso

Non avvicinare il Dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare

Non utilizzare e smaltire il Dispositivo scaduto o con la confezione non integra

Non riutilizzare: Dispositivo monouso. L'eventuale riutilizzo potrebbe causare la contaminazione del campione.

Nel caso di dispositivo sterile (radiazioni ionizzanti) o asettico: stato microbiologico garantito a confezione integra. Non ri-sterilizzare

Utilizzare il Dispositivo unicamente con accessori compatibili e/o in dotazione (tappi, supporti, ecc.)

Non esporre direttamente ai raggi solari; proteggere dall'umidità (U.R. max 75% a 26°C)

Conservare in luogo asciutto, temperatura min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Smaltire secondo le normative vigenti, pericolo di infezione.

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Provette: velocità di rotazione in centrifuga (max 20 minuti, temperatura ambiente): PMMA r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) – PS r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) – PP r.p.m 5.000 (R.C.F. min 4.000 x g)– TPX r.p.m 4.500 (R.C.F. min 3.200 x g).

- For professional use only -

Use only for laboratory diagnostic analysis of human biological samples in healthcare settings.

Device without measuring function.

Any presence of a graduated scale is intended for indicative purposes and without a metrological function.

Do not vary the intended purpose of the device. Please contact the Manufacturer in the evenience of doubts concerning the intended purpose.

Before use check the perfect closure of the device if applicable.

Handle using personal protective equipment: risk of contamination.

After collection, store the sample as prescribed by the analytical method and deliver to the Laboratory within the maximum time specified by the same.

Do not use the Device in case of evident signs of breakage, injuries, cracks that could compromise its correct use.

Keep out of flame or heat sources which might damage the device.

Do not use after expiry date or if packing is opened.

Do not re-use: Disposable Device. Any reuse could cause sample contamination.

If sterile (ionizing radiations) or aseptic Device: Microbiological status in undamaged pack.

Do not re-sterilize.

Use the Device only with compatible and / or supplied accessories (caps, supports, etc.)

Do not put under direct sun rays; store in a dry, cool place (U.R. max 75% at 26°C)

Store in dry place, temperature range: min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Disposal according to applicable regulations, risk of infection.

Before use with particular substances check the resistance/compatibility chart in our catalogue.

Test tubes: centrifuge rotation speed (max 20 minutes, room temperature):

PMMA r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) – PS r.p.m 3.000 (R.C.F. min 1.500 x g) – PP r.p.m 5.000 (R.C.F. min 4.000 x g)– TPX r.p.m 4.500 (R.C.F. min 3.200 x g).



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 3 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS (UNI EN CEI ISO 15223-1)

	Marchio CE <i>CE Mark</i>		Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro <i>In Vitro diagnostic medical device</i>		Consultare le istruzioni per l'uso <i>Consult instructions for use</i>
	Data di produzione <i>Date of manufacture</i>		Data di scadenza <i>Use-by date</i>		Lotto <i>Batch code</i>
	Codice articolo <i>Catalogue number</i>		Fabbricante <i>Manufacturer</i>		Monouso <i>Do not re-use</i>
	Non sterile <i>Non-sterile</i>		Proteggere dall'umidità <i>Keep dry</i>		Non esporre ai raggi del sole <i>Keep away from sunlight</i>