

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: „09” martie 2021

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1615282470321](#)

Anunț de participare Nr.: 21037001

Către: IMSP SCM Sf.Treime

declară că: «TRIUMF-MOTIV» SRL

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____

b) «TRIUMF-MOTIV» SRL se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii

Lămpi bactericide a.2021

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

41 600,00 (patruzeci și unu mii șase sute,00) Lei

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

49 920,00 (patruzeci și nouă mii nouă sute douăzeci,00) Lei

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, «TRIUMF-MOTIV» SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:_____

Nume: Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: *SRL Triumf-Motiv*

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301

Data: „04” aprilie 2021



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1615282470321				Data: „04” aprilie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Lămpi bactericide a.2021 IMSP SCM Sf.Treime				Lot: 9		Pagina: _1_ din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	9	Lampa mobilă	HF-YZW60SWI	China	Huiefeng	Lampa mobilă, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete. Suportul dotat cu min.3 roți. Cu min. 2 roți cu frână. Mîner pentru transportare - da. Numar de tuburi - 3 tuburi $\geq 30W$ fiecare tub, $\geq 30 m^2$. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Unda spectrală, nm 254, ± 1 . Destinat utilizarii in spitale. Unghiul de iradiere 360 grade. Alimentare 220V, 50Hz.	Lampa mobilă, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete. Suportul dotat cu 4 roți. Cu min. 2 roți cu frână. Mîner pentru transportare - da. Numar de tuburi - 2 tuburi $\geq 30W$ fiecare tub, $\geq 30 m^2$. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Unda spectrală, nm 254, ± 1 . Destinat utilizarii in spitale. Unghiul de iradiere 360 grade. Alimentare 220V, 50Hz. Cu telecomandă. Utilizează bec Philips.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301



Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1615282470321						Data: „04” aprilie 2021		Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației: Lămpi bactericide a.2021 IMSP SCM Sf.Treime						Lot: 9		Pagina: _1_ din _1_	
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33140000-3	9	Lampa mobilă	buc	8	5200,00	6240,00	41600,00	49920,00	în decurs de 5 zile de la comană
Total							41600,00	49920,00	

Semnat: _____
 Numele, Prenumele Jighili Tatiana
 În calitate de: administrator
 Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301



**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1615282470321
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP SCM Sf.Treime
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600152592

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	«TRIUMF-MOTIV» SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	2043
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	str. Grenoble 193 of. 1301
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Jighili Tatiana
2A.7.1	Telefon	+373 22 768841
2A.7.2	Adresa de e-mail	triumf.motiv@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1012600021180
2A.9	Numărul cod TVA	0308703

2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societatea cu raspundere limitata
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Jighili Tatiana
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Jighili Tatiana Jighili Tatiana
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MDA MDA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	0%
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Nu
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Jighili Tatiana
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 22 768841
2B.5	Adresa de e-mail	triumf.motiv@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea		

<i>(capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care	Nu

	continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	-
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Da
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	-
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	-
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	-
		-
		-
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	-
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente</i>	-

	<i>pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente</i>	-

	<i>pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interes	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interes care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	• Licența de activitate • Autorizația • Certificat de înregistrare
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	-
		-
		-
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	-
		-
		-
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse	Da

	de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	-
		-
		-
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	Nu se aplică
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	-
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	-
		-
	Cifra de afaceri medie anuală	Nu se aplică
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	-
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	-
		-
		-
		-
		-
		-
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	-
		-
		-
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	-
		-
		-
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	

4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	-
		-
		-
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	Nu se aplică
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul text Angajați [număr] Anul text Angajați [număr] Anul text Angajați [număr]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	Nu se aplică
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	Nu se aplică
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1		text

	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen ____ zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	Da

5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [IMSP SCM Sf.Treime], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1615282470321.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Jighili Tatiana

Funcția: Administrator

Data: 04.04.2021

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 193 or. 1301

Semnătura



ORDIN DE PLATĂ		Nr.	519	DATA EMITERII	2 Aprilie 2021	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	416-00	LEI	Patru sute saizepreze lei, 00 bani			
PLĂTITOR:			CODUL IBAN		MD90EN000000222446621858	
(R)SRL TRIUMF-MOTIV			CODUL FISCAL		1012600021180	
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'ENERGBANK'SA				
BENEFICIAR:			CODUL IBAN		MD22ML000000000225166614	
(R) IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME			CODUL FISCAL		1003600152592	
PRESTATORUL BENEFICIAR:		BC MOLDINDCONBANK SA Chisinau				
DESTINAȚIA PLĂȚII:					TIPUL TRANSFERULUI	
GARANTIA 1 PROCENT LP 21037001 DIN 9 MARTIE 2020 NR. FARA NUMAR DIN 09-03-2020 OFERTA Fara TVA					NORMAL/URGENT N	
					Semnatura electronica MOLDSIGN Tatiana (R)Jighili 02-04-2021 15:15:36	
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	L.Ș.			
	ORA PRIMIRII *		SEMNĂTURILE EMITENTULUI			
			SEMNĂTURA PRESTATORULUI			
			L.Ș.			
MOTIVUL REFUZULUI						

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *



«TRIUMF-MOTIV» SRL
C/F 1012600021180
or. Chisinau, str. Grenoble 193 of. 1301,
tel.: 022-76-88-41, 022-76-84-62

DECLARAȚIE

Data: 09.03.2020

Numărul [ocds-b3wdp1-MD-1615282470321](#)

Lămpi bactericide a.2021

IMSP SCM Sf.Treime

Subsemnatul, Jighili Tatiana reprezentant împuternicit al SRL *Triumf-Motiv* în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere:

- a) nu avem Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale;
- b) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
- c) Nu avem motive de faliment sau insolvență, conflicte de interes personal sau abateri profesionale.

Data completării: 04/04/2020

Operator economic,

SRL *Triumf-Motiv*



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2104831

din
от 29.03.2021

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
TRIUMF-MOTIV S.R.L.	1012600021180
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Traian bd. nr.18 bl.1 of.80	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 13.04.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura / Подпись

ANA STOICOV
Numele și prenumele / Фамилия и имя



Nr. 858 / 31
din « 25 » februarie 2021

Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

SRL TRIUMF-MOTIV
Mun. Chisinau,
bd.Traian,18/1,ap.80

Prin prezenta, B.C.”Energbank” S.A., sucursala Botanica (codul bancii ENEGMD22858), confirma ca SRL TRIUMF-MOTIV, cod fiscal 1012600021180 detine codului IBAN nr. MD90EN000000222446621858 in Lei MD, Dolari SUA, Euro,Rubla Rusa.

Directorul Sucursala



/Contabil-sef

Abramihin A.

Dubolari I.

Exc.Haricev A.
Tel.022-56-83-39

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Jighili Tatiana reprezentant împuternicit al SRL “TRIUMF-MOTIV” în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1615282470321](#) din data 09/03/2021, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Jighili Tatiana	2001004230536

Data completării: 04.04.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Jighili Tatiana

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic SRL “TRIUMF-MOTIV”

IDNO al operatorului economic: 1012600021180





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 25508 din 15.04.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «TRIUMF-MOTIV».**

Denumirea prescurtată: **«TRIUMF-MOTIV» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1012600021180.**

Data înregistrării de stat: **03.07.2012.**

Sediul: **MD-2043, bd. Traian, 18/1, ap.(of.) 80, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Publicitate;2 Alte tipuri de comerț cu ridicata;3 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;4 Comerțul cu amănuntul al cărților, ziarelor și rechizitelor de birou;5 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);6 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;7 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;8 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;9 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;10 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;11 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;12 Comerț cu ridicata nespecializat;13 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;14 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;15 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;16 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;17 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;18 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: JIGHILI TATIANA, IDNP 2001004230536,

Asociați:

1. JIGHILI TATIANA, IDNP 2001004230536, cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.04.2020.

Specialist superior
tel. 022-207-839



Racu Aurelia

Digitally signed by Jighili Tatiana
Date: 2020.04.16 15:24:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





«TRIUMF-MOTIV» SRL
C/F 1012600021180
or. Chisinau, str. Grenoble 193 of. 1301,
tel.: 022-76-88-41, 022-76-84-62

DECLARAȚIA

Obligația de a oferi mostre de produse la solicitarea

În termen de 10 zile la solicitare autorității contractante se vor prezenta mostre pentru evaluare, testare și confirmarea specificațiilor tehnice propuse de la operatorul economic desemnat cîstigător.

Administrator
Jighili Tatiana
04/04/2021





广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

REPORT FOR ANALYSIS

Report №.

2020SP11055R01E

Name of Sample

UV Sterilizer

Applicant

Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., LTD.

Test Type

Entrustment Test



Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

Postcode: 510070

Tel: +86 20 87137666

Fax : +86 20 87137668

Website : www.gddcm.com



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

REPORT FOR ANALYSIS



Report No.: 2020SP11055R01E Verification Code: 90174586

Name of Sample	UV Sterilizer	Test Type	Entrustment Test
Applicant	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., LTD.	Address	Building No.2, No.885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, Shanghai, China
Sample Source	Submitted for Testing by the Applicant	Sample Quantity	One
Spec and Lot No of Sample	HF20200901 II 6	State and Characteristic	Machine
Sample Received Date	2020-10-12	Test Completion Date	2020-10-22
Test Standard and Method	Technical Standard for Disinfection (Ministry of Health, Edition 2002), section 2-2.1.5.4.3, etc.		
Item Tested	Ultraviolet radiation intensity, etc.		
Test Conclusion	The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report. Issue Date: 2020-10-23 (Official Seal)		
Remarks	Manufacturer: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., LTD. (Provided by the applicant) 检验检测专用章		

Editor: Chen Jingxun

Verifier: Liang Daping

Approver: Guo Weipeng



GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY


ANALYSIS AND TEST RESULT

Report No.: 2020SP11055R01E

(1) Ultraviolet radiation intensity

1. Test Method: Technical Standard for Disinfection (Ministry of Health, Edition 2002), section 2-2.1.5.4.3
2. Methods: Turn on the No. I lamp and No. II lamp of the sample, place the illuminance meter probe at the center of the two lamps of the sample to be tested at a vertical distance of 1m, and measure the irradiance at 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, and 120 min.
3. Test results:

Test distance	Opening time	Radiation intensity ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
1m	10min	213
	15min	215
	30min	221
	60min	223
	120min	225

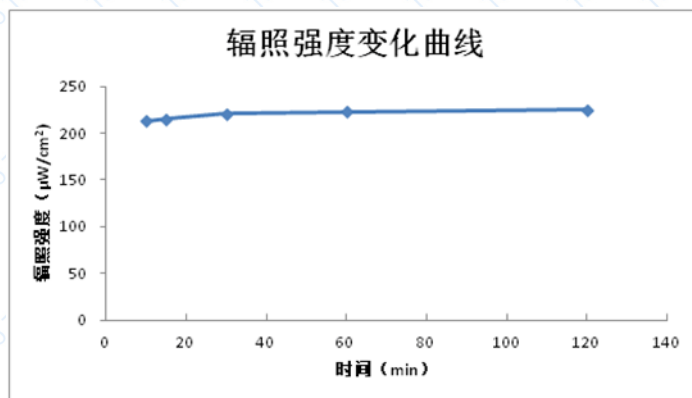

(to continue)



GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

ANALYSIS AND TEST RESULT

Report No.: 2020SP11055R01E

(2) Ozone concentration

1. Test Method: GB/T 18202-2000 Appendix A
2. Methods briefly: After turning on the sample for inspection for 5 minutes, put the absorption tube of the ozone analyzer at a distance of 5 cm from the center of the two lamps of the sample to measure the air ozone concentration.
3. Test result:

Ozone concentration (mg/m ³)	Test Method
0.09	GB/T 18202-2000 Appendix A

(3) Disinfection efficiency for air(field test)

1. Test Method: Technical Standard for Disinfection (Ministry of Health, Edition 2002), section 2-2.1.3
2. Action time: 1h (Turn on UV)
3. Test organisms : Natural bacteria in the air
4. Test result:

Test groups	Amount of Airborne Germs (cfu/m ³)		Extinction Rate (%)	Standard Request	Individual judgment
	After Sterilization	Before Sterilization			
1	1.1×10^3	85	92.27	The extinction rate is $\geq 90\%$	Qualified
2	1.1×10^3	78	92.91		
3	1.1×10^3	78	92.91		

Environment relatively humidit: 62%

Environment temperature: 24℃

(to continue)



GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

ANALYSIS AND TEST RESULT

Report No.: 2020SP11055R01E

(4) Disinfection efficiency for air (Simulated field test)

1. Test Method: Technical Standard for Disinfection (Ministry of Health, Edition 2002), section 2-2.1.3.4
2. Action time: 45min (Turn on UV)
3. Test organisms : *Staphylococcus albus*
4. Test result:

Test organisms	Action time	No.	Bacteria in the air (cfu/m ³)	Sterilization rate (%)	Standard Request	Individual judgment
<i>Staphylococcus albus</i> 8032	0h	1	8.5×10^4		The killing rate is $\geq 99.90\%$	Qualified
		2	8.9×10^4			
		3	8.3×10^4			
	45min	1	35	99.95		
		2	42	99.94		
		3	28	99.96		

Environment relatively humidit: 62%

Environment temperature: 24°C

Note: The result of bactericidal rate test has eliminated the effect of microbial natural decay in air.

(Blank Below)



Report №.: 2020SP11055R01E

Notice Items

1. The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.
2. The Test report is invalid without signature of verifier and approver.
3. The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.
5. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.
6. Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.

UV Sterilizer

(HF-YZW60SWI, HF-YZW60SWII,
HF-YZW220SWI, HF-YZW220SWII)

User Manual

Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd.

Office Address: Building 2#, NO.885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, Shanghai,
China .

Factory Address: Building 2#, NO.885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, Shanghai,
China .

Tel : +86 21-58084992 Fax : +86 21—58085105

Postal Code: 201306

Date of Issue : 16th May, 2020

Content

Content.....	1
1. Introduction.....	3
2. Product Introduction.....	3
2.1 Product description.....	3
2.2 Product features.....	4
2.3 Working environment.....	4
2.4 Product Scope.....	4
3. Composition Instructions	4
3.1 Product composition structure diagram.....	4
3.2 Product specifications.....	5
3.3 Product configuration list.....	6
4. Use Instructions.....	6
4.1 Precautions before use.....	6
4.2 Precautions during use.....	7
4.3 Precautions after use.....	8
4.4 Operating instructions.....	8
4.5 Circuit diagram.....	10
5. Maintenance and Repair Instructions.....	10
5.1 Daily maintenance.....	10
5.2 Lamp tube replacement.....	11
5.3 Fuse replacement.....	12
5.4 Handling of common faults.....	12
5.5 Waste treatment.....	12
5.6 circumstances fall within the scope of immunity.....	13
6. Packaging, Transportation and Storage.....	13
6.1Packaging.....	13
6.2Transportation and Storage.....	13
7. After-sales service.....	13

1. Introduction

In order to better use and maintain this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

The instruction manual includes warnings, precautions and usage items. All technical personnel engaged in the use and maintenance of this product should be familiar with the contents of the instruction manual. Do not use or maintain this product without being familiar with the contents of the instruction manual.

Please read the following precautions carefully to avoid personal injury and prevent damage to the product and possible dangers.

2. Product Introduction

2.1 Product description

- The sterilization principle of the ultraviolet sterilizer is to use ultraviolet light with a wavelength of 253.7nm in a mercury lamp to destroy the molecular structure of DNA (deoxyribonucleic acid) or RNA (ribonucleic acid) in the cells of microorganisms (bacteria, viruses, spores and other pathogens), and it causes growth cell death and/or regenerative cell death to achieve the effect of sterilization and disinfection.
- The irradiation intensity of the ultraviolet lamp tube is inversely proportional to the distance of the object to be sterilized. When the irradiation intensity is constant, the longer the residence time of the sterilized object is, the closer it is to the sterilization lamp, the better its sterilization effect is. Otherwise the worse it is.
- Ultraviolet sterilizer will not produce ozone during the sterilization process. The lamp glass filters out the ozone formation line at 185 nm. After completion, it will not cause secondary pollution, no toxic substances remain, no corrosiveness to the environment and objects, and can be effectively used. Cross-infection at the site.
- Types of killing microorganisms: killing various microorganisms
- The main bactericidal factor and its intensity: ultraviolet radiation with a radiation wavelength of 253.7nm is the bactericidal factor. The irradiation intensity of the new lamp tube should not be less than 90w/cm², and the irradiation intensity of ultraviolet light in use should not be less than 70w/cm².
- The maximum disinfection volume of this product is 50m³.

2.2 Product features

- The product adopts double-tube or four-tube, double-ended lamp, and the angle of the lamp arm can be adjusted.
- The product type is hand-push mobile, easy to use and easy to move.
- Use the panel timer to adjust the disinfection time arbitrarily within 10-240 minutes.
- Use the remote control to operate the timer in the range of 30-180 minutes. 6 levels increase or decrease every 30 minutes.
- The protective coating inside the tube can ensure a constant UV output throughout the life of the lamp.
- The remote control can be operated by partition walls, and the effective distance can reach 15 meters.
- Human sensor: It can sense people within 5-8 meters of the sterilizer and stop the sterilization by itself.

2.3 Working environment


- Temperature: 20°C~40°C
- Relative temperature: ≤80%
- Atmospheric pressure range: 860hPa~1060hPa
- Power voltage: 220V±10%
- Frequency: 50Hz-60Hz
- Places without corrosive gas, flammable and explosive gas

2.4 Product Scope

The ultraviolet sterilizer is suitable for the disinfection of indoor air and object surfaces under unmanned conditions in medical institutions, public places that need to be sterilized, and family rooms.

3. Composition Instructions

3.1 Product composition structure diagram

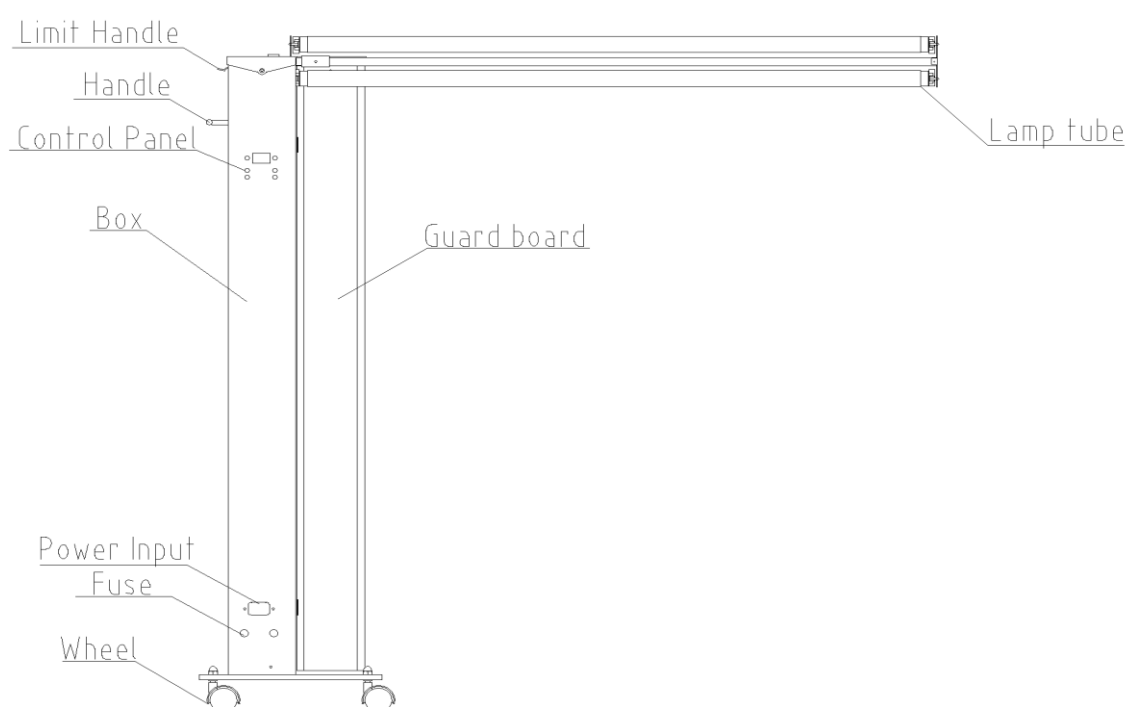

3.2 Product specifications

Model	HF-YZW60SWI	HF-YZW60SWII	HF-YZW220SWI	HF-YZW220SWII
Parameter				
Irradiance of each lamp(w/cm2)	≥112	≥112	≥165	≥165
Power Supply(V)	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%
Input Power(W)	70	70	240	240
Lamp tube Qty.(PC)	2	2	4	4
Lamp power (W/PC)	30	30	55	55
Fuse specifications	1.0A	1.0A	1.0A	1.0A
Timing range (minutes)	10-240	10-240	10-240	10-240
Angle range of lamp arm (degree)	145	145	145	145
Lamp model specifications	G13 TUV 30W	G13 TUV 30W	2911TUVPL-L55W HF	2911TUVPL-L55WH F

Lamp life (H)	8000	8000	8000	8000
UV wavelength (nm)	253.7	253.7	253.7	253.7
Equipment safety classification	Class I; Continuous operation equipment	Class I; Continuous operation equipment	Class I; Continuous operation equipment	Class I; Continuous operation equipment
Service life of ultraviolet sterilizer	The time when the intensity of the new lamp is reduced to $70\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (power $\geq 30\text{W}$), not less than 1000h. ●Using the ultraviolet intensity indicator card to monitor the irradiation intensity of the ultraviolet lamp; ●Testing method: During the measurement, turn on the UV lamp tube for 5min. After it is stable, place the indicator card at the center vertically 1m below the UV lamp tube, and compare the color of the indicator card to detect the UV lamp tube Whether the irradiation intensity meets the requirements for use.			

3.3 Product configuration list

No.	Name	Qty.
1	UV lamp	1
2	Fuse	2
3	User Manual	1
4	certificate of inspection	1

4. Use Instructions

4.1 Precautions before use

4.1.1 Set the timing switch before use, then turn on the I or II switch, and the lamp will light up after a delay of 10 seconds.

4.1.2 When disinfecting the ambient air, this product should be used in an indoor environment that avoids sunlight, is clean and dry, reduces dust and water mist, and closes doors and windows at the same time to avoid ventilation with outdoor air. The suitable temperature for ultraviolet disinfection is $20^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$, the relative humidity is less than 80% to ensure the disinfection effect; too high or too low temperature will affect the disinfection effect, you can properly extend the disinfection time. When the relative humidity is greater than 80%, the irradiation time should be properly extended.

4.1.3 The sterilized places should be marked in advance to avoid entry of personnel.

4.1.4 Before using for the first time, please check whether the voltage you use is consistent with the product nameplate requirements. First check whether the power cord and plug are damaged. Do not

bend or pull the power cord to avoid poor contact. Make sure that all wires are correctly and firmly connected, and that power-on testing should be performed to check for electrical leakage. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, you must contact the manufacturer or its maintenance department or similar professional personnel to replace it.

4.1.5 Before each use, you must check whether the product is working properly, and check whether the ultraviolet lamp tube is damaged before use.

Operate strictly in accordance with the product manual, and carry out regular maintenance and maintenance. Handle with care when moving, do not violently shake, and pay attention to keeping the product clean and dry. If there is any abnormality, please ask the qualified maintenance personnel to carry out the inspection and repair. Everything is normal before use. Contact the manufacturer if necessary.



Warning:

Explosion hazard: Do not use this product in the presence of a mixture of flammable and explosive anesthetic gas and air or a mixture of nitrous oxide.

4.2 Precautions during use

4.2.1 It is strictly forbidden to cover items (such as clothing, paper, etc.) on the casing during normal operation with power on, which will seriously affect the heat dissipation performance and make the temperature inside the machine too high, which may cause an accident of fire or burning of internal parts. It is strictly prohibited to use this product with other devices with automatic power supply.

4.2.2 It is strictly forbidden to remove the lamp tube by hand during product work to avoid burns.

4.2.3 When disinfecting the surface of objects, the surface of disinfected objects should be fully exposed to ultraviolet rays.

4.2.4 When disinfecting rough surfaces such as papers and fabrics, the irradiation time should be properly extended, and both sides should be exposed.



Warning:

Personal injury:

This product can kill bacteria and disinfect. It is forbidden to directly irradiate people with ultraviolet light sources. The irradiation will damage the human eye mucosa and skin. During use, it must be used in a closed environment where no one is indoors and protected from radiation. If you must be exposed to radiation for a short period of time, you must wear protective glasses (or protective masks) and protective clothing to protect against burns.

4.3 Precautions after use

4.3.1 After disinfection, you must first turn off the power switch of this product, and then pull out the power plug. It is strictly forbidden to pull the plug with wet hands, and do not pull the power cord, otherwise it will cause the danger of short circuit, fire and electric shock.


4.3.2 After use, hold the lamp arm by hand and put the lamp tube directly into the lamp box to avoid damage to the device and the lamp tube. When not in use, it should be stored in a ventilated and dry, non-corrosive gas, no flammable and explosive room, and a protective cover must be added to avoid contamination of the product surface and paint drop.

Warning:


Risk of electric shock: After using this product, when leaving, or if it is not used for a long time, be sure to cut off the power of the product and unplug the power plug to avoid the risk of electric shock.

4.4 Operating instructions

4.4.1 Operation interface description

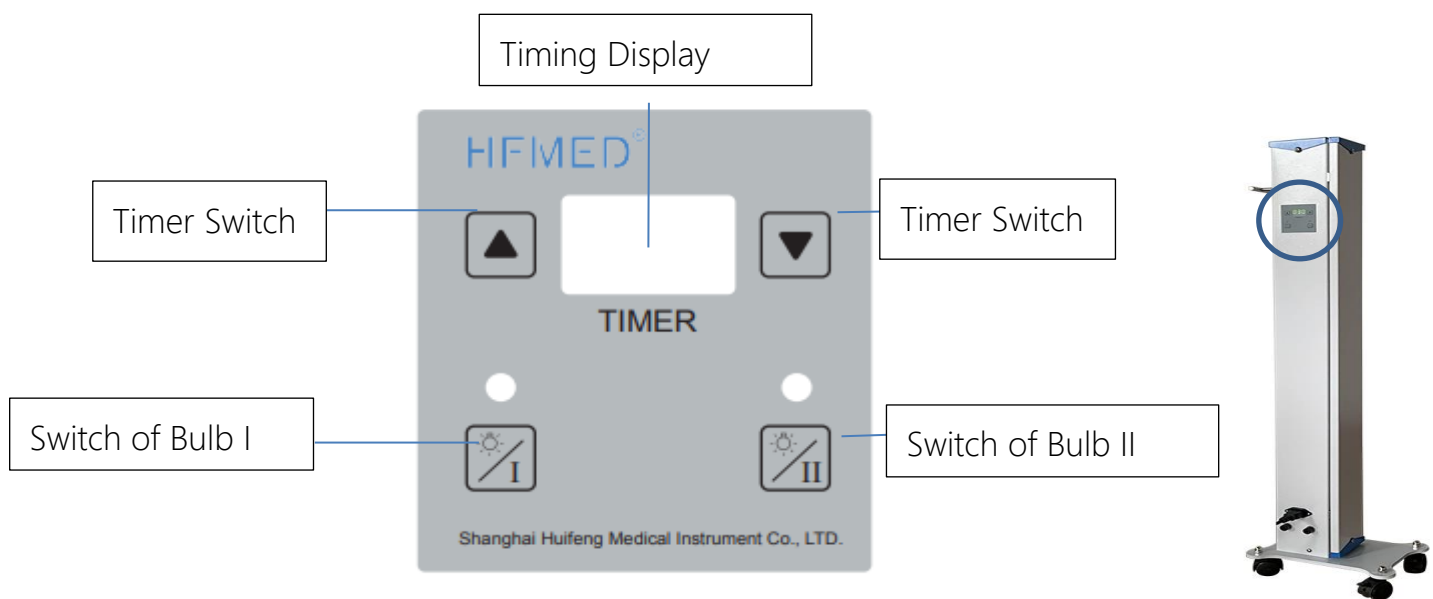

Control Panel Position

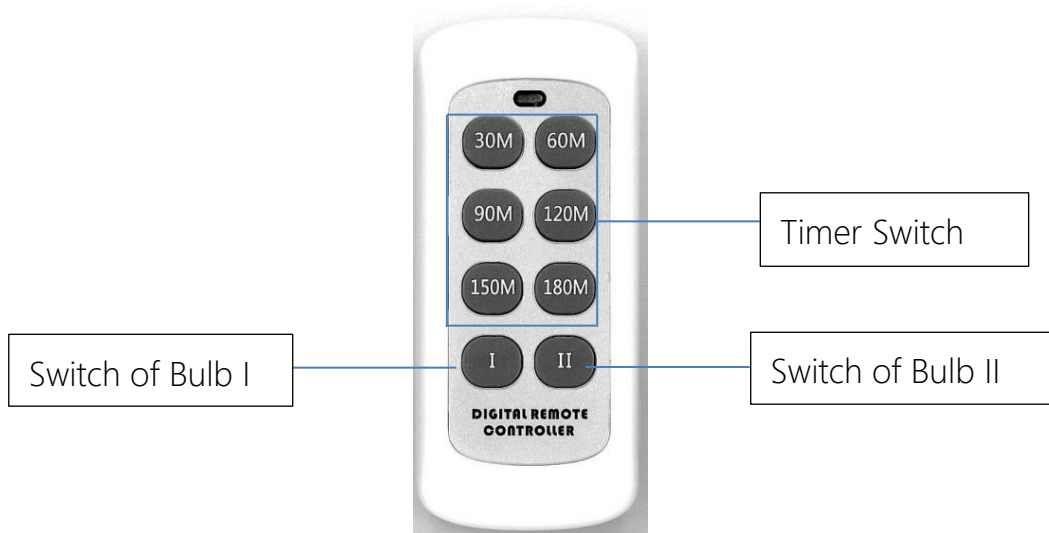

4.4.2 Operation process

4.4.2.1 The ultraviolet sterilizer is placed in the room that needs to be sterilized, the caster brake is opened, and the doors and windows of the room are closed.

4.4.2.2 Open the protective plate of the ultraviolet sterilizer, gently hold the white lamp holder under the lamp, slowly lift the lamp to make the lamp in the proper position, if you adjust the angle of the lamp, hold the lamp first Lift up the limit handle for the white lamp holder below, and then adjust the lamp up and down to the required position.

Note: When raising the limit handle, the lamp tube needs to be held and cannot be loosened to prevent the lamp tube from falling and damage



Hold the white lamp holder

4.4.2.3 Connect the power supply, the timer display lights up, press the timer adjustment button on the control panel or the timer adjustment button on the remote control to set the disinfection time

4.4.2.4 According to the actual needs of the disinfection site, select the lamp switch by pressing the I button or the II button, and wait for 10 seconds before the lamp is on.



Note: During the disinfection period, people are not allowed to stay or enter.

4.4.2.5 After the set disinfection time is over, the lamp is automatically extinguished, disconnect the power supply, and let the lamp cool for 10 minutes.

4.4.2.6 Gently hold the white lamp holder under the lamp, raise the limit handle at the rear of the box,

gently lower the lamp into the box, close the guard plate, and release the caster brake.



Raise the limit handle

The white lamp holder

under the tube




Note: Do not touch the lamp tube with your hands to avoid burns



Warning

- After the disinfection time is set, personnel should leave the disinfection area immediately and the disinfection begins.
- Protective goggles (or protective mask) and protective clothing must be worn for protection to avoid burns.
- During the disinfection process, a warning sign should be placed outside the entrance door to remind people not to enter the place exposed to ultraviolet rays.

4.5 Circuit diagram:

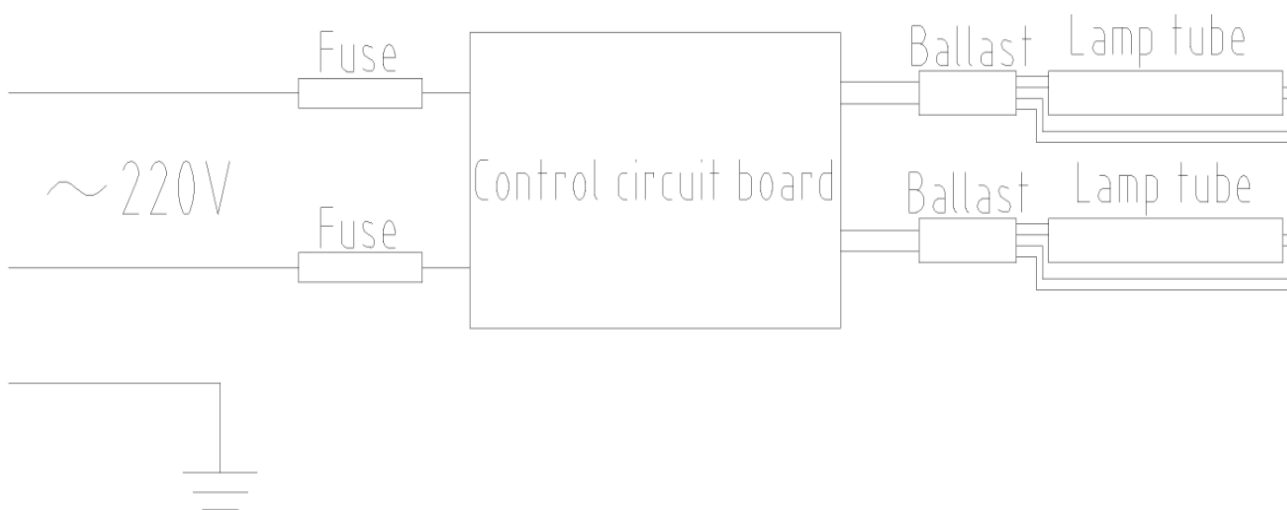

5. Maintenance and Repair Instructions

5.1 Daily maintenance

In order to maintain the normal use of this product, the daily maintenance work before/after use needs to be operated according to the following items:

5.1.1 The surface of the product should be kept clean. Wipe the surface of each part with a neutral detergent, warm water and a soft cloth.

5.1.2 When there are stains on the surface of the product, it is strictly forbidden to use organic solvents, acids and alkalis and other corrosive materials to scrub, so as not to damage the equipment.

5.1.3 To keep the surface of the ultraviolet lamp clean, generally use an alcohol cotton ball every two weeks. If there is dust or oil on the surface of the lamp, you can wipe it clean at any time to avoid affecting the ultraviolet output.

5.1.4 The irradiance of the lamp tube should be detected according to the actual use. It is recommended to regularly use the ultraviolet irradiance meter with a center wavelength of 253.7nm to detect the radiant intensity of the ultraviolet lamp tube. The irradiance of the lamp tube is $<70\mu\text{W}/\text{cm}^2$. The lamp tube should be replaced in time.



Warning:

Danger of electric leakage: prevent liquid substances from flowing into the equipment, otherwise the equipment will leak electricity and cause danger.

5.2 Lamp tube replacement

5.2.1 Disconnect the power supply, open the guard plate, and raise the lamp

5.2.2 Hold the metal parts at both ends of the lamp at the same time, rotate both ends of the lamp at the same time, until the contact pins of the lamp can be seen at the opening groove of the white lamp base at both ends at the same time, take out the lamp from the opening groove and gently place it Put it on a soft object that is not easy to fall to avoid chipping.

5.2.3 Take out the new lamp tube from the package, check the lamp tube, there should be no cracks.

Note: When picking and installing the lamp, wear gloves with both hands to keep the lamp clean

5.2.4 Hold the metal parts at both ends of the new lamp tube at the same time, push the contact pins at both ends into the opening slot of the lamp tube base at the same time, and after fully pushing it into the bottom, both ends rotate 90 degrees simultaneously.



The contact pin is not exposed

Contact pin exposed



Warning and safety:

It is highly unlikely that a broken lamp tube will have any impact on your health. If the lamp is broken, please ventilate the room for 30 minutes, and then remove the parts with preferably wearing gloves. Place them in sealed plastic bags and send them to your local waste disposal facility for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

5.3 Fuse replacement

If you need replace the fuse, you must first unplug the power plug, then press the fuse box cover, replace the new fuse that meets the specifications, and then press the fuse box cover tightly.

5.4 Handling of common faults

5.4.1 The ultraviolet sterilizer should be repaired by professionals. During the test, repair or use, the operator must wear corresponding protective glasses and protective equipment to prevent ultraviolet radiation from damaging the eyes and exposed parts of the human body.

5.4.2 When the product is repaired, the power of the 30W fluorescent lamp test equipment can be used. After the equipment is normal, the ultraviolet lamp can be sterilized by air, which can avoid burning the eyes and human body when repairing directly with the ultraviolet lamp.

5.4.3 If the product fails, please eliminate the daily failure first. If the failure cannot be eliminated, please contact our authorized distributors or our after-sales department.

Common faults	Possible cause	Solution
Not work properly after power on	The power plug is not inserted	Reinsert the plug
	Check if the power outlet is energized	Replace the power outlet
	Fuse is blown	Replace the fuse
Lamp tube not work	Bad lamp contact	Reinstall the lamp to make good contact between the lamp and the lamp holder
	Bad switch	Replace the switch
	The remote control is broken	Replace the remote control
	Bad lamp tube	Replace lamp tube
After the above matters are confirmed, if it is still not normal, please report to a professional technician for repair or contact the manufacturer		

5.5 Waste treatment

5.5.1 Please recycle the UV lamp according to the relevant regulations and can not be discarded at will;

5.5.2 Disposal of packaging materials: Dismantled packaging materials should be disposed of in accordance with national environmental protection requirements.

5.5.3 Disposal of equipment:

When the equipment must be stopped, the dismantled equipment should be classified according to different materials of product parts.



Warning: First cut off the power of the connected equipment, and then remove the equipment.

5.6 The following circumstances fall within the scope of immunity

5.6.1 Damage caused by force majeure and natural disasters;

5.6.2 When the grid voltage exceeds the product's specified range, it is not caused by the product itself and is damaged;

5.6.3 Exceed the service life of the product;

5.6.4 Failure to operate, maintain or maintain the product as required by the product manual;

6. Packaging, Transportation and Storage

6.1 Packaging

The packaging of the product ensures that the product has good protection during transportation. It is sealed with a plastic bag. After placing the protective material, It will be packed in the outer packaging box, and attached with product instruction manual and certificate of conformity.

6.2 Transportation and storage:

Ambient temperature range: -40°C~+55°C

Relative humidity range: <93%

Atmospheric pressure range: 860hPa~1060hPa

Storage: The product should be stored in a dry, ventilated, free of corrosive gas, flammable and

explosive gas space.

Transportation and handling: It can be used by general transportation. Sunlight and rain should be avoided during transportation and loading/unloading. It must be turned upside down, handled with care and avoid strong collision.

7. After-sales service

Any quality problems that occur under normal storage and use conditions, from the date of purchase, within one year of warranty (lamp tube not included)

If the user needs, the factory will provide maintenance information and technical support, if you have any questions, you can contact the company after-sales directly.

After-sales service unit: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd.

Address: Building 2#, NO.885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, Shanghai, China.

Phone: +86-021-58084992, 58082099

Fax: +86-021-58085105



America

CERTIFICATE

No. QS5 061501 0011 Rev. 00

Certificate Holder:

Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd.

Building NO.2, NO.885, Qiuxing Road, Nicheng Town
Pudong New Area
201306 Shanghai
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Scope of Certificate:

Design and Development, Production and Distribution of Air Cushions for Bedsore, Shadowless Operating Lamps, Electric-Heating Boiling Disinfectors and Electric Pneumatic Hemostat; Distribution of Operating Table, Pendant and Bedhead Unit

Standard(s):

ISO 9001:2015

The Certification Body of TÜV SÜD America Inc. certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system that meets the requirements of the listed standards.

Report No.:

SH1811713

Effective Date:

2019-04-17

Expiry Date:

2022-04-16

Page 1 of 1

Date of Issue: 2019-04-26

(Arie Henkin)
Manager, Certification Body MHS

TÜV SÜD America Inc. • 10 Centennial Drive Ste 207 • Peabody, MA 01960 USA • www.tuvsud.com

TÜV®



**SGS-CSTC Standards Technical Services
(Shanghai) Co., Ltd.**

VERIFICATION OF COMPLIANCE

Verification No.: SHEM200900799001HSC
Applicant: SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.
Address of Applicant: Building No.2, No.885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, Shanghai, China
Product Description: UV Sterilizer
Model No.: HF-YZW110SWII, HF-YZW60SWI, HF-YZW60SWII, HF-YZW110SWI
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with
Test Standards: EN 55014-1:2017
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55014-2:2015
As shown in the
Test Report Number(s): SHEM200900799001

This verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the tests, performed by laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards under Directive 2014/30/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives.

Parlam Zhan

Parlam Zhan
E&E Section Manager



Date: 2020-09-30

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)



SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
Testing Center EMC

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612

t(86-21) 61915666 f(86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
t(86-21) 61915666 f(86-21) 61915678 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)