

I.P. "LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR CONSERVATE"

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI



MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 1830DA din 03.12.2024

- | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|------------|
| 1 | Obiectul încercat
(identificare, descriere) | Mostra nr. 1830DA. Prune uscate fără sămbure | | |
| 2 | Solicitant | S.R.L. „SUNEXPORT&CO”
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1. | | |
| 3 | Informație furnizată
de solicitant | Producător – S.R.L. „SUNEXPORT&CO”
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1,
Mărimea lotului – 65000 kg. | | |
| 4 | Eșantionarea | De către solicitant. Cererea depusă nr. 0837DA din 28.11.2024 | | |
| 5 | Cantitatea de mostră | 2,0 kg | 6 Data primirii mostrei LÎ | 28.11.2024 |
| 7 | Scopul încercărilor | Corespunderea cerințelor: HG nr. 520 din 22.06.2010. | | |
| 8 | Data începerii încercărilor | 29.11.2024 | 9 Data finisării încercărilor | 03.12.2024 |

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Plumb	mg/kg	PS-09-(SM SR EN 14084:2006) ed.3	-	< 0,04
Cadmiu	mg/kg	PS-09-(SM SR EN 14084:2006) ed.3	-	< 0,030
Arseniu total	mg/kg	PS-10-(SM EN 14627:2014) ed.3	-	< 0,14
Mercur total	mg/kg	GOST 34427-2018	-	< 0,030
Aflatoxina B ₁	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	max. 2,0	< 0,5
Aflatoxina B ₂	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	-	< 0,1
Aflatoxina G ₁	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	-	< 1,0
Aflatoxina G ₂	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC ed.2	-	< 0,1
Suma aflatoxinelor	μg/kg	Calcul	max. 4,0	< 1,0


*Rezultatele încercărilor cu semnul "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Responsabil de emiterea RÎ

Adriana COJOCARU

Șef de laborator

Zoia BOICO

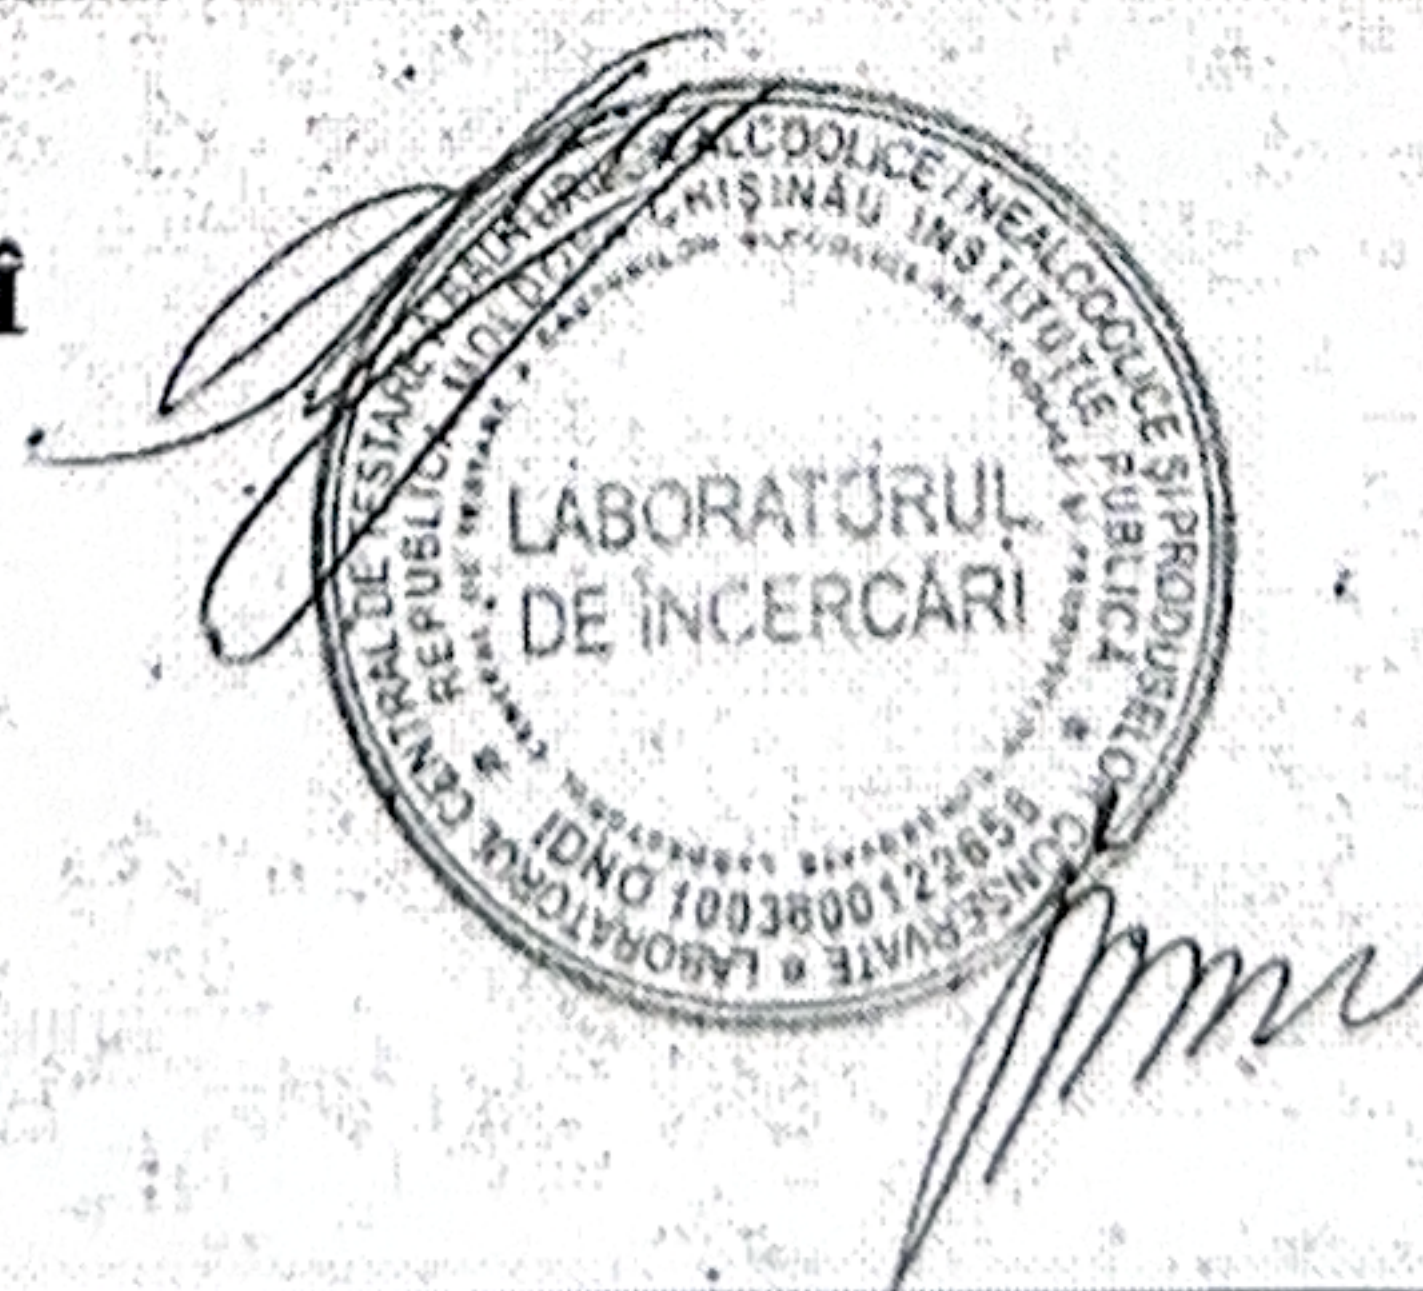

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.

Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

LÎ LCTBANPC

Cod: RÎ-7.8/3

Ediția: 1/ 15.05.2023

Pagina 1 din 1