

Denumire produs:

Set steril getabil pentru interventii angiografice majore

Cod produs:

Model – ASP-001-1.

Produs conform:

ISO 13485, EN 13795-1:2019, EN ISO 11737-1:2018, EN ISO 22612:2005, EN ISO 22610:2006, EN ISO 29073-3:1996, EN ISO 13938-1:1999, EN ISO 811:2018, EN ISO 9073-10:2004.

Material:




Tip sterilizare:

Oxid de Etilenă.


Conținutul setului:

Nr.	Denumire produs	Mărimea	Cantitatea
1	Cîmp angiografie	240 x 330 cm	1 buc
2	Cîmp absorbant, capacitatea de absorbție 500ml	35 x 45 cm	1 buc
3	Cîmp cu bord adeziv	50 x50 cm	1 buc
4	Cîmp de masă instrumentar	150 x190 cm	1 buc
5	Șervețele pentru mîini	30 x40 cm	4 buc
6	Halat chirurgical standard	XL	2 buc
7	Mănuși sterile, nepudrate	N 7.0	1 buc
8	Mănuși sterile, nepudrate	N 7.5	2 buc
9	Mănuși sterile, nepudrate	N 8.0	1 buc
10	Husă ecran circulară	140 cm	2 buc
11	Husă tub radiologic C-arm	75 cm	1 buc

Caratteristici costruttive:

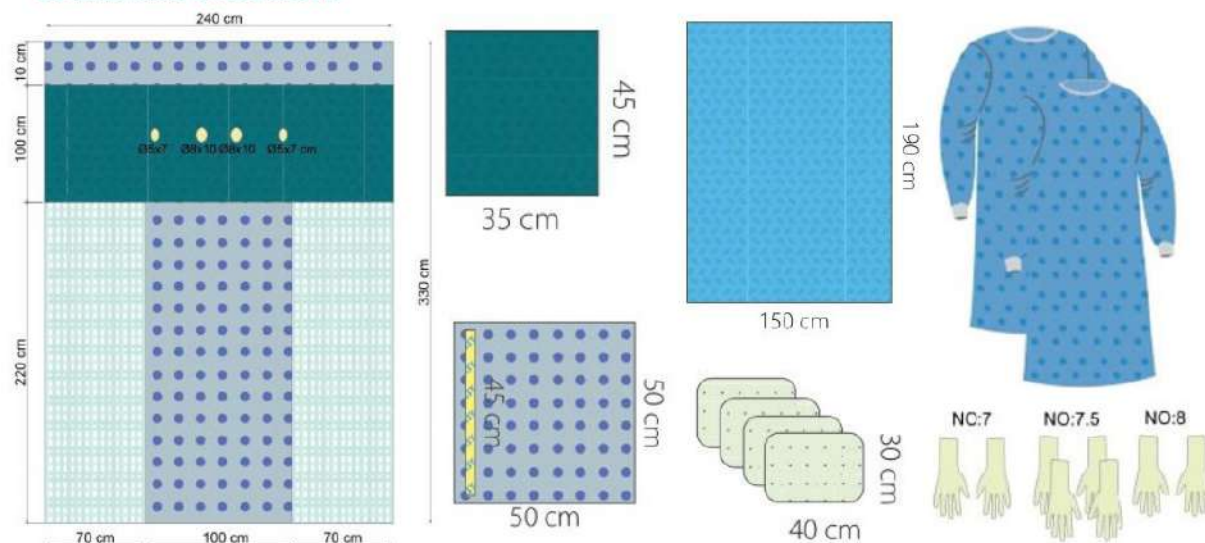

Nr.	Denumire produs	Mărimea	Cantitatea
12	Bol	120 ml	1 buc
13	Bol	100 ml	1 buc
14	Bol	250 ml	1 buc
15	Bol renal	800 ml	1 buc
16	Forceps	13 cm	1 buc
17	Clamă	10 cm	1 buc
18	Tăviță	3000 ml	2 buc
19	Seringă angio cu rotator	12 ml	1 buc
20	Rampă OFF	3 căi	1 buc
21	Bisturiu	Nr.11	1 buc
22	Ghid angiographic	175 cm-J-tip 0.035	1 buc
23	Tampon de tifon absorbant	10 x 10 cm	30 buc
24	Ac seringă	18 G	1 buc
25	Ac seringă	21 G	2 buc
26	Ac seringă	22 G	1 buc
27	Seringă Luer Lock	20 ml	1 buc
28	Seringă Luer Lock	10 ml	1 buc
29	Seringă Luer Lock	5 ml	1 buc
30	Seringă Luer Lock	2 ml	1 buc
31	Bol pentru tubulatură	3000 ml	1 buc
32	Cîmp steril pentru tubulatură	100 x160 cm	1 buc

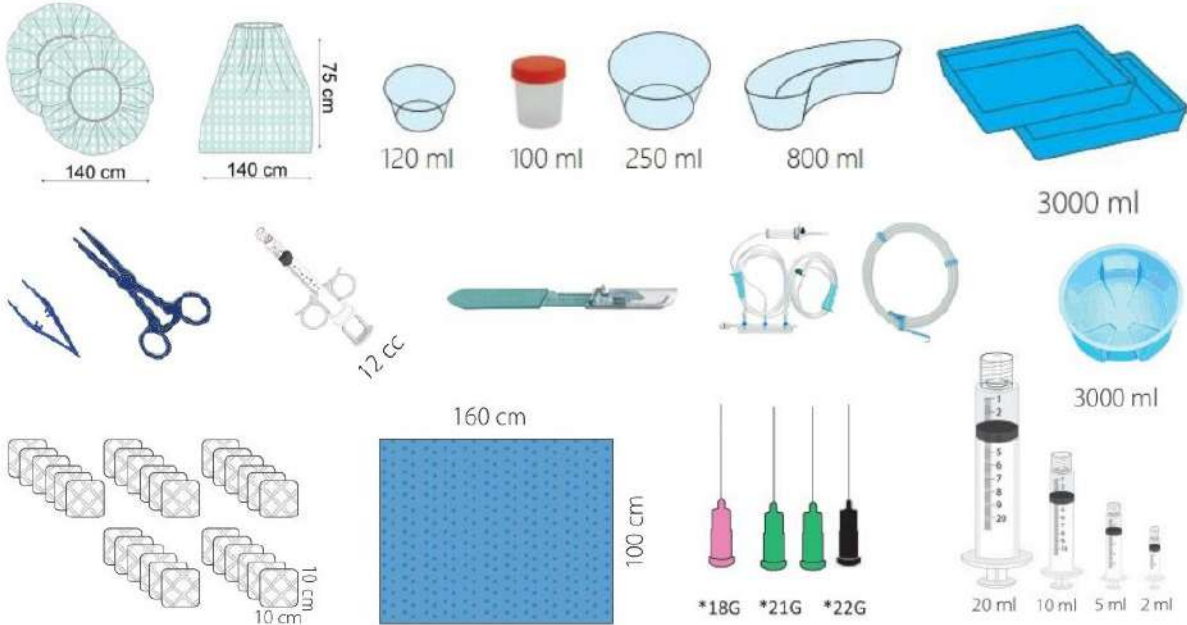

Mod de ambalare :

Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore este steril, ambalat individual. Pe ambalaj este inscripția cu numele și adresa producătorului, modelul produsului, descrierea, dimensiuni, data fabricării, termen de valabilitate, nr.lotului, etc.


* Produsul este steril, de unică folosință și nu poate fi resterilizat. Își menține sterilitatea atât timp cât pachetul nu este deschis și deteriorat.

Instrucțiuni de depozitare:

Depozitarea se realizează în ambalajul original. A se păstra la loc uscat și curat ferit de umiditate, de la temperatura de 0°C la + 30°C, a se feri de lumina directă a soarelui, de picături de apă și de vapori de solvenți.

Termen de garanție:

3 ani de la data producerii.



SUBMED
BIYOMEDİKAL SİSTEMLER
PAZARLAMA DİŞTİC. A.Ş.
 Orhangazi Mahallesi 1673 Sok. No: 20/2-3
 Esenyurt/İST. Esenyurt V.D. 7821159861