

Specificații de preț

Numărul licitației: LP nr. 21245265


Data: „19” august 2019 Alternativa nr.:

Denumirea licitației:

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară8)

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă	Beneficiar
33100	1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază	bucată	1	1814000,00	2176800,00	1814000,00	2176800,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	1250000	IMSP CS Comrat
33100	8	Aspirator toracal	Aspirator toracal	bucată	1	8400,00	10080,00	8400,00	10080,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	12900	IMSP SR Singerei
33100	9	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de bază) Cod 130330	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de bază) Cod 130330	bucată	3	18740,00	22488,00	56220,00	67464,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	15600	IMSP SR Singerei
33100	19	Cințar electronic pentru adulți cu talionmetru Cod 130700	Cințar electronic pentru adulți cu talionmetru Cod 130700	bucată	2	4118,00	4941,60	8236,00	9883,20	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	8000	IMSP SR Ungheeni
33100	20	Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340	Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340	bucată	3	85000	102000	255000	306000	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vânmuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	1140000	IMU
								2141856,00	2570227,20			

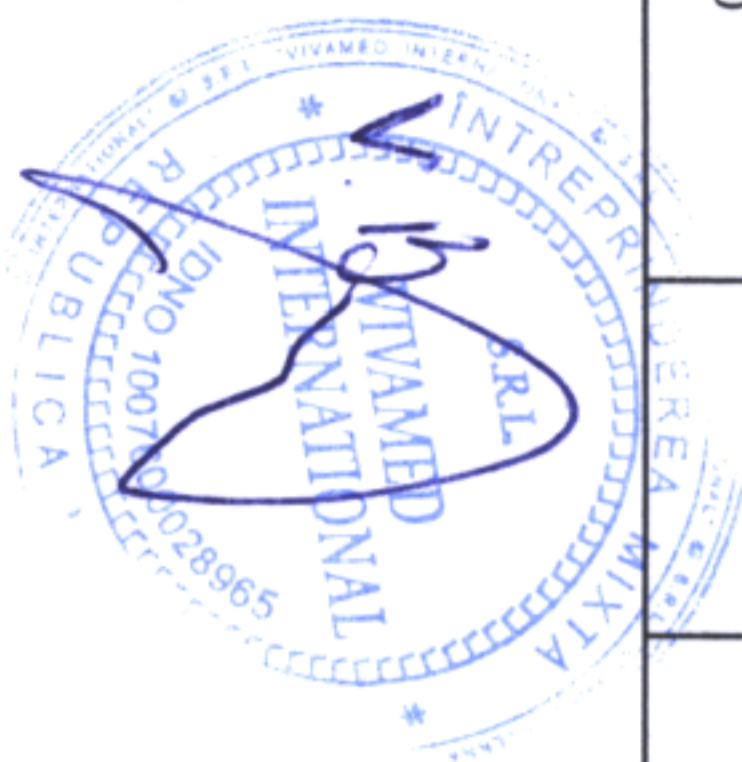

Specificații tehnice

		Numărul licitației: LP nr. 21245265			Data: „19” august 2024		Alternativa nr.:		
		Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 8)		Pagina: din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire L	Denumire Lot	Modelul articolului	Cantitatea	Produce-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Dovada Înregistrării în Registrul de Stat
33100000-1	2	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază	3	4	5	6	7	8
	1			Multix Impact	1	Siemens, Germania	<p>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază Cod 210210</p> <p>Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mișcare și multiple configurații. Aria largă de mișcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului și a stativului vertical permit expuneri de la cap până la degetul piciorului fără să fie necesară re poziționarea pacientului.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Modul radiologic Digital Detector unic obligatoriu</p> <p>Tip masă Tip Piedestal</p> <p>Suport electric obligatoriu</p> <p>Mișcarea mesei Longitudinală, cm ± 50</p> <p>Laterala, cm ± 12</p> <p>Verticală, motorizat obligatoriu</p> <p>Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al</p> <p>Greutatea maximă a pacientului ≥ 200 kg, în mișcare</p> <p>Suportul mesei Piedestal</p> <p>Sistem de control electromagnetic</p> <p>Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat</p> <p>Dimensiunea, cm minimum 43x43</p> <p>Controlul automat al expunerii (AEC) minim 3 câmpuri</p> <p>Raportul grilei ≥10:1</p> <p>Deplasarea longitudinală, cm minim 35 cm</p> <p>BUCKY vertical Dimensiunea, cm minimum 43x43</p> <p>Controlul automat al expunerii (AEC) obligatoriu</p>	Conform Specificației Tehnice anexate Lotul 1	DM000371183

33100 000-1	Aspirator toracal	Aspirator toracal				Aspirator toracal Cod 130310 Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și peretele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotrauma, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația Sistemul vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg Indicator de presiune obligatoriu Debitul de aer ≥ 30 l/min Nivelul de zgomot < 65 dB Vas colector Protecție la umplere obligatoriu Capacitatea ≥ 1000 ml Reutilizabil obligatoriu Tip Filtru Unică utilizare obligatoriu Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Filtru antibacterian "15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" Vas colector Reutilizabil "1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit"	Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și peretele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotrauma, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația Sistemul vacuum Limita maximă ≥ 600 mmHg Indicator de presiune obligatoriu Debitul de aer ≥ 40 l/min Nivelul de zgomot < 65 dB Vas colector Protecție la umplere obligatoriu Capacitatea ≥ 1000 ml Reutilizabil obligatoriu Tip Filtru Unică utilizare obligatoriu Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Filtru antibacterian "15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" Vas colector Reutilizabil "1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit"	DM000579001
8			28211+28229	1	Gima,Italia	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. ≥ 36 Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA Vas colector Material excepție sticla Numărul "1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)" Capacitatea, L ≥ 2 L Protecție la umplere obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Timp operare > 1 h Accesorii Filtru antibacterian "15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)"	Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. ≥ 36 Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA Vas colector Material excepție sticla Numărul "1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)" Capacitatea, L ≥ 2 L Protecție la umplere obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Timp operare > 1 h Accesorii Filtru antibacterian "15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)"	DM000579025
9			292193	3	Gima,Italia			

