蓝、红：SXQ2135

单位：mm

未注圆角：R3

红（UV161 金红 S）

UV161 305 群青 S

王琳样品，300ml主标，SXQ2135

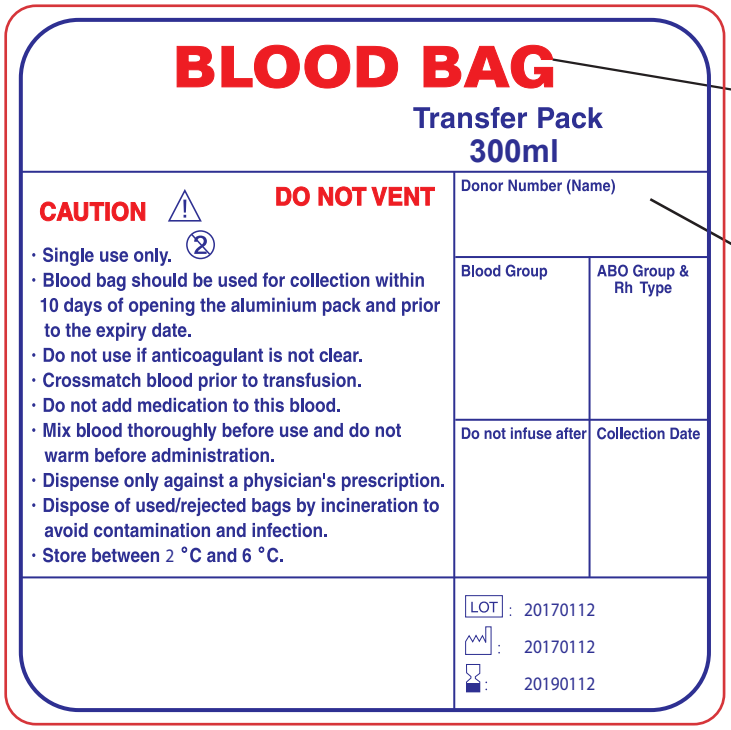

95

95

Digitally signed by Şarco Alexandru
Date: 2022.11.27 12:24:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

技术要求：

1. 版面应清晰、整洁、无脏污。
2. 面纸与底纸应能顺利剥离，且底纸无切透现象。
3. 包装方式：单张纸包装，8个/张。
4. 未注公差：±2。
5. 双色印刷（红＋蓝）。
6. 菲林：SXQ2135（左右2个，夹刀3mm，黑版设跟踪电眼1个（3*5mm），轮转机印刷）
7. 刀板：95*95,（左右2个，夹刀3mm)。

项目	检查结果	
药膜面		
分色		
夹刀		
出血		
电眼		
网点		
尺寸		
内容		
批号		
检查员签名		

标记	处数	分区	更改文件号	签 名	年月日

制图	于晓红	2015.12.10	标准化	
校对				
审核				
会签			批准	

PM 8K
（幅宽205）

阶段标记	版号	数量	比例
	A/0		1:1

共 1 张，第 1 张

威海威高医用材料有限公司

300ml血袋主标签
（适用于王琳计划）

WGYC-BGJ-SXQ-2135