



Signature Health System
HOCATT Plus
Ozone Sauna Steam Chamber

Manual de utilizare

•Introducere	2
•EFECTE FIZIOLOGICE	4
•Therapie	5
•EWOT	5
•MĂSURI DE SIGURANȚĂ	6
•Diagramă	8
•Oxygen Concentrator	11
•Setările sesiunii	12
•setările oxigenului	13
•Setările Herbal	13
•Durata sesiunii	18
•Disclaimer și avertismente	20
•Recomandări	23
•Contra indicatii	23

INTRODUCERE:

The HOCATT Plus - Ozone Steam Sauna Chamber este un sistem de sănătate multidisciplinar, care combină 7 modalități efective de tratament, într-o singură sauna . Are multe beneficii, deosebindu-se de modul convențional Dry Heat sau de Steam Sauna.



Este una dintre cele mai eficiente sisteme de sănătate disponibile în momentul actual. Nu numai ca este relaxant si revigorant dar îmbunătățește sistemul de apărare al corpului și nivelurile de oxigen, care îmbunătățesc sănătatea și bunăstarea alveolară. Este de asemenea recunoscut de tot mai mulți practicieni (medici și și medici naturaliști) ca o terapie puternică și eficientă sau terapie adjuvantă pentru a trata o gamă largă de boli, răni .

The Signature Health „HOCATT Plus” Ozone Steam Sauna Chamber este mobil, convenabil, confortabil și chiar luxos. Folosiți-l în intimitatea propriei dvs case, în momentele de relaxare, sau in cabinete medicale .

The „HOCATT Plus” Ozone Steam Sauna Chamber poate contribui deasemenea la calitatea vieții de familie, fiind totodată potrivit pentru a fi plasat într-o cameră de familie și cum fața ocupantului nu este izolată ca într-o saună convențională, el sau ea pot interacționa pe deplin cu restul familiei și activitățile lor , în timp ce așteaptă rândul lor.

De ce poți fi sigur că ai făcut alegerea cea mai potrivită!

Signature Health a incorporate ani de experiență în noul sistem *Signature Health „HOCATT Plus” Ozone Steam Sauna Chamber* .

Veți beneficia de:

1. Sistem îmbunătățit de utilizare.
2. Productivitate crescută, încălzire rapidă, reumplere, sistem îmbunătățit de curățare și control permițând operarea cu ușurință.
3. Gamă crescută de aplicații și programe cu ajutorul unui sistem ușor *touch screen control*.
4. Calitate îmbunătățită- noul design este compact, are mai puține piese mobile
5. Simplificarea sistemului de întreținere si reparare
6. Eficacitate îmbunătățită prin adăugarea Electroterapiei și a Ultrasonic Cavitation ca opțiuni.
7. Eficacitate îmbunătățită prin adăugarea Terapiei pe bază de plante și Oxigeno- Terapie ca opțiuni.

Multi Disciplinary Health System

Herbal / Aroma therapy, Steam Sauna / Hydro Therapy, Photon Light and Spectrum Therapy, Medical Ozone Therapy (Transdermal), Oxygen Therapy (EWOT) , Electroterapy , Ultrasonic Cavitation .

Efecte fiziologice majore

Sauna /Steam Therapy

Căldura umedă este mai blândă cu pielea decât căldura uscată; înmoaie pielea deoarece deschide porii pentru a stimula transpiratia, eliminând astfel toxinele. Ozonul, Ierburile și uleiurile aromatate vor spori și mai mult aceste beneficii. Protocoale noastre predefinite sunt sugerate pentru aplicații specifice sau condiții, oferind următoarele beneficii:

1. Creșterea bătăilor inimii (circulația sângelui)
2. Creșterea nivelului de oxigen din sange si metabolismul acestuia la nivel celular (Anti-imbatrănire, frumusețe si piele), crește capacitatea de transport de oxigen și rata de eliberare a hemoglobinei (celule rosii din sange). Crește producția și activitatea celulelor roșii și albe din sânge.
3. Creșterea temperaturii corpului pentru a induce o stare similară cu febra naturală.

4. Îmbunătățește capacitatea organismului de a se vindeca singur, pentru a combate și elimina patogenii și toxinele prin intermediul sistemului respirator (urme de secreții toxice în unele cazuri)
5. Relaxează tensiunea musculară și crește metabolismul de acid lactic
6. Crește nivelul de energie și risipește oboseala.
7. Crește nivelul de serotonină, ca efect calmant și de curățare.
8. Are efecte imediate de relaxare și întinerire, după ședință.
9. Arde până la 600 de calorii pe ședință
10. Activează țesutul din piele, întârzie declinul mental, promovează metabolismul. Curăță adânc pielea.

TERAPIA CU OZON MEDICAL

1. Ozonul este un agent anti-patogen – omorâă bacteriile și ciupercile, sterilizează virușii, oxidează toxinele daunatoare.
2. Ozonul medical introdus la nivel de prescripție medicală este recunoscut ca fiind unul dintre agenții de detoxifiere cei mai puternici și eficienți.
3. Ozonul este igienic și, prin urmare, corpul, precum și întreg Sistemul este curățat în timpul fiecărei ședințe.
4. Activează țesutul pielii, întârzie declinul mental, promovează metabolismul. Curăță adânc pielea.
5. Crește nivelul de oxigen din sânge și metabolismul acestuia la nivel celular (Anti-îmbătrânire, frumusețe și piele), crește capacitatea de transport a oxigenului și rata de eliberare a hemoglobinei (celule roșii din sânge). Crește producția și activitatea celulelor roșii și albe din sânge.
6. Crește markerii sanguini de stres anti-oxidanți (anti-îmbătrânire, rezistență, capacitate sporită a sistemului imunitar)
7. Sterilizează ranile.

Oxygen Therapy (EWOT)

EWOT (Exercise with Oxygen Training) este o metodă practică inițial de către sportivi de top în timpul antrenamentului. Atletul se angajează în alergare sau în alte forme de exerciții cardiovasculare, perioadă în care primesc oxygen medical prin intermediul unei măști sau a unui set cu mască. Recent ea s-a dezvoltat într-o practică mult mai accesibilă și chiar comercială, astfel încât oxigenul nu este ceva ieșit din comun astăzi. Aceasta este o nouă și incitantă terapie adițională, adusă de Ozonoterapie, cuprinzând beneficiile terapiei cu ozon și terapiei prin saună, prin folosirea sistemului opțional de respirație, în timp ce se bucură de sauna cu aburi.

Herbal /Aroma Therapy

The Signature Health Ozone Steam Sauna Chamber dezvoltă un system unic care îi permite utilizatorului să adauge arome sau săculeți pe bază de plante, prin care aburul pătrunde. Aroma vaporizată sau ierburile stimulează și trezesc simțurile olfactive pentru a spori rezultatele și buna dispoziție.

Uleiurile esențiale pure și extractele din plante stimulează organismul prin intermediul sistemului olfactiv și prin capacitatea sa de a pătrunde în piele prin deschiderea porilor de la suprafața pielii. Agenții activi sunt absorbiți prin lărgirea capilarelor în piele. Extractele aromatice pe bază de plante pot fi combinate pentru a obține un effect personalizat. Poate fi folosit orice extract de frunze de calitate.

Chromo therapy /Color therapy

Stadiul în care se află *The art digital lighting technology (LED)*, generează o varietate de lumini colorate. Corpurile noastre reacționează la culoare în moduri fiziologice cuantificabile. Prin combinarea terapiei cu culori cu alte modalități, efectele lor sunt îmbunătățite. Fiecare Cameră include două stele de culoare- modificările de culoare la întâmplare și multi-color dispar în cruce și sunt alcătuite din toate culorile spectrului, incorporând echilibrarea culorilor liniștitoare, relaxante și energizante.

AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Persoanele care suferă de următoarele afecțiuni, nu trebuie să participe la ședințe cu Ozonoterapie:

- Pacienți care au suferit recent un atac de cord
- Femei însărcinate
- Persoane alergice la ozon
- Persoane care suferă de hipertiroidism
- Pacienți cu trombocite dezordonate
- Suferinzi TB
- Persoane purtatoare de pacemakers

INHALAREA OZONULUI

Inhalarea ozonului în concentrații mari sau pe durate prelungite, poate afecta sănătatea, după cum urmează :

- Iritarea sistemului respirator și a membranei mucoase
- Poate cauza:
 - ♦ tuse, picurare nazală
 - ♦ amețală
 - ♦ durere de cap
 - ♦ oboseală
 - ♦ erupție pe piele, pe brațe și pe piept
 - ♦ umflarea ochilor

Măsuri preventive

1. Terapia cu ozon transdermic se bazează pe transferul concentrației recomandate de oxigen prin derm. Aceste niveluri sunt necesare pentru un nivel terapeutic, dar nu sunt potrivite pentru inhalarea prelungită.
 - Zona feței trebuie să fie întotdeauna izolată 100% prin folosirea prosoapelor sau sistemul *Signature Health Neck Blanket* în jurul zonei gâtului.
 - The “*HOCATT Plus*” *Ozone Steam Sauna Chamber* are un built-timer care termină producția de ozon cu trei minute înainte de terminarea ședinței. Cu toate acestea ozonul este încă eliberat atunci când ocupantul deschide camera- aceasta este o măsură de protecție care asigură ventilația optimă prin camera de tratament, mai ales atunci când sunt programate mai multe ședințe zilnic.
 - Nu lăsați niciodată ușile deschise pentru ca generatorul de oxigen să elibereze o cantitate mare de ozon în cameră.
 - Comutați generatorul de oxigen, imediat înainte de a începe ședința.

IMPORTANT: Nu creșteți niciodată fluxul de oxigen mai mult de 1L / m (0.5-1L / m = debit recomandat), deoarece acesata va duce la creșterea presiunii în sauna și poate duce la scurgeri în atmosferă.


2. IMPORTANT: Asigurați-vă întotdeauna că firul electric este uscat și nu este expus la scurgeri de apă (atenție mare când umpleți rezervorul să nu vărsați apă pe cablul electric sau pe adaptorul de alimentare).
3. IMPORTANT: The *Signature Health Ozone Steam Chamber* este echipat cu un cablu de alimentare de trei m. În cazul în care este necesară o prelungire (ceea ce nu se recomandă), folosiți numai 4000 watti necesari echipamentului, deoarece deviațiile pot duce la pericol de incendiu.
4. Oxigenul în concentrație mare este inflamabil și astfel fumatul sau orice foc deschis în apropierea generatorului de oxigen nu este recomandată.
5. A NU se amesteca Ozon cu eter căci devine un amestec reactiv.
6. Unitatea ar trebui să fie asigurată pe o suprafață plană și toate cele 4 roți blocate. Asigurați-vă că zona din jurul unității este uscată și nu este alunecoasă- întotdeauna recurgeți la asistență pentru a intra și a ieși din cameră pentru a preveni alunecarea sau pierderea echilibrului.
7. Se recomandă să utilizați întotdeauna sprijinul unui asistent pentru a sigila zona gâtului cu prosoape, monitorizarea semnelor vitale și pentru a asigura ieșirea în condiții de siguranță din cameră, în caz de disconfort sau panică.

Diagramă



alimentare cu apă Masurarea nivelului de apă Unitatea CO2 Unitatea de oxigen

-

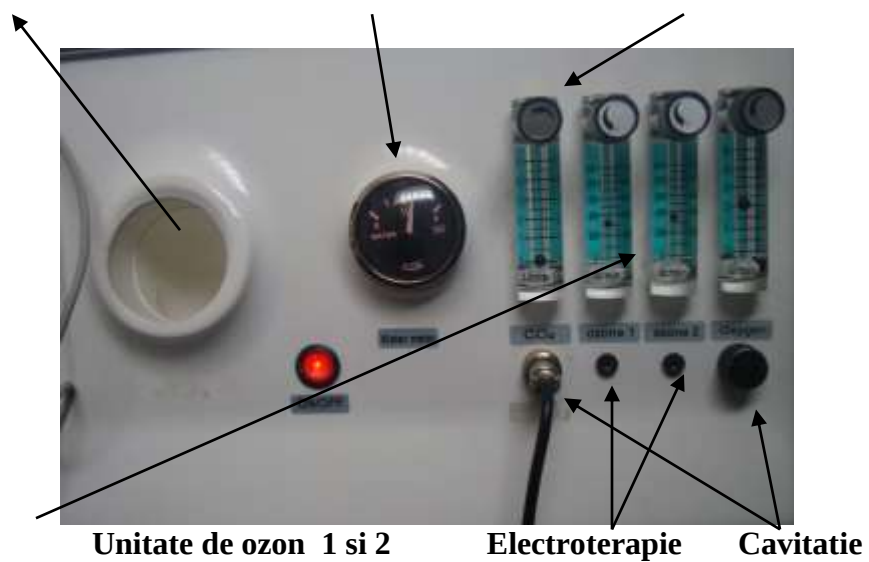

Heart Rate Monitor Adaptor



Container umidificator

priză de control

Oxygen de admisie Socket

Serviciul de acces Panel

Sistemul de control Consola



intrarea Cablului de control


Touch Screen

Interior


Scaun cu canale pentru ajustare



Lumini anion

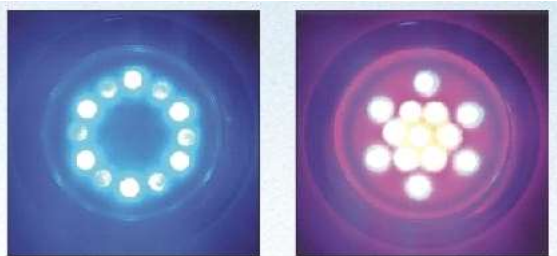

Foot Rest (Basin Cover) cu reglare inaltime

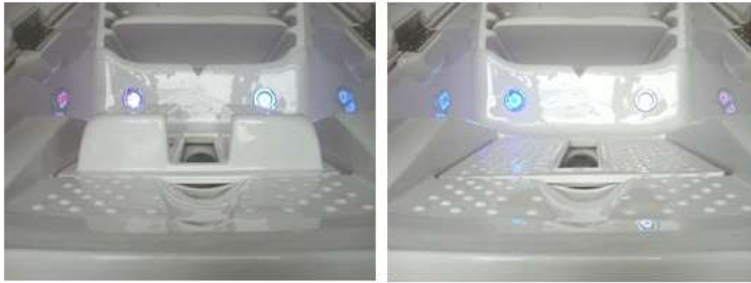

Steam Outlet Jet (Herb and Aroma Refill Capsule)



Herbal Extract Grid



Ozone Inlets

Sensor de temperatura

Signature Oxygen Concentrator

1. Oxygen generator Oxygen Inlet Pipe
2. Oxygen Power Switch
3. Oxygen Humidifier
4. Oxygen Concentrator Flow Meter
5. Oxygen Power Cable





Signature Neck blanket

PAȘII SESIUNII

PASUL 1- PREGĂTIRE ȘI VERIFICARE DE SIGURANȚĂ

- 1) Verificați nivelul apei. Trebuie să fie deasupra rezervorului de ¼.
- 2) Asigurați-vă că nu există zone umede și alunecoase în jurul saunei
- 3) asigurați-vă că toate roțile sunt blocate
- 4) La utilizarea O3, asigurați ventilarea camerei și izolarea ușilor și în jurul gâtului
- 5) Verificați conexiunile concentratorului O2 la Sauna
- 6) Asigurați-vă că Monitorul Heart Rate este conectat și funcționează corect
- 7) Folosiți un cablu de numai 4 amperi
- 8) asistați întotdeauna utilizatorul atunci când pășește înăuntrul și în afara Saunei.
- 9) Verificați întotdeauna starea pacientului și nu îl lăsați niciodată nesupravegheat
- 10) Asigurați-vă că utilizatorul primește lichide (apă purificată sau ceai de plante recomandat) înainte, în timpul și după ședință.
- 11) Luați 2 000mg Vitamina C la 1 -2 h după fiecare ședință.

Pasul doi

- **Conectați Sauna la curent**
- **Conectați Ozone Steam Chamber și Concentratorul Signature Oxygen**

Pasul trei- Configurarea apei și a oxigenului

- **Apasati butonul de pornire**
- **Umpleți aparatul cu apă, aproximativ 4 litri (se folosește aproximativ 1 litru pe oră ½ ședință)**
 - **Alarma apei va suna în cazul în care nivelul apei nu este suficient – și Sesiunea va fi întreruptă**

- Umpleți recipientul Oxygen Humidifier până la nivel $\frac{3}{4}$ cu apă distilată și conectați-l la Sauna
- Pentru Signature EWOT therapy (perioada recomandată de inhalare a oxigenului este de cel puțin 15 minute), atașați setul cu mască la locul prin care iese jetul de oxygen al umidificatorului de sub panoul de control.
- Reglați cele 3 sisteme de dozare după cum urmează- este important să urmați aceste linii directoare cu acuratețe; altfel va fi prea mult Ozon, sau nivelul de presiune al Oxigenului va fi prea mare sau prea mic.
- Configurarea oxigenului



Oxygen Flow meter (O2FM)

Ozone Flow meter (O3FM)

Oxygen Concentrator Flow Meter (O2CFM)

Flow meter Settings

	O2CFM	O2FM	O3FM
O3	2.5 l/m	2 l/m	0.5lm

Configurarea HERBAL

1) Finalizați setările de Oxigen

2) Scoateți bara pentru picioare și deschideți caseta de plante

3) Curățați, dacă este necesar

4) Se adaugă extrase de plante punându-le pe filtru sau adăugând doza recomandată de extracte de ulei

5) Închideți caseta și reasezați suportul pentru picioare

AVERTISMENT:

Fiți atenți să nu puneți picioarele pe priza de abur în timpul operațiunii sau să atingeți caseta de abur în timpul sau imediat după ședință, pentru a preveni arderile.

Pasul 4 - Alegeți un protocol din sistem

Folosiți panoul de control Touch Screen pentru a introduce un tratament preferat și începeți operațiunea



Atingeți ecranul oriunde pentru a introduce sistemul de meniuri.




Selectați Pre-Heat atingând butonul de pe ecran.

- 1. Sistemul va activa ciclul de pre-incalzire (5 min)**
- 2. Este important să se încălzească Sauna, mai ales în condiții de frig**
- 3. Odată ce ciclul de pre-încălzire a fost finalizat, apăsați butonul Back pentru a merge la meniul principal.**
- 4. Selectați opțiunile de program de pe ecran**

5. Selectați aplicația pre-programată pentru aplicația dorită

6. **IMPORTANT:** diverse aplicații nu implică tratament medical pentru aceste condiții; mai degrabă ele sunt programate să acomodeze, să potrivească expunerea și rata de aplicare a Ozonului și aburului. Aceste programe ar trebui văzute ca o adaptare specială a programului de detoxifiere și de precauție pentru a se potrivi condițiilor speciale.

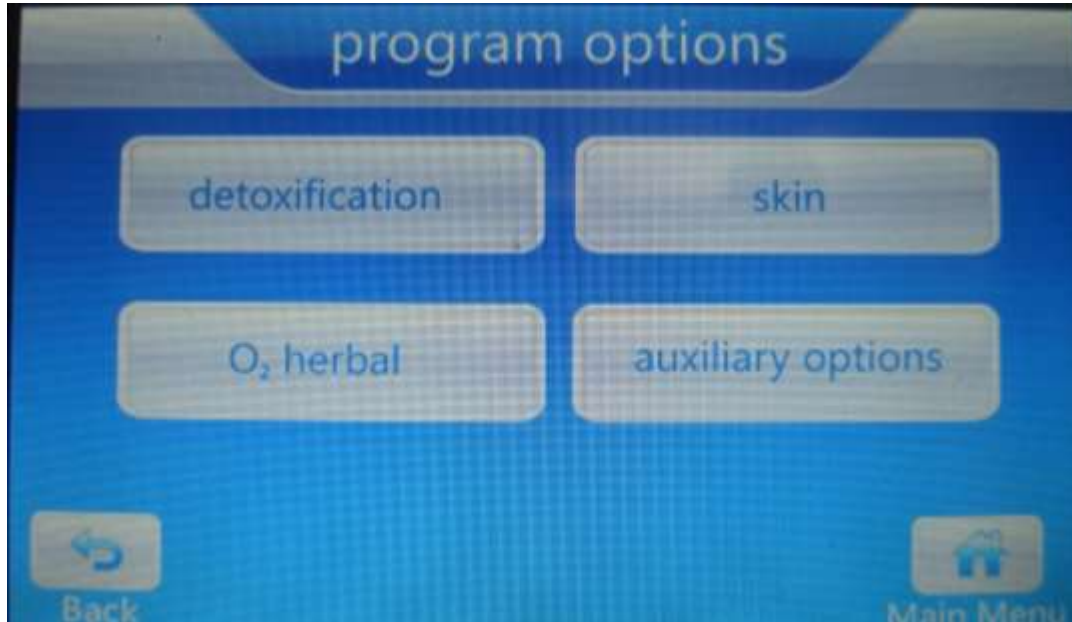

7. Selectați protocolul dorit

8. Pagina protocolului aplicabil se va deschide

9. Selectați sesiunea corespunzătoare, este important ca această secvență să fie urmată pentru ca fiecare program să se acomodeze cu creșterea treptată la expunere, pentru ca organismul să se adapteze la tratament.

O ₃ Detoxification Course always complete a 10 session course Control Screen Active				
Ses 1	Ses 2	Ses 3	Ses 4	Ses 5
Ses 6	Ses 7	Ses 8	Ses 9	Ses 10
Back	Information	Main Menu		

10. Selectați sesiunea corespunzătoare din lista de sesiune

11. Pagina statistica a sesiunii se va deschide afișând toate opțiunile de control

Control Screen Active			
O ₃ Detoxification			Ses 1
99 Time	99 °C Temp	999 HRM	
999 % Steam	999 % Ozone 1	999 % Ozone 2	
Back	Main Menu	Pause	Select

12. Parametrii pot fi schimbați prin selectarea parametrilor aplicabili (abur, ozon, temperatură, timp, lumini și puls). Alegeți setările implicite și apăsați Enter. Odată ce aparatul este oprit și apoi repornit, el va reveni la setările originale.

13. Dacă sunteți mulțumit cu programul, apăsați select pentru a merge la ecranul de control.

14. Apăsați pe Start pentru a începe sesiunea.

15. Odată ce sesiunea este pornită, va exista un text galben în mișcare pentru a indica ce program este activ pentru dumneavoastră.

Exploatați aparatul cu comenzi manuale.

1. Selectați butonul de comandă manuală pentru a intra în ecranul de control




2. Parametrii pot fi schimbați prin selectarea parametrilor aplicabili (abur, ozon, temperatura, timp și puls). Utilizați săgețile de ajustare pentru a mări / micșora setarea selectată.

3. Programul implicat este un pre-program cu temperatură și nivuri de ozon, stabilite la nivelurile recomandate pentru persoane cu nici o afecțiune medicală specială sau fizică. Aceste niveluri se bazează pe norma în industrie și ar trebui să fie aplicabile pentru majoritatea indivizilor.

4. Această setare permite, deasemenea ocupantului să schimbe programul de ajustare a setărilor individuale după cum dorește.

Opțiuni auxiliare

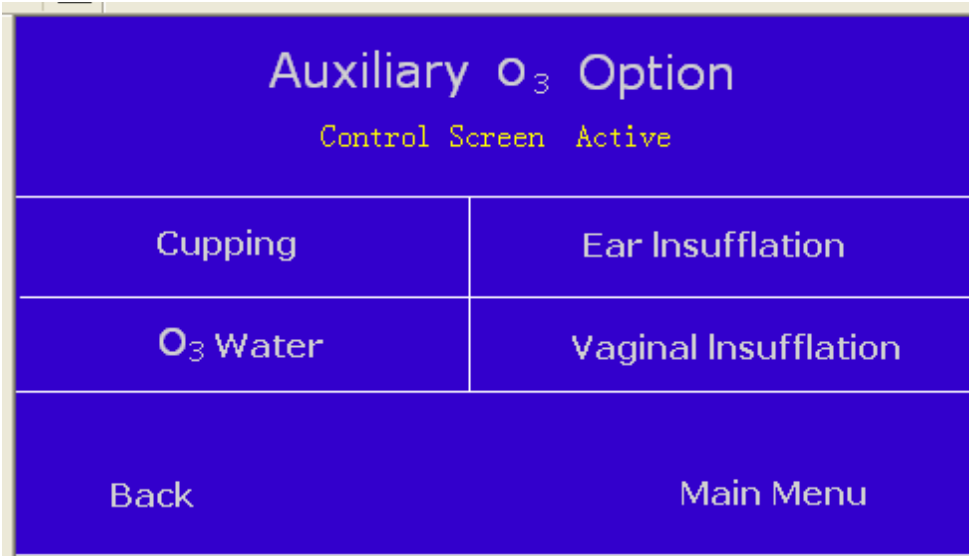

1. selectați opțiunea pe care doriți să o folosiți



2. Selectați timpul prin apăsatea Time și reglați cu plus sau minus

A se vedea mai jos standardele pentru tastele de control:

Timp sedinta **25-40 MINUTE**

TEMPERATURA **38-42 CELSIUS**

Temperatura mai ridicată poate cauza discomfort și iritabilitate, dar este recomandabilă pentru creșterea Heart Rate

Media temperaturii utilizate este de 38 - 41 ° Celsius

ABUR **80-100%**

Un nivel mai scăzut de abur va folosi mai puțină apă, dar va dura mai mult pentru a ajunge la temperatura cerută.

Lumini **ON**

OZON **40-80 %**

Ozonul stimulează o reacție de detoxifiere în corp. Mărirea bruscă a dozei poate cauza umflarea ochilor, iritarea membranei mucoase, usturimi ale ochilor, și erupții cutanate sau mâncărime pe antebrațe sau partea superioară a corpului. Se recomandă să se păstreze parametrii în cadrul prevăzut, pentru a preveni iritarea și pentru un efect optim.

DEBIT DE OZON **0.5 l/m**

Debit mai mare => concentrație mai mică de Oxigen. Programul este calibrat pentru 0.5 l/m.

Debit Oxigen **2.5 l/m**

PLANTE /ULEIURI AROMATICE **-Folosiți recomandările produsului**

LUMINI ANIOANE **ON/OFF** = On recomandat

Masurarea PULSULUI

PULS LIMIT

ACTIVAREA SESIUNII

Se afișează rata pulsului pe ecran

limita maximă a pulsului - opțional


START –PAUZĂ

ELECTROTERAPIE:



Pacientul va tine in maini dispozitivele atasate la aparat . Se introduce codul tratamentului dorit si se porneste .

ULTRASONIC CAVITATION

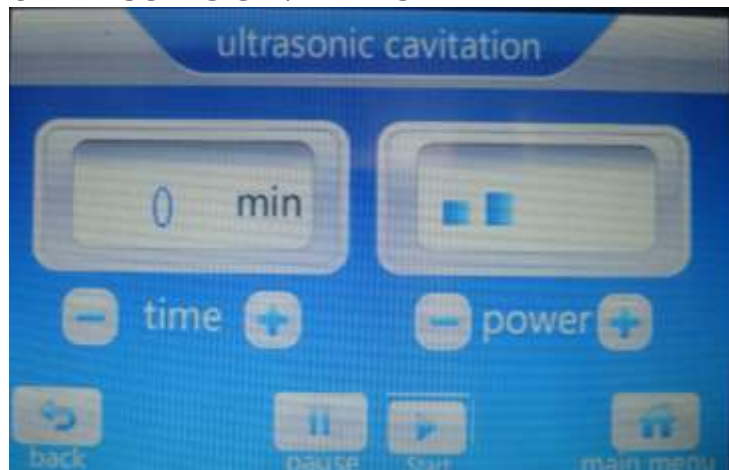

Pasul 5 – Intrarea în sauna și pornirea sesiunii.

1. beți 1-2 pahare de apă
2. folosiți un halat sau un prosop pentru a intra (este recomandat contactul maxim cu pielea , de aceea ocupantul trebuie să fie dezbrăcat- hainele ar putea împiedica expunerea la ozon)
3. închideți ușile și atașați monitorul Heart Rate la deget sau la lobul urechii
4. asistentul trebuie să izoleze fața și gâtul cu prosoape mari
5. asistentul activează sesiunea prin apăsarea butonului „operatiune”

OXIGEN (opțiune recomandată).

Înainte să activeze sesiunea :

1. 1. Montați setul cu mască de oxigen în timp ce stați în sauna fără ozon
1. 2. Reglați distanța până la nas - fluxul de oxigen poate fi rece și iritant pentru nas
1. 3. Asigurați-vă că umidificatorul este umplut cu apă

ÎN TIMPUL SESIUNII

1. Asistentul stă în imediata apropiere, în caz de disconfort, scăderea frecvenței cardiace, pierderea neașteptată sau bruscă a cunoștinței
2. Asistentul verifică orice scurgeri de ozon și etanșarea în mod corect.
3. Utilizați **Signature neck blanket** pentru cel mai bun confort și izolare, sau 1-2 prosoape
4. HEART RATE:
 - a. cei cu boli de inimă ar trebui să consulte un medic. Ar trebui luate măsuri de siguranță prin scăderea temperaturii la 34-38 grade celsius.
 - b. dacă bătăile inimii scad, pe măsură ce sesiunea continuă, este cel mai bine ca sesiunea să se întrerupă imediat.
 - c. pe măsură ce temperatura crește, spre a doua repriză a sesiunii, ritmul cardiac crește cu 50-80 %

d. nu este neobișnuit ca unii utilizatori sa nu vadă nici un răspuns în primele 2-3 ședințe.

e. organismul se va acomoda în timp și un răspuns pozitiv ar trebui să fie remarcat în timp - o creștere a ritmului cardiac este un răspuns sănătos din partea sistemului imunitar.

Pasul 6 – Dupa sedinta de tratament

1. Odata ce timpul alocat pentru sedinta se apropie de final , cu 3 minute inainte de final inchideti generatorul de oxigen
2. Producerea de ozon se va inchide automat cu 3 minute inainte de final pentru a preveni excesul de ozon care se va elibera camera in momentul deschiderii capsulei
3. Pacientul va putea acum sa se acopere cu un prosop
4. Asistenta va deschide usile capsule si il va ajuta pe pacient sa iasa din capsula
5. La iesirea din capsula trebuie sa luati masurile necesare sa evitati alunecarea
6. Inchideti alimentarea cu current a saunei
7. Beti 1 – 2 pahare cu apa pentru rehidratare
8. Este recomandat sa va uscati natural , pentru ca inca are loc absorbtia ozonului de pe piele
9. Faceti dus dupa ½ de ora daca simtiti nevoia .
10. Tratati pielea cu crema Vitamina E pentru a preveni uscarea pielii

Intretinere, Transport & Depozitare

1. Curatati Sauna cu o carpa umeda si cu un detergent cum ar fi cel de spalat vase de lamaie. Puteti folosi si doar apa oxigenata .
2. NU folositi detergentul chiar inainte de utilizarea saunei
3. Asigurati-va mereu ca stergeti interiorul saunei cu un prosop pentru a nu mai fi nici o parte umeda . NU UTILIZATI benzene, alcool sau orice produs puternic chimic pentru curatarea saunei!
4. evitati expunerea la ploaie sau in mediu umed in timpul depozitarii
5. In timpul transportului evitati lovirea oricarei parti a saunei. Asigurati aparatul in timpul transportului.

Avertisment si Garantie:

Acest produs este conceput pentru a functiona ca un dispozitiv pentru Ozon Terapeutic care va indeplini functiile indicate mai sus . Produsul a fost fabricat la cele mai bune standard si in stricta conformitate cu proiectul. In ciuda acestui fapt, producatorul si furnizorul nu pot garanta ca va functiona in procentaj de 100% in toate circumstantele. Asa cum exceptii individuale se regasesc in domeniul medical, utilizatorul va intelege ca pot aparea exceptii cu privire la satisfactia si eficacitatea tratamentului.

Aparatul Smith Mk III Ozone Steam Chamber, la fel ca orice alt aparat medical sau terapie , este dependent de respectarea exacta a indicatiilor si protocoalelor de catre utilizator. O mare importanta o are mentinerea sau adaptarea la un stil de viata sanatos in ceea ce priveste aportul (nutritie, dieta, apa de calitate si oxigenare suficienta) si activitatea (exercitii fizice cardiovasculare efectuate regulat).

Pentru un nivel maxim de satisfactie si beneficii din partea Signature Ozone Steam Sauna Chamber, este foarte important sa intretineti cu grija Sauna , si s-o folositi cu regularitate.

Din acest motiv va recomandam sa nu folositi acest aparat decat pentru ce a fost conceput si conform cu Manualul de Utilizare.

IMPORTANT – pentru tratamentul adjuvant al unor problem serioase de sanatate va rugam sa consultati un medic de specialitate pentru utilizarea Signature Ozone Steam Sauna Chamber.

GARANTIE:

Aparatul incluzand toate componentele (nu si accesoriile) este garantat impotriva defectiunilor de fabricatie pe o perioada de 2 ani. Garantia se aplica din momentul livrarii .

Raportarea unei defectiuni:

Garantam calitatea echipamentelor noastre timp de 2 ani prin repararea sau inlocuirea oricaror component defecte .

1. Datorita sistemului “Plug-in” creat pentru acest aparat, orice technician calificat poate inlocui foarte usor componentele defecte. **IMPORTANT** – Inainte de a deschide aparatul , sau a dezansambla orice parte , trebuie **OBLIGATORIU** sa cereti acordul in scris al furnizorului. Orice defectiune cauzata de interventiile neavizate duce la pierderea garantiei .



- a) Raportati problema aparuta telefonic 0721674272 sau prin email la technical.support@signatureozone.com si emilvancea@yahoo.com
- b) Puteti trimite si fotografii sau video pentru explicarea problemei .
- c) Furnizorul va asigura repararea problemei in max. 3 zile lucratoare

2. Tineti cont ca orice defectiune cauzata de abuz sau de nerespectarea indicatilor de urtilizare nu pot fi acoperite de polita de garantie . Este responsabilitatea proprietarului de a asigura transportul in conditii de siguranta, relocarea , instalarea, exploatarea, intetinerea si igiena .

General Information

Urmatoarele simptome pot aparea in primele 3 zile de utilizare a programului de detoxifiere: ·Dureri de cap , de plamani ; Greaa ; dureri articulare ; oboseala ‘

Contra-indicatii: Urmatorii pacienti NU trebuie sa folseasca sauna:

- Pacientii forte slabiti , tinuiti la pat,
- Persoanele care sufera de TBC
- Femeile gravide

- Cei care folosesc un pacepacemaker
- Suferinzii active de hyperthyroidism
- Persoanele alergice la ozon
- Trombocite dezordonate

Intotdeauna luati tensiunea persoanei inainte de tratament. In cazul in care aceasta este mare , trebuie mai intati stabilizata inainte de inceperea tratamentului . Normal BP is 120/80 or 100/60
All Other Immunity –related Lifestyle Diseases

Session	Steam	Ozone	Temp	Time	Pulse
1	80%	30%	38	30min	120
2	80%	30%	38	30 min	120
3	80%	40%	39	30 min	120
4	90%	40%	39	30 min	120
5	90%	40%	40	30 min	120
6	90%	50%	41	30 min	120
7	100%	50%	42	30 min	120
8	100%	50%	42	30 min	120
9	100%	50%	42	30 min	120
10	100%	50%	42	30 min	120

Trebuie sa tineti seama ca tabelul de mai sus este doar de orientare generala .

Recomandari:

- Intotdeauna luati tensiunea persoanei inainte de tratament.
- Vitamin C - 2000mg trebuie luata la 3 ore dupa tratament
- Daca o persoana incepe sa tuseasca trebuie sa-I administram o doza de 4000mg Vitamin C . Tusea se va opri in cateva minute.
- Nu folositi sauna timp de 1 ½ ore dupa luarea mesei .
- Mentineti nivelul de ozon scazut (20%) cand tratati suferinzi de diabet. Un nivel crescut de ozon poate afecta nivelul insulinei. Daca este posibil monitorizati nivelul de zahar din sange inainte si dupa tratament
- Aburul trebuie mentinut la 80% pentru a proteja piciorul diabetic. Daca persoana tratata este in varsta , trebuie sa avem mai multa grija in monitorizarea pulsului.
- Daca o persoana tratata nu isi simte picioarele , un prosop trebuie sa-i fie infasurat in jurul picioarelor inainte de inceperea tratamentului, cu scopul de a-l proteja impotriva aburilor .

Contra-Indicatii

Orice caz este diferit. Daca in orice moment in timpul monitorizarii pulsului, se observa o scadere, si nu o crestere, a acestuia , tratamentul trebuie incheiat imediat. Daca apare senzatie de mancarime a pielii sau senzatie de arsura pe zona cu infectie, tratamentul trebuie incheiat imediat . In timpul tratamentului trebuie sa consumam minim un pahar cu apa sau cu ceai . La sfarsitul sedintei de tratament sa bem alte 2 pahare cu apa sau cu ceai .

In timpul sedintei de tratament stergeti transpiratia de pe fata pacientului .

NB: O persoana sub tratament diabetic sau orice alta medicamentatie , nu poate efectua sedinta de tratament mai devreme de 4 ore dupa administrarea medicamentatiei prescrise .

Session	Steam	Ozone	Temp	Time	Pulse
1	60%	30%	28	30 min	Start of session+8 beats
2	60%	30%	28	30 min	Start of session+8 beats
3	65%	30%	29	30 min	Start of session+10 beats
4	65%	30%	29	30 min	Start of session+10 beats
5	70%	30%	30	30 min	Start of session+12 beats
6	70%	30%	30	30 min	Start of session+12 beats
7	75%	30%	31	30 min	Start of session+14 beats
8	75%	40%	31	30 min	Start of session+16 beats
9	75%	40%	32	30 min	Start of session+20 beats
10	75%	50%	32	30 min	Start of session+24 beats

Trebuie sa tineti seama ca tabelul de mai sus este doar de orientare generala .

Intotdeauna luati tensiunea persoanei inainte de tratament. In cazul in care aceasta este mare , trebuie mai intati stabilizata inainte de inceperea tratamentului . Normal BP is 120/80 or 100/60

Atunci cand tratam pe cineva cu problem cardiac sau care a suferit un atac vascular cerebral trebuie sa folosim doar un nivel scazut de ozon la temperature scazute .

Fiti atenti la pulsul persoanei - pulsul trebuie monitorizat la fiecare 2 minute si trebuie sa creasca foarte putin cu fiecare sesiune .