

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: “ 20.05.2021

Alternativa Nr.: Nu se oferă

Către: CAPCS

[numele deplin al autorității contractante]

IM „Vivamed Internațional” SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. - nu au avut loc.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) **IM „Vivamed Internațional” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri :”Achizitionarea dispozitivelor medicale

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

1 911772,0000 lei MD.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

2 294126,4000 lei MD.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA 4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, **IM ”Vivamed Internațional” SRL** angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat:

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.

Nume: Valeriu Beregoi

În calitate de: Director

Ofertantul: IM „Vivamed Internațional” SRL

Adresa: mun.Chișinău, str.Bogdan Voievod,7

Data: “20” mai 2021

Specificații tehnice (F4.1)									
Numărul licitației:			LP nr.21038337			Data: „20” mai 2021		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)			Lot:		Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			
1	2	3	4	5	6	7	8		
3310000-1	1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)				Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mișcare și multiple configurări. Aria largă de mișcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului și a stativului vertical permit expunerii de la cap până la degetul piciorului fără să fie necesară re poziționarea pacientului. Parametru Specificația Modul radiologic Digital Detector unic da Tip masă Tip Pedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinală, cm ≥110 Laterală, cm ≥25 Fața mesei Densitatea mesei ≤1,7 mm Al Greutatea maximă a pacientului , kg ≥250 Suportul mesei Pedestal Sistem de control electromagnetic Lungimea suprafeței mesei ≥210 cm Lățime suprafeței mesei ≥ 80 cm Distanța maximă de la suprafața mesei până la podea ≤ 70 cm Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm ≥43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) 3 cimpuri Raportul grilei ≥10:1 Deplasarea longitudinală, cm 50 BUCKY vertical Dimensiunea, cm ≥43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) da Raportul grilei ≥10:1 Distanța minimă a centrului unității de raze X de la podea ≤ 50 cm			
			Multix Impact	Germania	Siemens	Conform Anexei Nr.1	CE,ISO		

33100 00-1	5	Lâmpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan	STARLED 3 NX	Italia	Fazzini	Lâmpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan Parametru Specificare Gradul de iluminare a unei suprafețe 120,000-160,000 lux Diametrul câmpului de iluminare 22 – 30 cm (opțiuni: circular sau oval) Reglarea câmpului de lucru "Reglarea mărimii câmpului de lucru și iluminarea menținând o temperatură de culoare dată" temperatura de culoare 3800 – 4800 K, variabil Reglabilă Indicele de redare a culorilor 95 Adâncimea iluminării > 80 cm Surse de lumină LED-uri performante prevenirea apariției umbrelor de culoare Durata de viață a LED-urilor 25,000 ore Operare Sterilă prin senso Grip Nesteril prin intermediul panoului sensoTouch Apertura 1,8 – 2,1 Senzor 1/3 tip HD CMOS Focalizarea Automată inclusă Balans de alb Automat /manual Nivel de strălucire Automat /manual Signalul Video SD NTSC (CROP), NTSC (SQUEEZE); PAL Umeditatea de lucru de la 20% până la 80% Protecția împotriva interferențelor electrice și radio în corespundere cu FCC class A Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător obligatoriu Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila	Conform Brosurii anexate	CE,ISO		
---------------	---	--	-----------------	--------	---------	---	--------------------------	--------	--	--

Specificații tehnice (F4.2)

Numărul licitației: LP nr. 21038337

Data: „20” mai 2021 Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)

Lot: _____ Pagina: _____ din _____


Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4,00	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	buc	1	1674972,00	2 009 966,4000	1 674 972,0000	2 009 966,4000	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	5	Lămpa chirurgicală pentru sala de operație cu prindere tavan	Lămpa chirurgicală pentru sala de operație cu prindere tavan	buc	1	236800,00	284 160,0000	236 800,0000	284 160,0000	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
Total in lei MD:								1 911 772,0000	2 294 126,4000	

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7

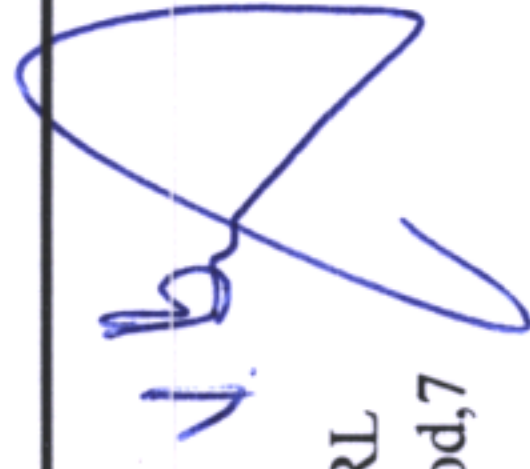

IM Vivamed International SRL partener autorizat a firmei Siemens

prezentă

Sistem radiografic digital LP

Multix Impact de firma Siemens

Cod CPV 3310000-1 lot 1

<https://www.siemens-healthineers.com/radiography/digital-x-ray/multix-impact>

Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mișcare și multiple configurări. Aria largă de mișcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului și a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară re poziționarea pacientului. Parametru Specificația Modul radiologic Digital Detector unic da Tip masă Tip Pedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinală, cm ≥ 110 Laterală, cm ≥ 25 Fața mesei Densitatea mesei $\leq 1,7$ mm Al Greutatea maximă a pacientului , kg ≥ 250 Suportul mesei Pedestal Sistem de control electromagnetic Lungimea suprafeței mesei ≥ 210 cm Lățime suprafeței mesei ≥ 80 cm Distanța maximă de la suprafața mesei până la podea ≤ 70 cm Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm $\geq 43 \times 43$ Controlul automat al expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei $\geq 10:1$ Deplasarea longitudinală, cm 50 BUCKY vertical Dimensiunea, cm $\geq 43 \times 43$ Controlul automat al expunerii (AEC) da Raportul grilei $\geq 13:1$ Distanța minimă a centrului unității de raze X de la podea ≤ 50 cm Deplasarea longitudinală, cm ≥ 180 cm Detector Mărimea detector, cm $\geq 43 \times 43$ Configurare detector Fără fir da Caracteristicile detectorului Rezoluția matricei, pixeli $\geq 3072 \times 3072$ Mărimea pixelului ≤ 140 μm Panou de control Selectarea automată a parametrilor da	Multix Impact de firma Siemens, Germania Datele Tehnice in Data sheets. Da Corel XL P10 Pagina 5 Da Da 190 28 $\leq 0,7$ mm Al 300 Da Da 233 80 70 Da 43s43 3 Da 100 Pagina 6 43x43 Da Da 33 180 Pagina 10 43x43 Da 3070 x 3070 139 Da
---	---

Post-procesarea anatomică specifică da	Da
Procesarea manuală da	Da
Procesarea avansată da	Da
Generator de raze X ≥55kW	Pagina 6 55KW
Diapazon kV generator 40-150kV	40-150
Sistem de control al încărcării termice a tubului cu protecție împotriva suprasolicitării Da	Da
Cobntrol automat al expunerii Da	Da
Diapazon mAs ≥0,5-500	0.5 mAs to 800 mAs
Timp de expunere maxim ≥ 10 sec	10 sec
Timp de expunere minim ≤ 0,001 sec	0,001
Tubul de raze X	Pagina 7
Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 600 mA	550 mA at 100 kV
Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2	.6 și 1.2
Capacitatea termică, KHU ≥200	1370
Rata de răcire, HU/min ≥1250	97000
Panou de control pe tubul radiologic da	Da
DAP metru da	Da
Accesorii	Da
Sticlă plumbată minim 1x0,8 m	1x0,8m
Guleraș de protecție, 0.3 grosimea stratului de plumb 2 seturi	2
Sort de protecție, 0.5 grosimea stratului de plumb 3 seturi	3
Imprimanta Procesare tip Termal direct da	Da Agfa DS5302 Germania
Interfa DICOM	Da
Rezoluție spațiale, >12 Pixeli/mm	12,5
Format film, cm "20x25 -35 x43:	20x25 -35 x43
Format hartie A4"	Da
Formate disponibile simultan >2	2
Viteza imprimare cca 100 filme/h	130
Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 da	Da
Cerințe față de alimentarea electrică Standard	Da
Statia de lucru	Pagina 12
CPU ≥3.0 Ghz, ≥2 cores	Intel Core™ i5-6500TE 3.30 GHz,
Video card ≥ 2Gb	Da
OS Windows 10 sau similar	Operating system Windows 10 64 bit
DVD-RW da	Da
RAM ≥4Gb	DDR4 8 GB memory
Hard disc (HDD) ≥2x500Gb	2 x 500 G SATA HDD
LAN 100/1000 Mbps	Da
USB port ≥4	4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
PACS compatibil	Da
DICOM 3.0 da	Da
Monitor medical ≥19 inch, ≥1MP	23,8"
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată	

prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	
--	--

Director Beregoi Valeriu

Im Vivamed International SRL