


			Specificații tehnice						
			va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 6, 8						
Numărul licitației:			LP nr. 21233426					Data: „27,06,2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT					Pagina: __ din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplăă ofertată	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100 000-1	55	Bonetă chirurgicală bărbați	Bonetă chirurgicală bărbați	GT058-301	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	DM000372733
33100 000-1	60	Cateter de aspiratie CH 6	Cateter de aspiratie CH 6	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	DM000372568
33100 000-1	85	Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil)	Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil)	Medical Drape 200x150cm, GT160-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1) material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150 cm (+/- 5cm) Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate	1) material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150 cm (+/- 5cm Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate	DM000372741
33100 000-1	86	Container anatomo-patmorfologic 1000 ml	Container anatomo-patmorfologic 1000 ml	1000 ml	RM	Santino Service	1.Volum Total: 1000 ml (+-50ml) 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	1.Volum Total: 1000 ml (+-50ml) 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	Aviz sanitar
33100 000-1	87	Container anatomo-patmorfologic 200 ml	Container anatomo-patmorfologic 200 ml	200 ml	RM	Santino Service	1.Volum Total: 200 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	1.Volum Total: 200 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	Aviz sanitar
33100 000-1	89	Container anatomo-patmorfologic 500 ml	Container anatomo-patmorfologic 500 ml	500 ml	RM	Santino Service	1.Volum Total: 500 ml (+-25ml) 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	1.Volum Total: 500 ml (+-25ml) 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	Aviz sanitar

33100 000-1	93	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Hydrophilic Nitinol Guidewire 536040	Turcia	Plasti-Med	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	DM000689894
33100 000-1	105	Scutece (pelinci)	Scutece (pelinci)	Scutece bumbac	RM	Deniadi	Țesătură bumbac, 70cmx70cm	Țesătură bumbac, 70cmx70cm	Aviz sanitar
33100 000-1	122	Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH	Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH	539006	Turcia	Plasti-Med	1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm	1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm	DM000689891
33100 000-1	123	Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH	Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH	539007	Turcia	Plasti-Med	1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm	1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm	DM000689891
33100 000-1	126	Sistem pentru respirație artificiala manuala sac Ambu	Sistem pentru respirație artificiala manuala sac Ambu	GT012-300C	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml	Transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml	DM000372595
33100 000-1	135	Stickere pentru marcajul medicamentelor	Stickere pentru marcajul medicamentelor	Mega Star	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Stickere p/u marcasele seringelor din hîrtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite	Stickere p/u marcasele seringelor din hîrtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite	DC
33100 000-1	136	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți	GT014-800	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil	DM000372547
33100 000-1	137	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal	GT014-800	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil	DM000372545
33100 000-1	138	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric	GT014-800	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil	DM000372546

[illegible]

[illegible]

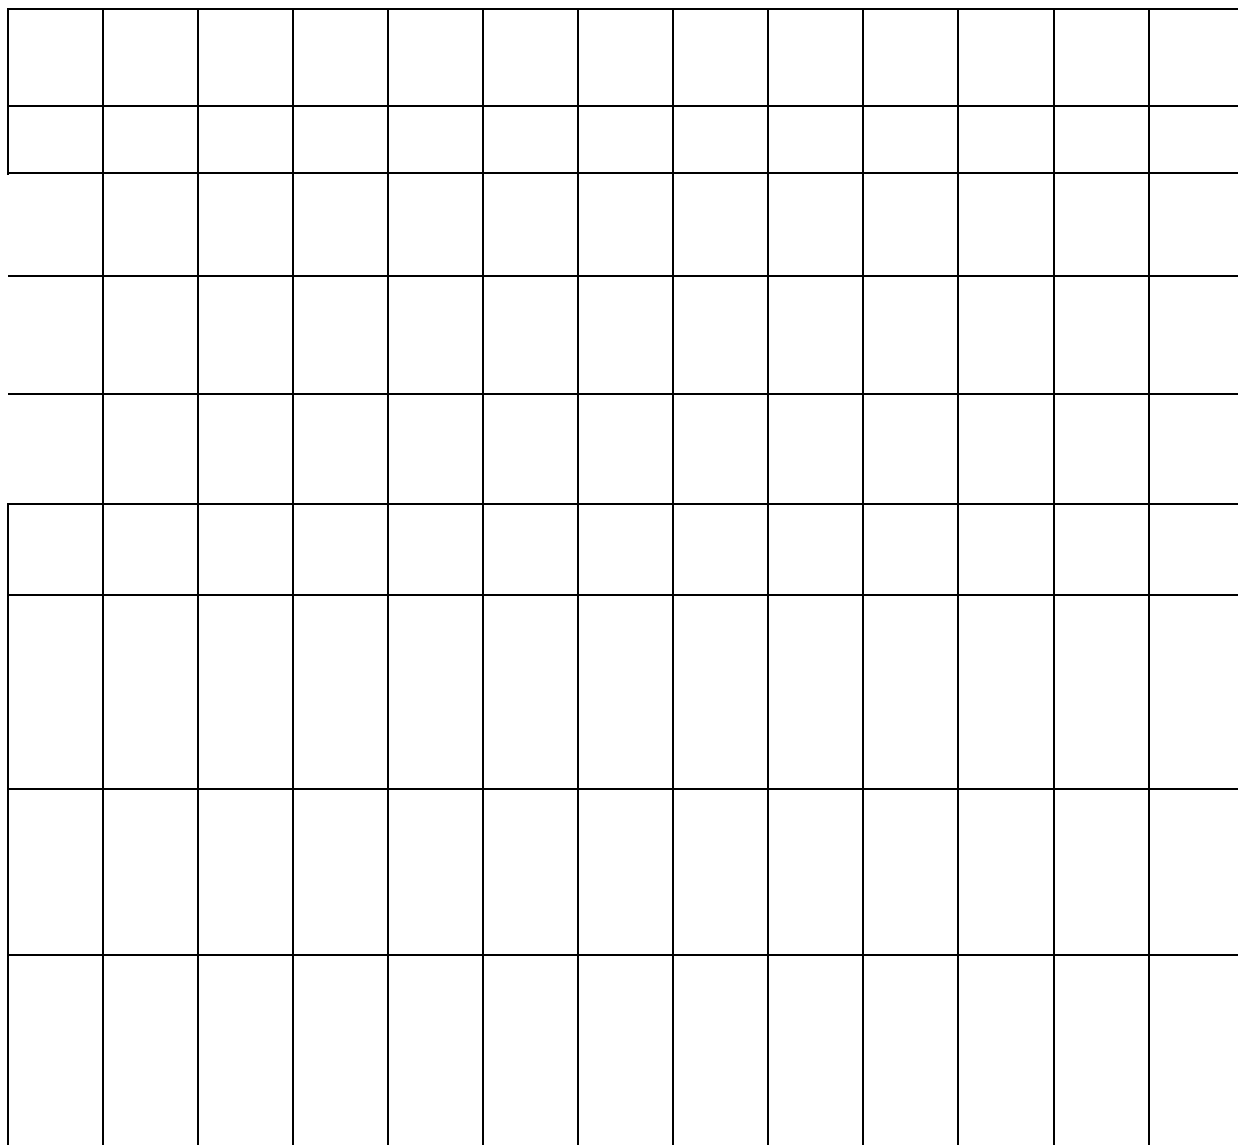

[illegible]