

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 09.09.2020

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1597320398671

Către: **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L declară că:

- a. Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificări nu au fost.

Societatea cu răspundere limitată Romedcom S.R.L se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri „ Stație de producere a oxigenului medical”.

Prețul total al ofertei constituie: **3.570.000,00 MDL** (trei milioane cinci sute șapte zeci mii lei, 00 bani) **MDL**, fără TVA.

Cu TVA constituie: **4.284.000,00 MDL** (patru milioane două sute optzeci și patru mii lei, 00 bani) **MDL**.

- b. Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c. În cazul acceptării prezentei oferte, Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.
- e. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: Ștefan Țurcanu

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „Romedcom„S.R.L

Adresa: Republica Moldova,

Data: 09.09.2020



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1597320398671 / 21027284

Denumirea procedurii de achiziție: «Stație de producere a oxigenului medical»

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
					1. STAȚIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL: 1 buc.		CE/ISO
		POC 8500 med	Germania	Inmatec	Metoda de obținere a oxigenului	Pressure Swing Adsorption (PSA)	da
					Puritatea oxigen	93%, +/- 3 %	93%
					Debit de oxigen la concentrația de 93%	≥ 35 mc/ora	37.3 mc/h
					Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între	0,1 – 6,0 bar	da
					Alimentarea electrică	220 V / 50 Hz	da
					Presiune intrare aer comprimat, minim	4.0 bar	da
					Presiune intrare aer comprimat, maxim	10 bar	da
					Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și straturile de ozon	da	da
					Panou central de comandă – touch screen – mărime minimă	Min. 3,5 inch	8.4 inch
					Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen	da	da
					Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatorul de oxigen	da	da
		MICROX % ZR 96	Germania	Inmatec	Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă	da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium	da
					Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator	da	da
					Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare	da	da

1. Stație de producere a oxigenului medical

42900000-5

				Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP a parametrilor de bază	da	da		
				Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP, cu licență nelimitată	da, înscris pe CD sau flash	da		
				Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră)	da	da		
				Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului	da	da		
				Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90%	da	da		
				Alarmă acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator	da	da		
				Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului	da	da		
				Alarmarea acustică și vizuală în momentul depășirii punctului de rouă	da	da		
				Memorarea internă a tuturor datelor și parametrilor de funcționare (minim 2 ani)	da	da		
				Memorarea internă pe termen (minim 2 ani) a tuturor alarmelor cu data și ora care s-au produs	da	da		
				Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC	da	da		
				Senzor de temperatură	da	da		
				Senzor de presiune la intrare și la ieșire	da	da		
				Senzor pentru măsurarea punctului de rouă	da	da		
				Marcaj de conformitate tip CE	da	da		
				Gazul (oxigenul) produs să îndeplinească cerințele standardului	EN ISO 13485	da		
					ISO7396-1:2016	da		
				Montat prealabil în container	da	da		

			Toata tubulatura generatorului de oxigen sa fie din otel inoxidabil (inox)		da	da		
Buffer veseli OGP	Belgia	Atlas Copco	2. REZERVOR DE OXIGEN: 1 buc.		da			
			Capacitatea	Min. 2000 litri	2000 L			
			Rezervor special destinat pentru oxigen	da	da			
			Presiunea de lucru suportată de vas	6 bar	da			
			Presiunea maximă de lucru suportată de vas	11 bar	da			
			Supapă de siguranță și manometru de presiune	da	da			
			Montat prealabil în container	da	da			
			Marcaj de conformitate tip CE	da	da			
			Produs conform Directivei Europene	97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE	da			
TGA 110/16 C ₁	SUA	Parker	3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL: 1 buc.					
			Debit filtrare oxigen	min. 7 bar	da			
			Presiune de lucru maximal	min. 11 bar	da			
			Filtru reținere particule solide	Până la 0,01 μm	da			
			Manometru indicator colmatare	da	da			
			Montat prealabil în container	da	da			
			Marcaj de conformitate tip CE	da	da			
ZT55-10	Belgia	Atlas Copco	4. SISTEM AER COMPRIMAT: 1 buc.		da			
			Compresor profesional oil-free	da	da			
			Bloc comprimare aer să fie montată direct pe motor (fără cura de distribuție)	da	da			
			Calitatea aerului comprimat să corespundă standardelor	ISO 1217 sau ISO 8573-1:2010-1.4.1	da			
			Presiune de lucru normală, reglabilă	Min. 10 bar	da			
			Debit	Min. 6,6 m3/min.	7,4 m3/min.			

			Alimentare electrică	380 V / 50 Hz	da			
			Putere motor electric	minim 55 kW	da			
			Clasa izolare / grad protecție motor	F / IP 55	IP 55			
			Nivel de zgomot	Max 72 dB (A)	76 dB			
			Temperatura mediului ambiant	+5°C – +45°C	da			
			Umiditatea relativă	65% - 75%	da			
			Sistem de răcire cu aer sau agent termic	da	Cu aer			
			Control al rotației (protejat la inversarea de faze)	da	da			
			Valvă de admisie electropneumatică	da	da			
			Elemente de siguranță pentru supracălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C	da	da			
			Sistem repornire automată în caz de cădere de curent	da	da			
			Sistem comandă electronic cu display	da, ecran min. 3,5 inch	3,5 inch			
			Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori	da	da			
			Indicatori pentru : presiune și temperatură	da	da			
			Contor pentru : număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare	da	da			
			Montat prealabil în container	da	da			
			Marcaj de conformitate tip CE	da	da			
			5. SISTEM USCARE AER COMPRESAT : 1 buc.					
F D 180 VSD	Belgia	Atlas Copco	Presiunea normala de lucru	min. 7 bar	da			
			Presiune de lucru suportată de uscător	min. 11 bar	da			
			Capacitate de uscare	min. 630 mc/ora	648 mc/h			
			Agent frigorific	Ecologic	da			
			Punct de rouă garantat	+3 – +5°C	3 C			
			Alimentare electrică	220 V / 50 Hz	da			
			Temperatura mediului ambiant	+5 – +45°C	da			


			Separator de condens cu purjare automată	da	da				
			Uscătorul să funcționeze în regim continuu	da	da				
			Montat prealabil în container	da	da				
			Marcaj de conformitate tip CE	da	da				
			6. REZERVOR DE AER COMPRESAT: 1 buc.						
LV 2000	Belgia	Atlas Copco	Rezervor galvanizat	da	da				
			Capacitatea	Min. 2000 litri	2000 l				
			Presiunea de lucru suportată de vas	min. 7 bar	da				
			Presiunea maximă de lucru suportată de vas	min. 11 bar	da				
			Supapă de siguranță și manometru de presiune	da	da				
			Separator de condens cu purjare automată	da	da				
			Montat prealabil în container	da	da				
			Marcaj de conformitate tip CE	da	da				
			Galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu Produs conform Directivei Europene	ISO 1461 PED 97 / 23 / EEC	da				
			7. SISTEM FILTRARE AER COMPRESAT: 1 buc.						
UD+140, Pdp 130+	Belgia	Atlas Copco	Filtru reținere particule solide până la 0,1 µm	da	da				
			Filtru reținere particule solide până la 0,01 µm	da	da				
			Capacitate filtre	min. 630 mc/ora	648 mc/ora				
			Montat prealabil în container	da	da				
			Marcaj de conformitate tip CE	da	da				
			8. CONTAINER: 1 buc.						
			Totale sistemele în ansamblu (1-7) să fie montate în container	da	da				
			Sistem de climatizare calculat astfel încât să mențină temperatura optimă în interiorul containerului	da	2 conditionere cu capacitatea de 9000 Btu/h				

				Containerul va fi instalat sub cerul deschis, se va ține cont de hidroizolare și termoizolare	da	da			
				Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat	da	da			
				Sistem de iluminare pe interior	da	da			
				Containerul va fi tratat și vopsit pe suprafață cu scop de prevenire a coroziunii	da	da			
				CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN					
				Să fie inclus toate conductele necesare (tavă, cablu electri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen	da	da			
				Toate aprobările și autorizările necesare p/u instalare și punerea în exploatare a stației de oxigen sunt efectuate de agentul economic. Cheltuielile necesare p/u acest proces de asemenea sunt asumate de agentul economic.	da	da			
				Să dețină certificat privind conformitatea cu ISO 9001:2008 (Managementul calității)	da	da			
				Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE	da	da			
				Termen de garanție	Min. 24 luni	da			
				Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate)	da	da			
				Instalarea unui bioinginer în procesul de utilizare tehnica a sistemului cit și de efectuarea lucrarilor de mentenanță preventiva si corectiva	da, obligatoriu	da			
				Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sistemului cit și de efectuarea lucrarilor de mentenanță preventiva si corectiva	Min. 12 luni	da			

					Sa fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna functionare a sistemului in decurs de un an	da	da		
					Prezentarea graficului de inlocuire a tuturor consumabilelor, piselor necesare conform recomandarii producatorului pe parcursul a 5 ani, cu indicarea pretului pentru fiecare pozitie	da	da		

Semnati:  Numele, Prenumele: Stefan Turcanu in calitate de: Administrator

Oferantului: "Romedcom", SRL Adresa: Scusev 16, of 6





Specificații de preț (F 4.2)

Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1597320398671					Data: 09.09.2020		Alternativa nr.:		
Denumirea licitației: Stație de producere a oxigenului medical					Lot: 1		Pagina: 1 din 1		
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitătea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 1 : Stație de producere a oxigenului medical									
1	42900 000-5	Stație de producere a oxigenului medical	Bucată	1	<u>3.570.000,00</u>	<u>4.284.000,00</u>	<u>3.570.000,00</u>	<u>4.284.000,00</u>	în decurs de 90 zile
TOTAL pe ofertă:									

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Turcanu Ștefan În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Romedcom” SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciușeva 16, of.6

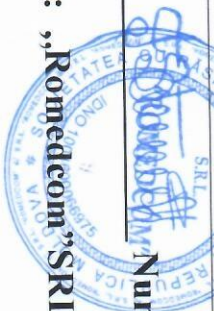

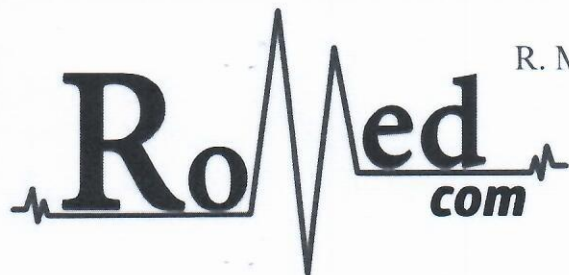

R. Moldova, mun. Chișinău, str. Sciusev 16, of. 2 MD-2001;

Codul Fiscal (IDNO): 1004600066975;

Cod TVA: 0405126

Tel/Fax +373 (22) 530195

GSM: + 37360106007 + 37379807733 + 37379422107


email: office@romedcom.md; service@romedcom.md


Declarație

Prin prezenta, compania Romedcom SRL participant la procedura de achiziție prin licitație publică nr. 21027284 din data de 09.09.2020, organizată de către IMSP Institutul de Medicina Urgenta, garantează pe propria răspundere că termenul de garanție este de 24 luni din data instalării.

Cu respect,

Romedcom SRL

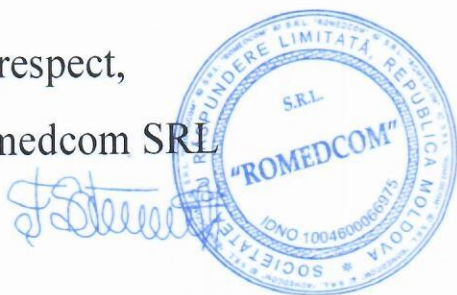

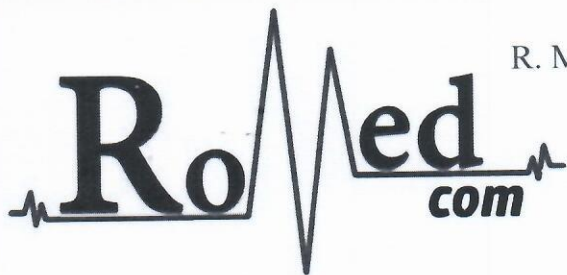

R. Moldova, mun. Chișinău, str. Sciusev 16, of. 2 MD-2001;

Codul Fiscal (IDNO): 1004600066975;

Cod TVA: 0405126

Tel/Fax +373 (22) 530195

GSM: + 37360106007 + 37379807733 + 37379422107

email: office@romedcom.md; service@romedcom.md


Declarație

Prin prezenta, compania Romedcom SRL participant la procedura de achiziție prin licitație publică nr. 21027284 din data de 09.09.2020, organizată de către IMSP Institutul de Medicina Urgenta se obligă de a instala și de a instrui personalul beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate.

Cu respect,

Romedcom SRL



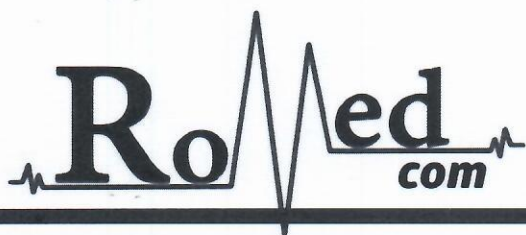

R. Moldova, mun. Chișinău, str. Sciusev 16, of. 6 MD-2001;
Codul Fiscal (IDNO): 1004600066975; Cod TVA: 0405126
Tel/Fax +373 (22) 530195 GSM: + 37360106007
+ 37379807733
email: romedcom@gmail.com

Declarație

Descriere la construcția modulară

Prin prezenta, compania Romedcom SRL participant la procedura de achiziție prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1597320398671 din data de 09.09.2020, organizată de către IMSP Institutul de Medicina Urgenta, garantăm următoarele:


- Gabarite: 4x9m, H=3,5m.
- Carcasă: construcție metalică din țevi profilate 10x10x3cm.
- Pereți: panouri de tip Sandwich grosime 10cm, Ferestre, usa - termopan
- Acoperiș: Structura din ferme metalice si panouri de tip Sandwich grosime 10cm.
- Pardoseala: Sapa de beton

„Romedcom” SRL

Administrator

Ștefan Țurcanu



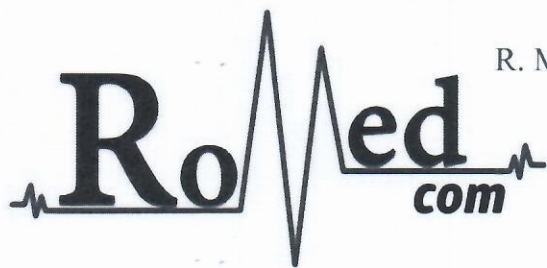

R. Moldova, mun. Chișinău, str. Sciusev 16, of. 2 MD-2001;


Codul Fiscal (IDNO): 1004600066975;

Cod TVA: 0405126



Tel/Fax +373 (22) 530195

GSM: + 37360106007 + 37379807733 + 37379422107



email: office@romedcom.md; service@romedcom.md

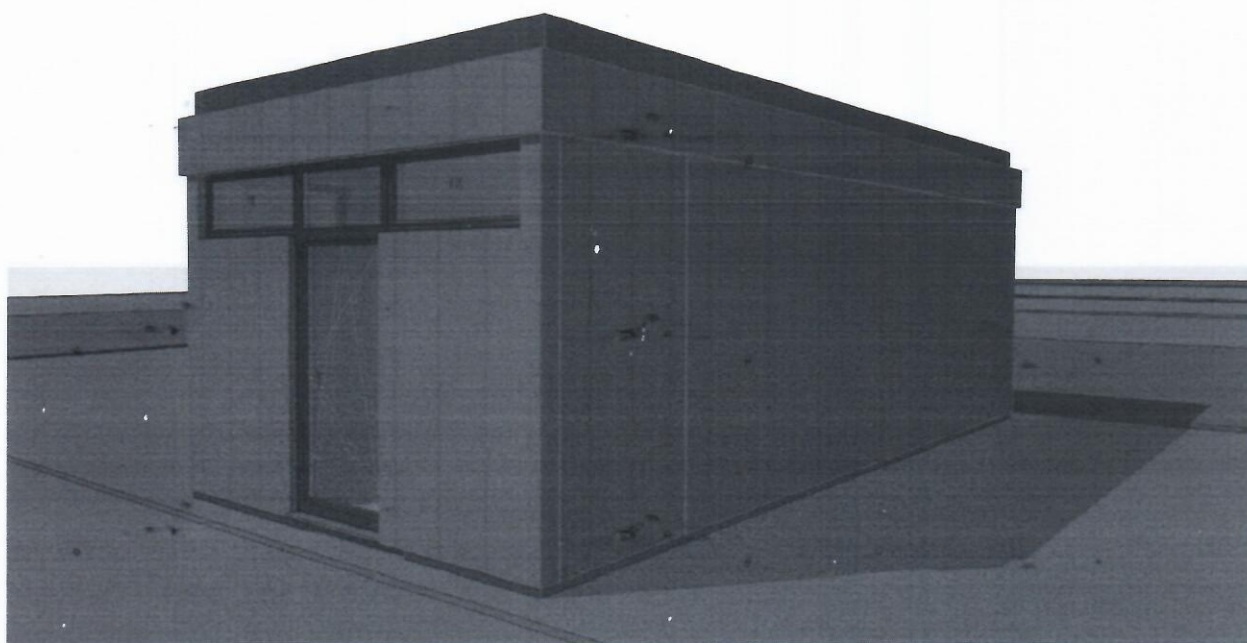

ROMEDCOM SRL

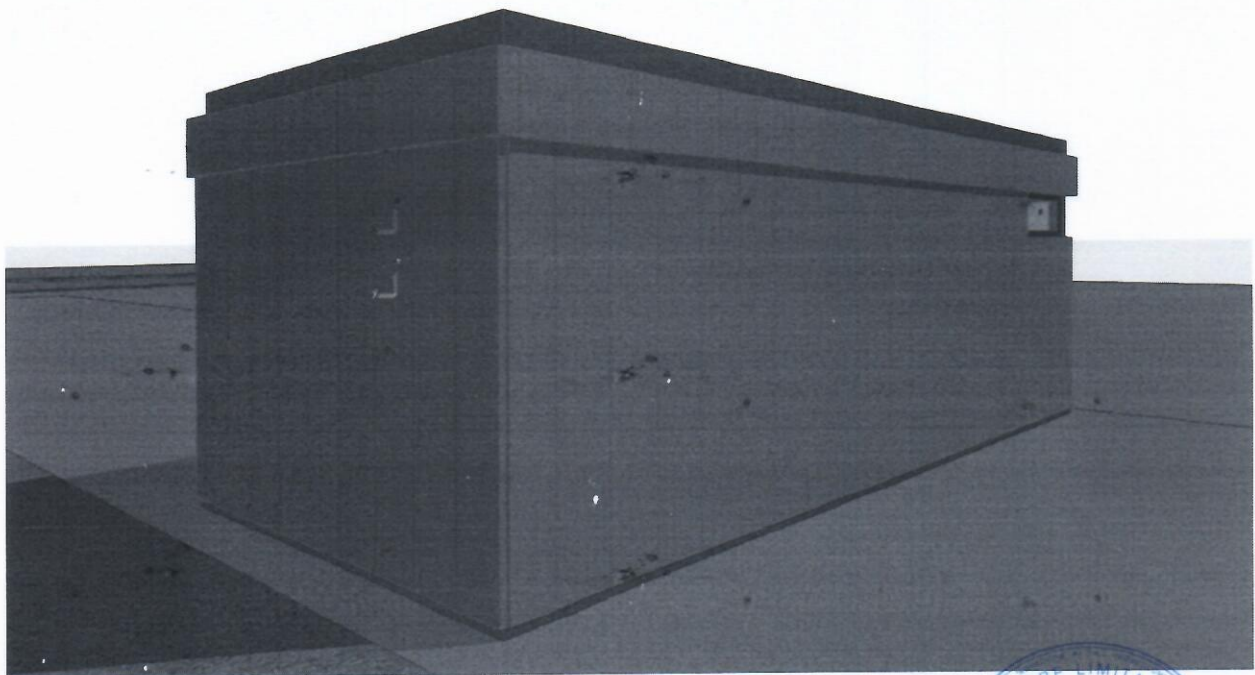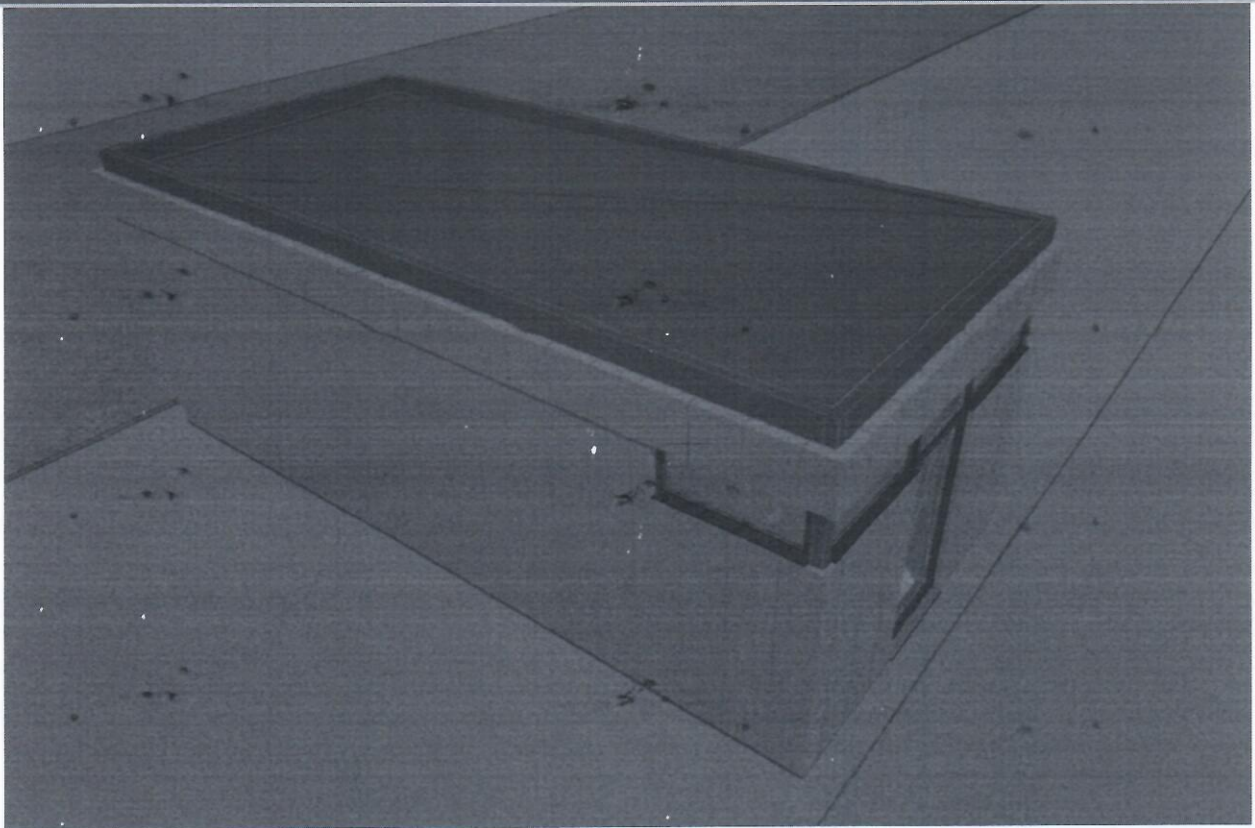

ROMEDCOM SRL

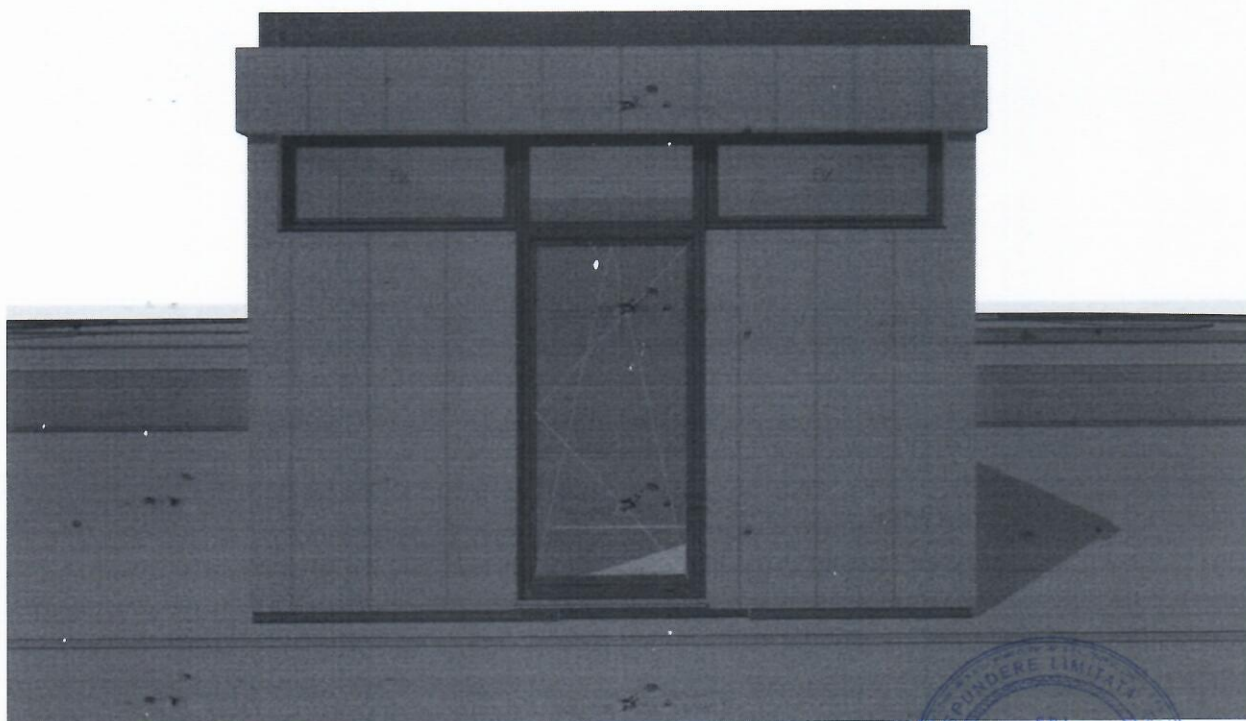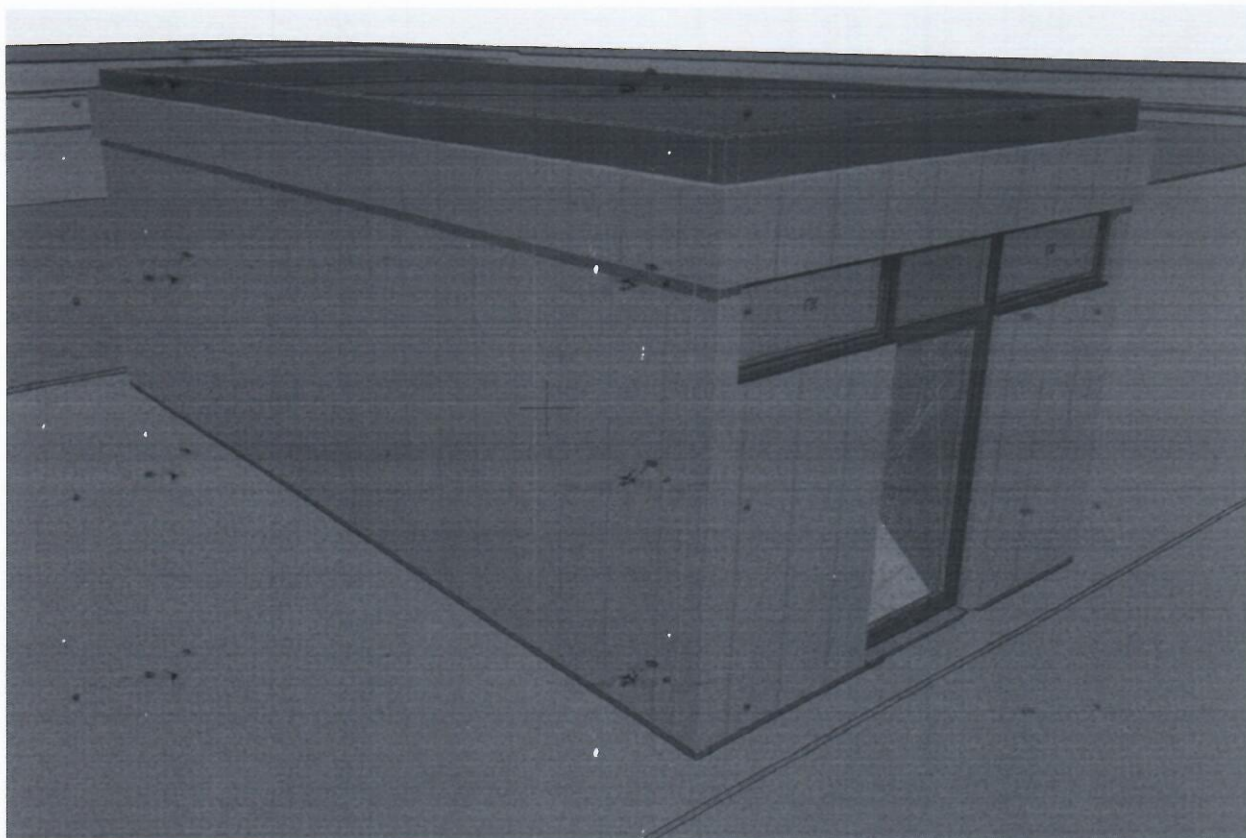

ROMEDCOM SRL

Plan de mentenanță stație O2

Compresor ZT 55-10 Pack			
1.	Kit service 2230011301	4000 h	15000
2.	Kit service 2230004100	8000 h	10000
3.	Kit service 2230004101	8000 h	1000
4.	Kit service 2230011309	8000 h	25000
Uscător FD 180 VSD			
5.	Kit wear drain 22009021	4000 h	5000
Set filtre			
6.	Filtru UD 140+9	4000 h	20000
Generator POC 8500			
7.	Sensor O2	24000 h	100000
8.	Set valve	24000 h	100000
9.	Filtre intrare	8 000 h	25000

[Handwritten signature]

