






DATASHEET

UNIVERSAL SET FOR BIG SURGICAL OPERATIONS




	ITEM	SIZE	MATERIAL	DETAILS	PIECE
	Instrument Table Cover	150x190	SMS	Reinforced	1
	Mayo Stand Cover	80x145	SMS	Reinforced	1
	Absorbent Towel	40x40		Non-linting	2
	U Split Drape	200x310	* Material: SMS, resistance to water penetration > 50cm H2O/cm2	* Aperture 10x110cm (± 5cm) * Fabric impregnated with adhesive around aperture, width > 5cm * Absorbent pad around aperture, minimum resistance to water penetration 150cm H2O/cm2 * Tube holder - 4 pieces, SMS	1
	Top Drape	160x270	* Material: SMS, resistance to water penetration > 150cm H2O/cm2	* Fabric impregnated with adhesive prepped surgical site, width > 5cm * Absorbent pad around prepped surgical site, resistance to water penetration 150cm H2O/cm2	1
	Side Drape	100x105	* Material: SMS, resistance to water penetration > 150cm H2O/cm2	* Fabric impregnated with adhesive around prepped surgical site, width > 5cm * Absorbent pad around prepped surgical site, resistance to water penetration 150cm H2O/cm2	2
	OP Tape	10x50			1



- **REF:** Z10-072-01
- **Material:** SMS (Tolerance +/- 2%)
- Antiallergenic
- Air Permeable
- Water Repellent
- Non-Linting
- **Sterilization Type:** ETO Sterile
- **Shelf Life:** 5 years
- **Colour:** Blue
- **Packing:** ETO Pack



**ZENMED TIBBİ CİHAZLAR
VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.**
Mahmutbey Mah. 2567.Sk. No:1 İş Yeri No:11,21
Bağcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0212 445 45 25 T.C.Sic.No: 794704
Güneşli M.D.: 897 067 1942

DATASHEET

DELIVERY SET					
	ITEM	SIZE	MATERIAL	DETAILS	PIECE
	Laminated bed sheet	100x75			1
	Absorbent Towel	80x75			4
	Underpad	90x60		Bed protector pad	1
	Laminated Apron	ST			1
	Bouffant Bonnet	ST			1
	Surgical mask with earloop	ST		3 layers	1
	SMS Bedsheet	130x75			1
	Umbilical Clamp	ST			1
	Medical Cotton Roll	ST			2

- REF: Z10-016-01
- Delivery set containing items to be used by surgeon during delivery operations

DATASHEET

CESAREAN SET					
	ITEM	SIZE	MATERIAL	DETAILS	PIECE
	Instrument Table Drape	150x200	SMMS		1
	Cesarean Drape	200x300	2 layers	with fluid collection pouch	1
	Baby Drape	75x90	White SL	Wrapping sheet for newborn	1
	Umbilical Clamp	ST			1
	Reinforced Surgical Gown	L	SMS	Universal size	2
	Towel	40x40		for hands	2
	Bedsheet	100x100	SMS		1

- **REF:** Z10-018-01
- **Material:** Bilaminate, 2 layers
- **Outer Layer:** Liquid Absorbent Nonwoven
- **First Layer:** Barrier Medical PE keeps liquids and bacteria
- Impervious Medical Fabric made from multiple layers ensuring complete absorption of fluids at critical areas and an effective barrier to microorganisms
- Incorporate strong, hypoallergenic adhesive for fixation for the purpose of wound isolation
- Puncture resistant
- **Sterilization Type:** EO Sterile
- **Shelf Life:** 5 years



ZENMED

TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

www.zenmed.com.tr
info@zenmed.com.tr





ZENMED

TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



HAKKIMIZDA

ZENMED LTD.'NİN TARİHÇESİ

ZENMED tek kullanımlık örtü ve önlük setleri konusunda faaliyet gösteren bir üretim ve satış şirkettir. Merkezi İstanbul'da bulunan ZENMED tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Türkiye'nin özellikle sağlık konusunda yurt dışına bağımlılığını bilen ve bu konuda daha fazla duyarsız kalamayan firmamız; 2017 yılında üretim ve ihracat yapan firmalar arasında üst sıralardaki yerini almak amacıyla yola çıkmıştır.

En son teknolojiyle oluşturulmuş üretim ekipmanlarını, işinde uzman profesyonel çalışanlarıyla buluşturmayı başaran ZENMED, sektöründe 'Kalite' ve 'Dinamizm' olgularının ilk temsilcisi olmayı hedeflemektedir.

Konusunda deneyimli ve eğitimli yönetim kadromuz başta olmak üzere tüm ZENMED ailesinin ortak amacı; ürün bilginiz, üretim kabiliyetimiz, pazar tecrübemize dayanarak Sınıf 100.000 Temiz oda, ETO Sterilizasyon Ekipmanı gibi tüm teknik donanımımızı kullanıp kaliteli bir üretim yapmak, yeniliklere ve gelişmeye daima açık olarak yeni yatırımlara yönelmektir.

ABOUT US

ZENMED MEDICAL TEXTILE HISTORY

Zenmed is manufacturing and Sales&marketing Company for Sterile SURGERY Sets, Gown and Drapes. Our company head quarter is in Istanbul and we export to many countries around the World.

Since Our company realized that there is high demand and need for high quality Products for SURGERY Disposable Sets field, we began for investment on our facilities of manufacturing and marketing with high standards.

Our aim is to be the first representative of combining of "Quality" and "Dynamism" of the sector with his expert and professional crew who meet cutting edge technology for manufacturing.

With all of our experienced management , all Zenmed family's member's common purpose's is to manufacture high quality products, being open minded and open to development, with his high experience, ability together with using of our Class 100.000 Clean room, ETO Sterilization Equipment etc...

VİZYONUMUZ

Dünya standartlarında hijyenik koşullarda ürettiği kaliteli ürünleriyle sektöründe bilinen, takip edilen ve örnek gösterilen bir marka olmak

OUR VISION

Our vision is to be a brand as known, followed, and exemplified with his high quality products manufactured in our high standart hygienic facilities.

MİSYONUMUZ

En önemli değerimiz olan "Sağlık" için yüksek standartlarda, toplam kalite anlayışı içerisinde; gerek ürünlerimizle gerekse satış ve satış sonrası çalışmalarımızla toplum değerlerine saygılı bir hizmet anlayışını sınır tanımadan sunmak.

OUR MISSION

Our mission is to give unlimited service for our Health which is most valuable thing in our life with respecting of our society values for our products and also sales and after sales operations, with high standards and total quality management aspect.

İÇİNDEKİLER INDEX

10		GENEL CERRAHİ - GENERAL SURGERY
16		KARDİYOLOJİ - CARDIOLOGY
25		BEYİN CERRAHİ - BRAIN SURGERY
29		OFTOLMALOJİ - OPHTHALMOLOGY
32		KULAK BURUN BOĞAZ - EAR , NOSE AND THYROID
37		ORTOPEDİ - ORTHOPEDICS
48		JİNEKOLOJİ - GYNECOLOGY
56		ÜROLOJİ - UROLOGY
61		DİĞER SETLER - THE OTHER PACKS
72		CERRAHİ ÖNLÜKLER - SURGERY GOWNS
74		CERRAHİ ÖRTÜLER - SURGERY DRAPES



ZENMED

TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



**CERRAHİ
SETLER**


**SURGICAL
PACKS**



**GENEL
CERRAHİ**

**GENERAL
SURGERY**


Disposable Steril Genel Cerrahi Seti / Disposable Sterile Universal Pack

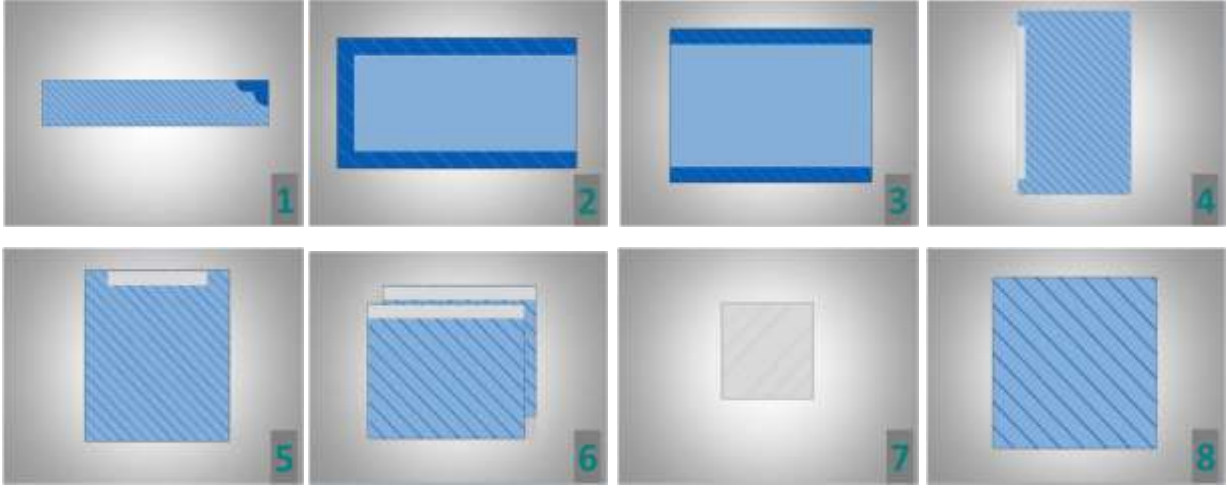

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
5	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180	1
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x120	2
7	Havlu / Towel	40x40	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.001.01


Disposable Steril Genel Cerrahi Seti - 2 / Disposable Sterile Universal Pack - 2

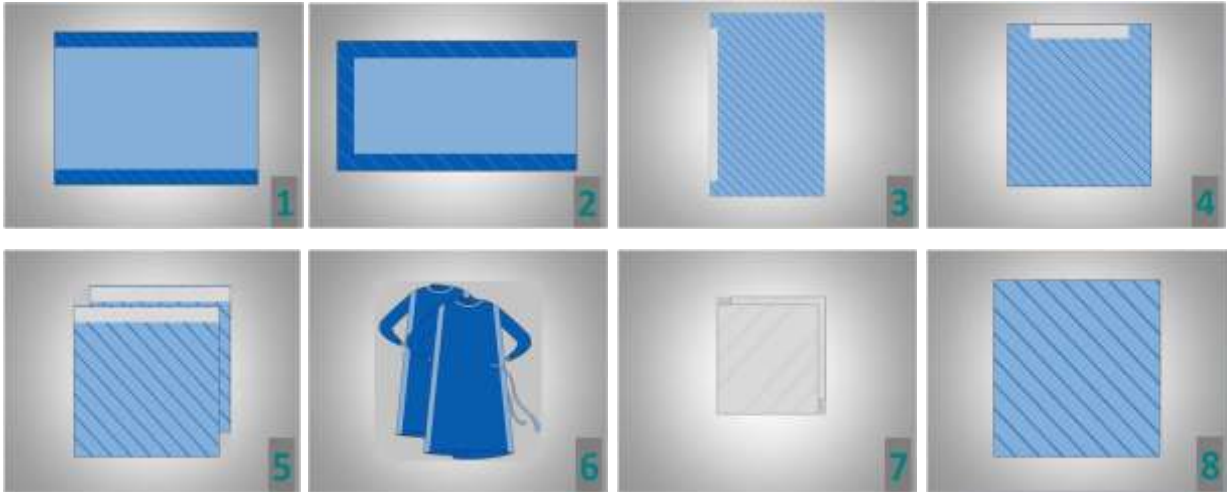

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
4	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180	1
5	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x120	2
6	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.072.01


Disposable Steril Genel Cerrahi Standart Seti / Disposable Sterile Universal Standard Pack

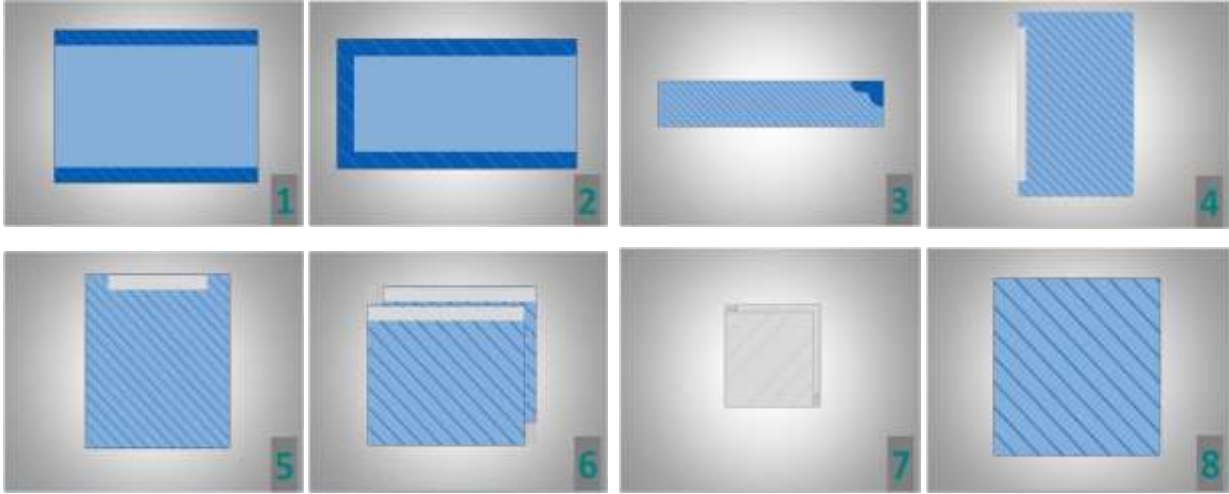

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
4	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
5	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	150x180	1
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.056.01

Disposable Steril Genel Cerrahi Temel Set / Disposable Sterile Universal Basic Pack

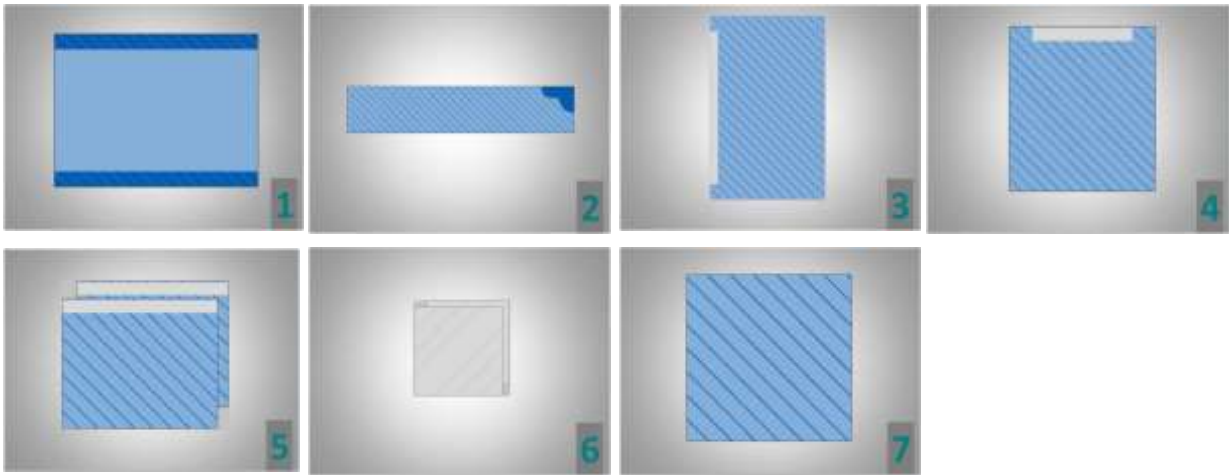


NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
3	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
4	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	150x180	1
5	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
6	Havlu / Towel	40x40	2
7	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.055.01

Disposable Steril Laparoskopik Pelviskopi Seti / Disposable Sterile Laparoscopic

Pelviscopy Pack

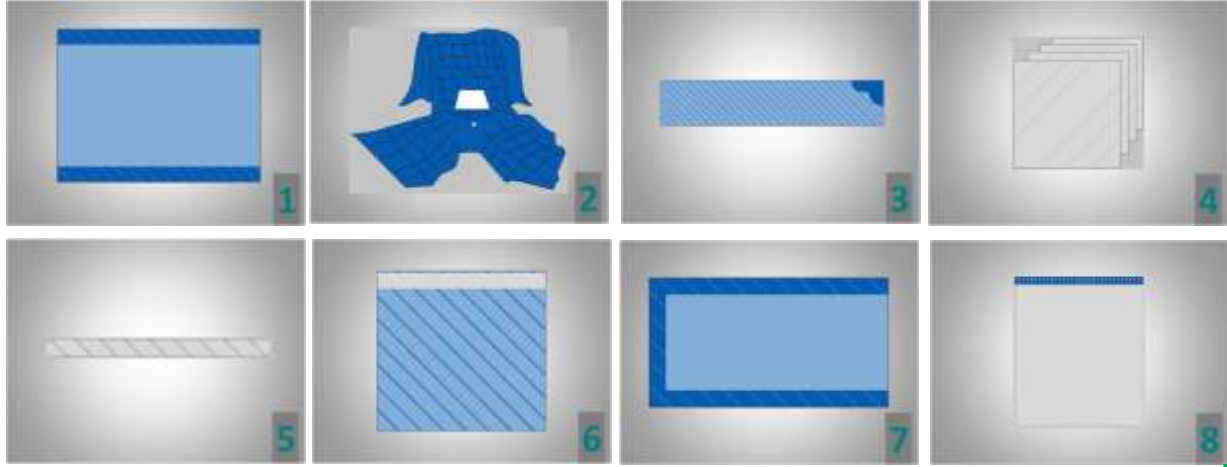


NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x190	1
2	Laparoskopik Pelviskopi Örtü Litotomik / Laparoscopic Pelviscopy Drape Lithotomic	180x240x280	1
3	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Tüp Tutucu (Bantlı Cırt) / Tube Holder (Velcro)	2.5x30	1
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	1
7	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
8	Seyyar Poşet PE / Mobile Pouch PE	28x33	1

Ref. Code Z10.035.01

Disposable Steril Laparoskopik Abdominal Perineal Set / Disposable Sterile Laparoscopic


Abdominal-Perineal Pack

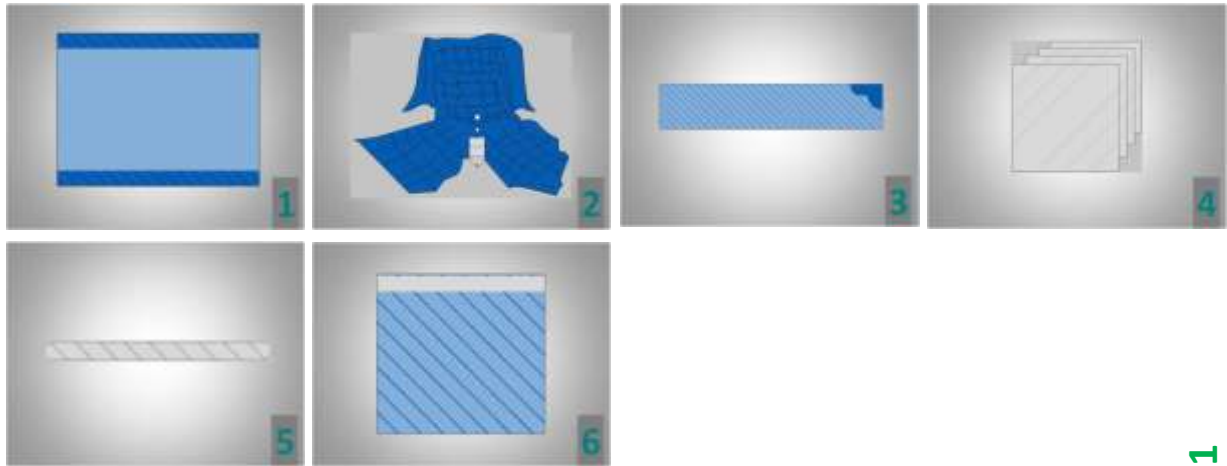

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x190	1
2	Laparoskopik Abdominal Perineal Örtü Litotomik / Laparoscopic Abdominal Perineal DrapeLithotomic	180x240x280	1
3	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Tüp Tutucu (Bantlı Cırt) / Tube Holder (Velcro)	2.5x30	1
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	1

Ref. Code Z10.035.01


Disposable Steril Laparotomi Seti Poşlu / Disposable Sterile Laparotomy Pack with Pouch

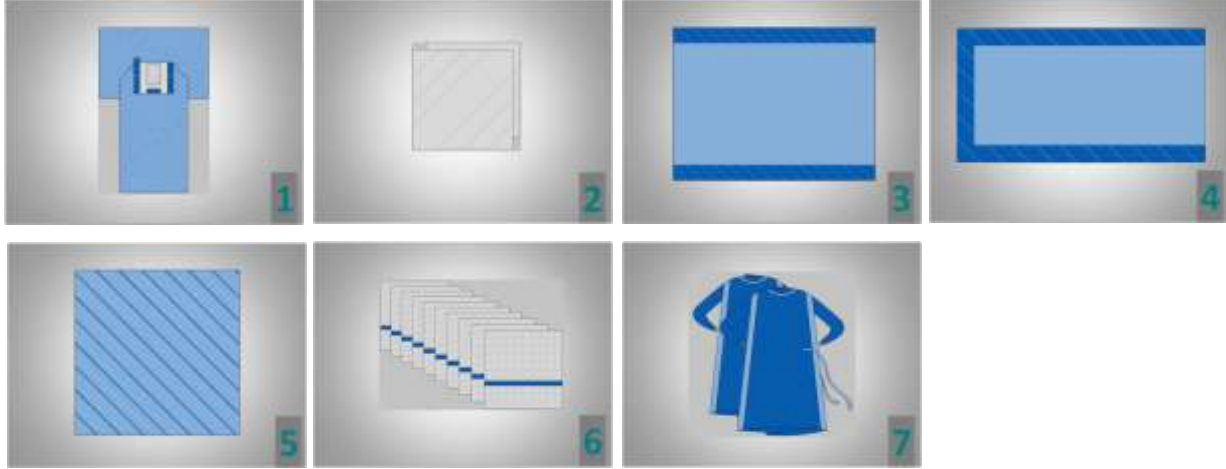

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Laparotomi Örtüsü Poşlu/ Laparotomy Drape with Pouch	240x360	1
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	20
7	Korumsal Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.034.01


Disposable Steril Laparotomi Seti Poşlu-2 / Disposable Sterile Laparotomy Pack with Pouch-2

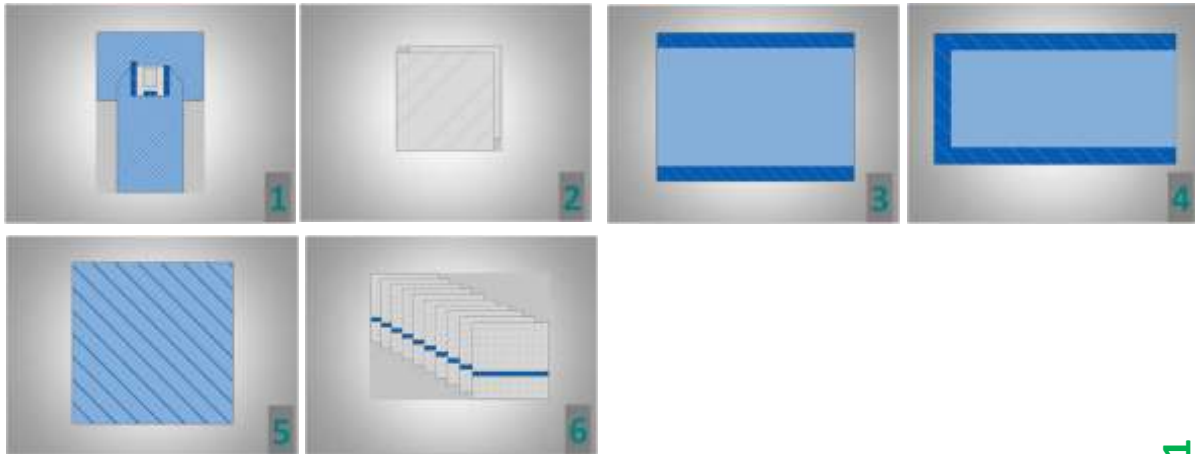

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Laparotomi Örtüsü Poşlu/ Laparotomy Drape with Pouch	240x360	1
2	Havlu / Towel	40x40	6
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	20

Ref. Code Z10.034.01


Disposable Steril Laparotomi Seti / Disposable Sterile Laparotomy Pack

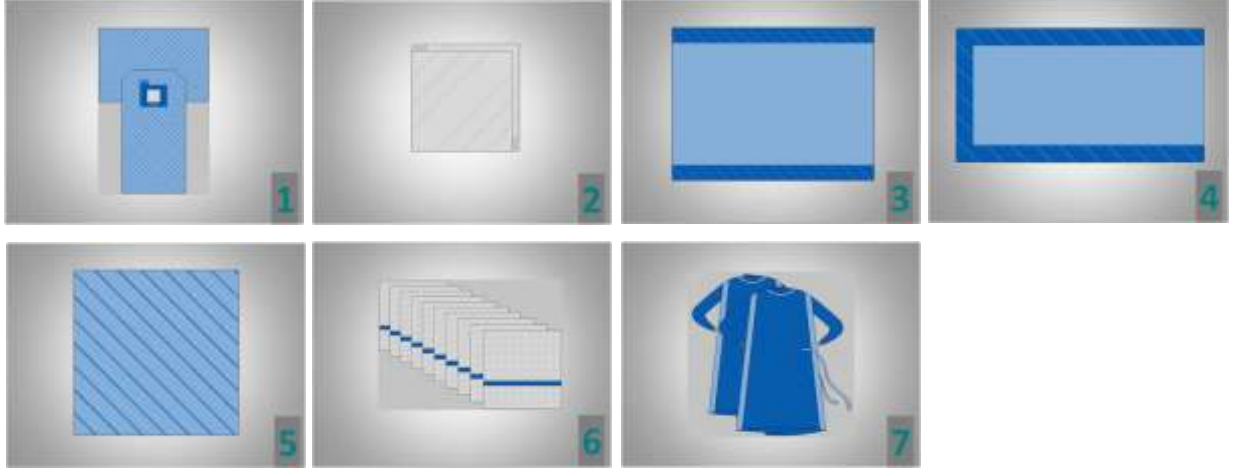

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Laparotomi Örtüsü İnsüzyonlu/ Laparotomy Drape with Incise Film	240x360	1
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	20
7	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.034.01

Disposable Steril Laparotomi Seti-2 / Disposable Sterile Laparotomy Pack-2

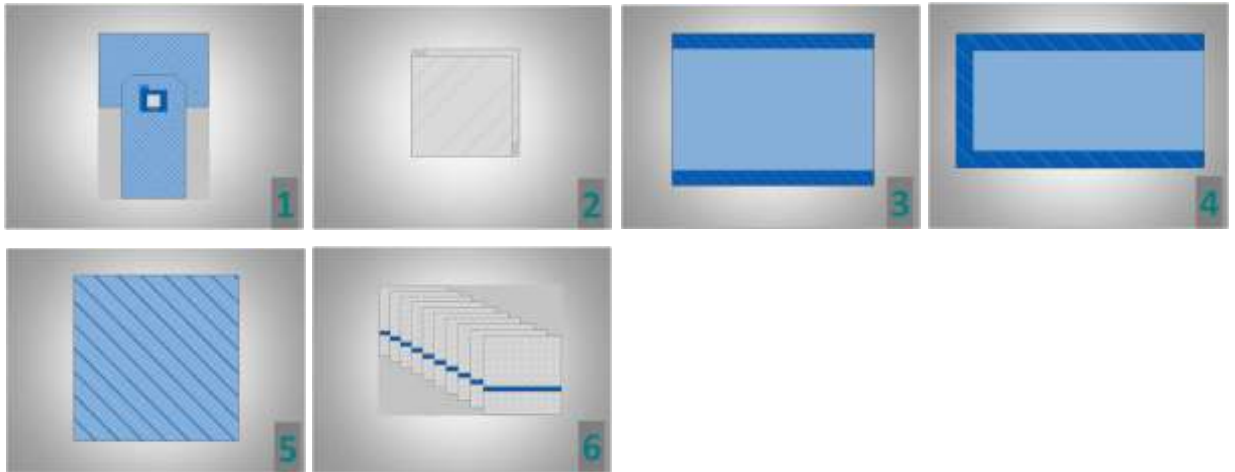

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Laparotomi Örtüsü İnsüzyonlu/ Laparotomy Drape with Incise Film	240x360	1
2	Havlu / Towel	40x40	6
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	20


Ref. Code Z10.034.01



ZENMED
TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GENEL CERRAHİ - GENERAL SURGERY

Disposable Steril Liposuction Seti / Disposable Sterile Liposuction Pack

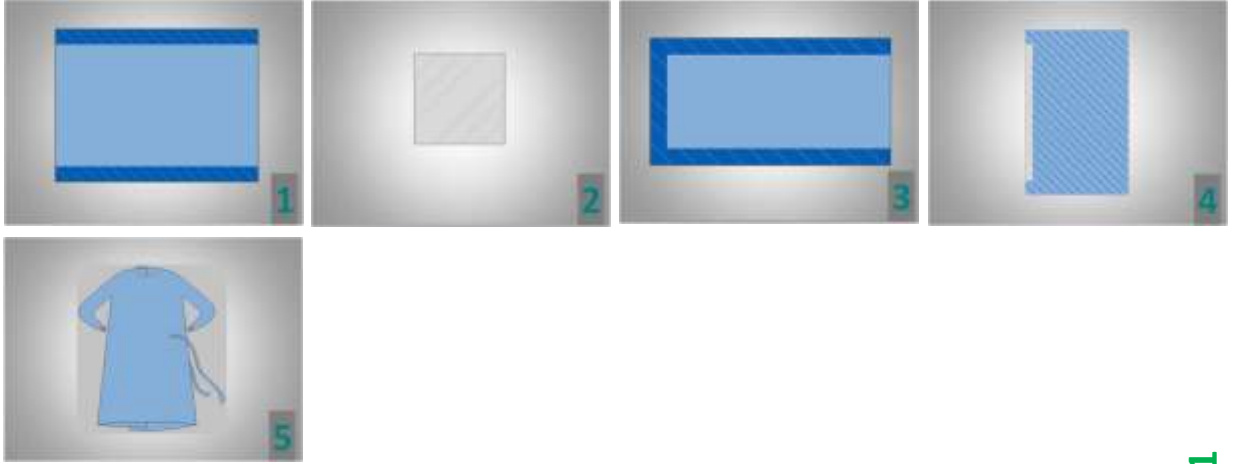

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x190	1
2	Havlu / Towel	40x40	1
3	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
4	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	125x240	1
5	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	L	1

Ref. Code Z10.063.01






KARDİYOLOJİ

CARDIOLOGY



Disposable Steril Anjiografi Seti / Disposable Sterile Angiography Pack

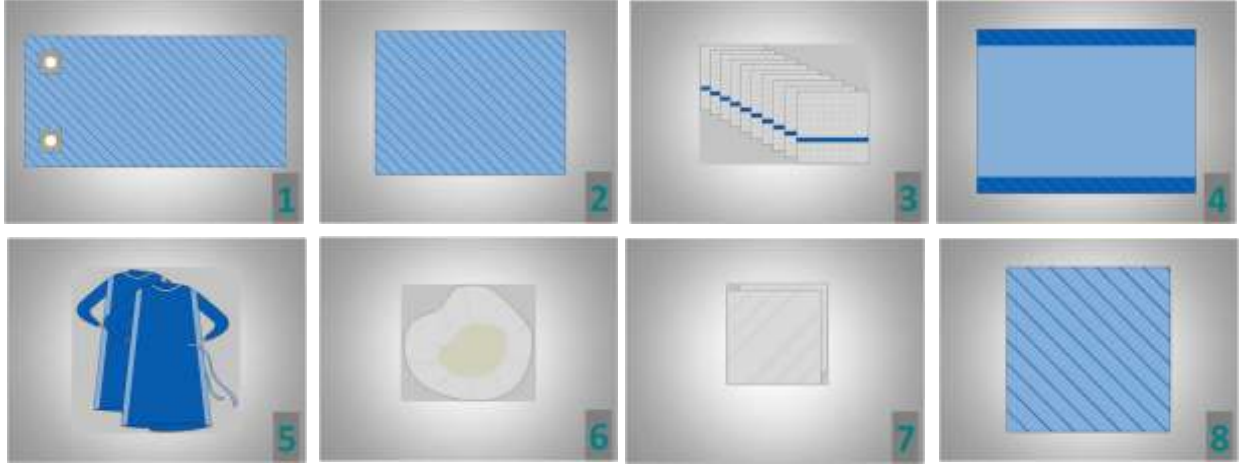

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Anjiyo Örtüsü / Angiography Drape	150x300	1
2	Düz Örtü / Basic Drape	100x200	1
3	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	10
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
6	Floroskopi Kılıfı / Fluoroscopy Cover	60x65	1
7	Havlu / Towel	40x40	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Sıvı Kabı / Gallipot	250 ML	1

Ref. Code Z10.028.01


Disposable Steril Anjiografi Seti-2 / Disposable Sterile Angiography Pack-2

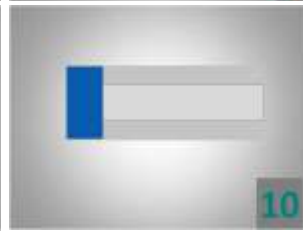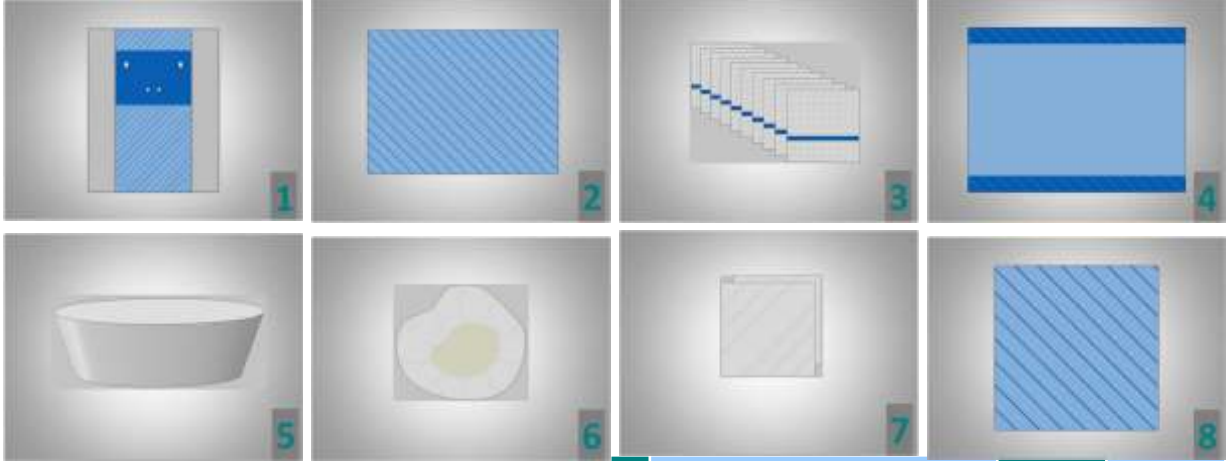

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Femoral – Radial / Femoral Radial Angiography Drape	240x300	1
2	Düz Örtü / Basic Drape	100x200	1
3	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	10
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Sıvı Kabı / Gallipot	500 ML	1
6	Floroskopi Kılıfı / Fluoroscopy Cover	60x65	1
7	Havlu / Towel	40x40	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Sıvı Kabı / Gallipot	250 ML	1
10	Boyama Sünger / Betadine Sponge	ST	1

Ref. Code Z10.028.01


Disposable Steril Anjiyografi Seti-3 / Disposable Sterile Angiography Pack-3

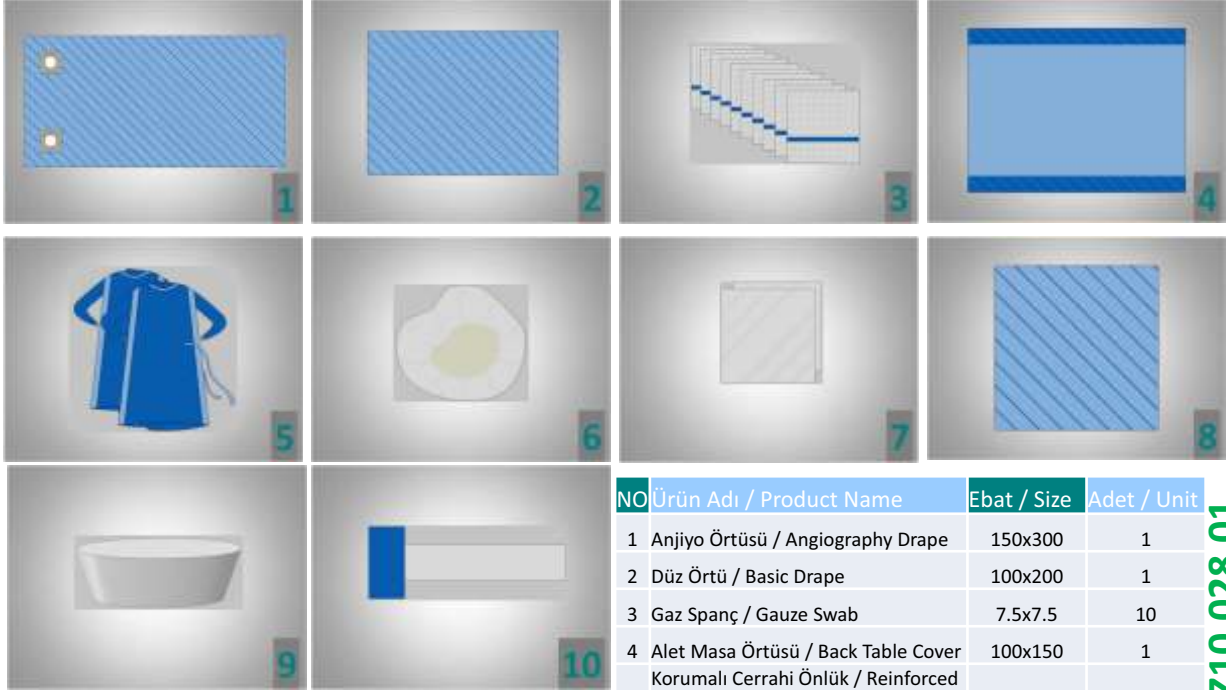

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Anjiyo Örtüsü / Angiography Drape	150x300	1
2	Düz Örtü / Basic Drape	100x200	1
3	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	10
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
6	Floroskopi Kılıfı / Fluoroscopy Cover	60x65	1
7	Havlulu / Towel	40x40	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization	100x100	1
9	Sıvı Kabı / Gallipot	250 ML	1

Ref. Code Z10.028.01


Disposable Steril Biopsi Seti / Disposable Sterile Biopsy Pack

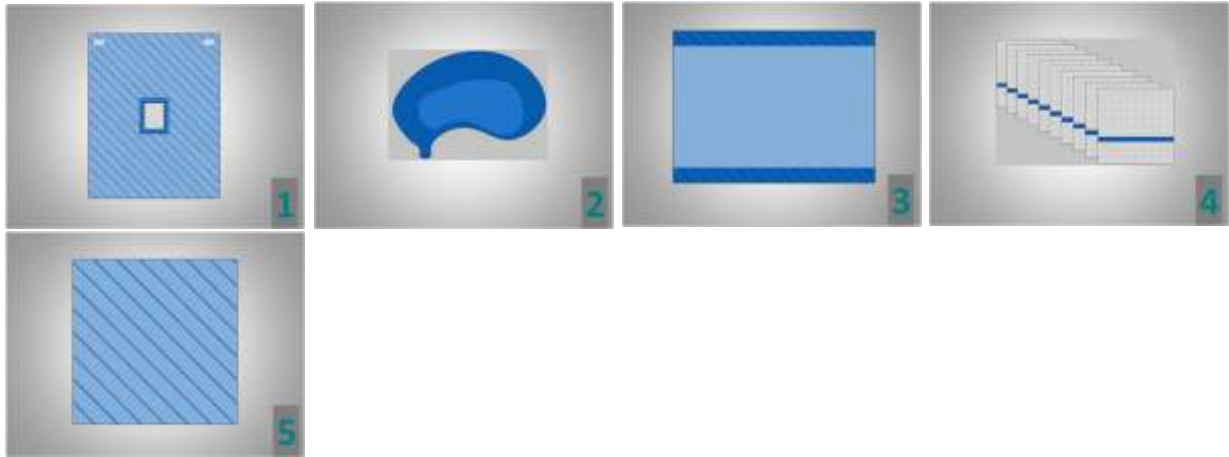

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	80x100	1
2	Disposable Böbrek Küvet / Kidney Tray	ST	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	50x60	1
4	Gaz Spanç / Gauze Swab	20x20	10
6	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	50x50	1

Ref. Code Z10.032.01

Disposable Steril By-Pass Seti / Disposable Sterile By Pass Pack

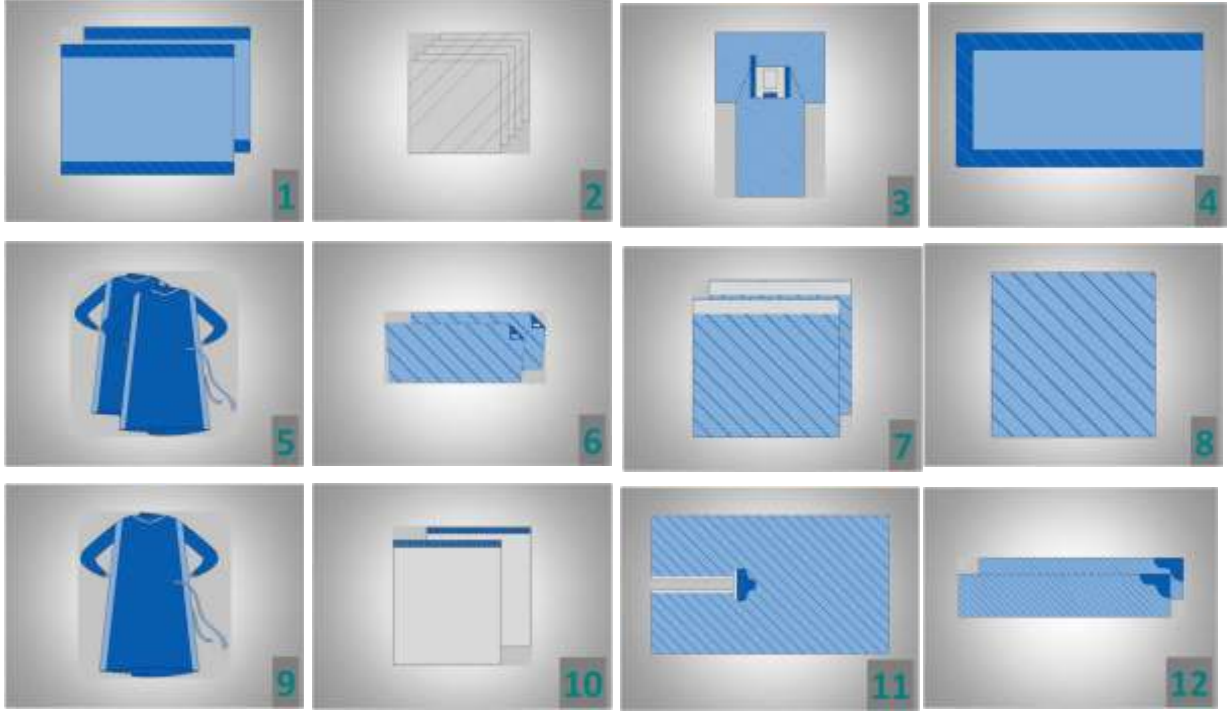


NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Havlu / Towel	40x40	3
3	KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape	240x360	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	XL	2
6	Seyyar Poşet PE / Mobil Pouch PE	28x33	2
7	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	M	1
10	Seyyar Poşet PE / Mobil Pouch PE	28x33	2
11	"U" Yarıklı Perine Örtüsü / "U" Split Perineum Drape	150x260	1
12	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	2

Ref. Code Z10.026.01

Disposable Steril By-Pass Seti -2 / Disposable Sterile By Pass Pa


ck-2

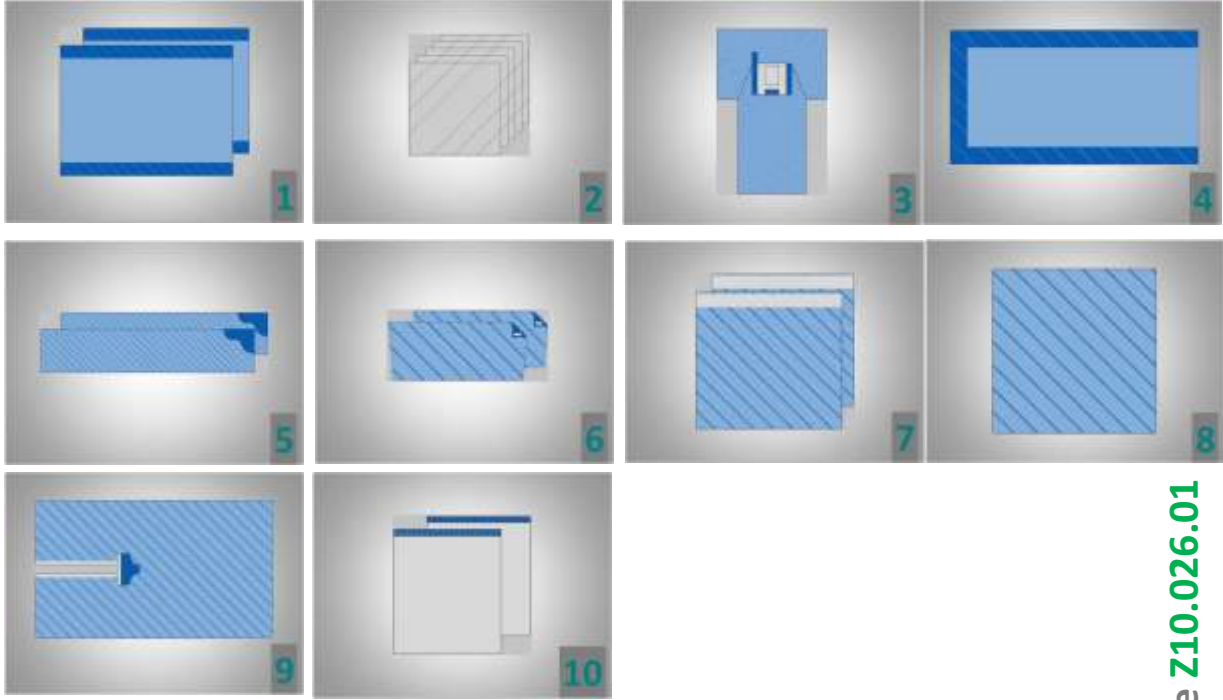

Ref. Code Z10.026.01

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape	240x360	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	2
6	Seyyar Poşet PE / Mobil Pouch PE	28x33	2
7	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	'U' Yarıklı Perine Örtüsü / "U" Split Perineum Drape	150x260	1
10	Seyyar Poşet PE / Mobil Pouch PE	28x33	2


Disposable Steril Kalp Kapak Seti / Disposable Sterile Heart Valve Surgery Pack

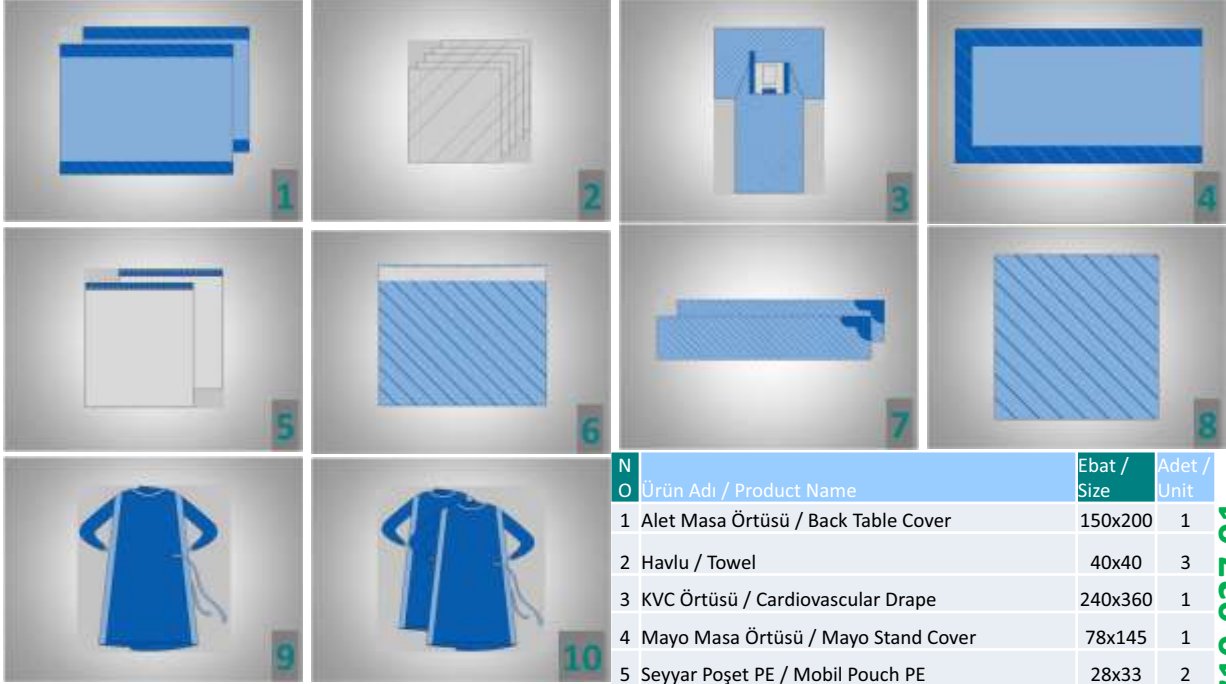

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Havlu / Towel	40x40	3
3	KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape	240x360	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Seyyar Poşet PE / Mobil Pouch PE	28x33	2
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	1
7	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	M	1
10	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.027.01


Disposable Steril Kalp Kapak Seti-2 / Disposable Sterile Heart Valve Surgery Pack-2

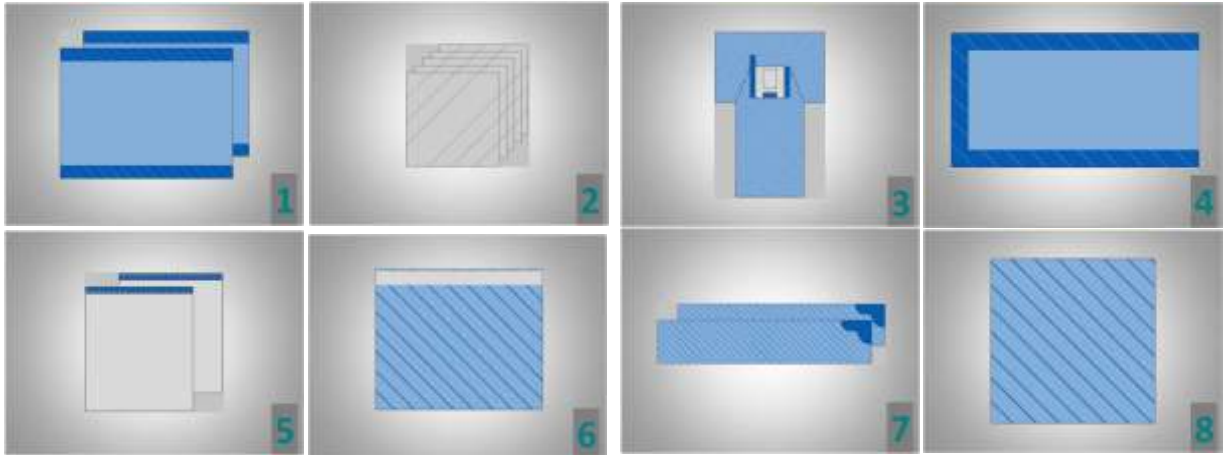

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape	240x360	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Seyyar Poşet PE / Mobil Pouch PE	28x33	2
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	1
7	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.27.01


Disposable SterilBeyinKarpalTunelSeti/ Disposable Sterile Carpal Tunnel Pack

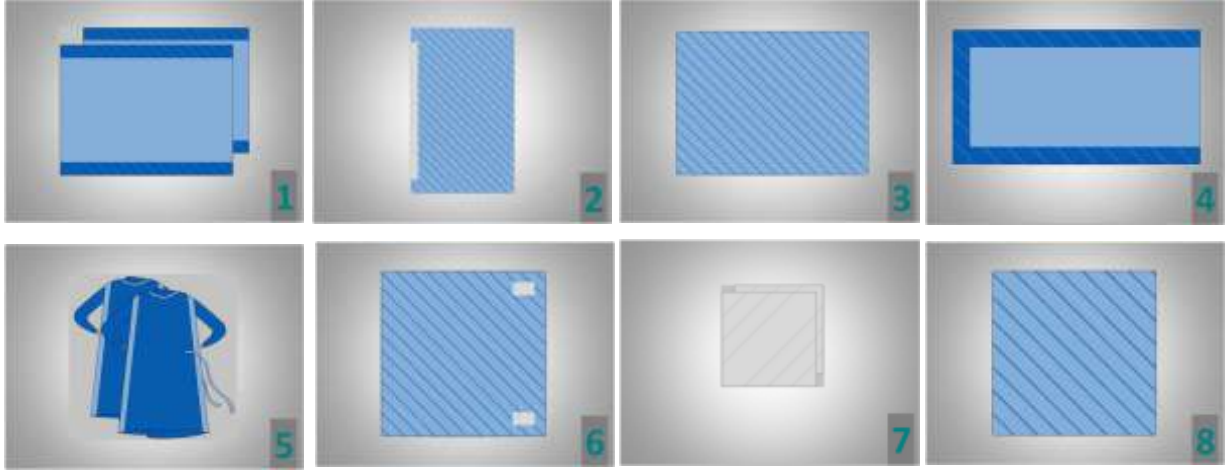

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	160x180	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	XL	2
6	Karpal Tunel Örtüsü / Carpal Tunnel Drape	150x150	1
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.025.01


Disposable SterilBeyinKarpalTunelSeti-2/ Disposable Sterile Carpal Tunnel Pack-2

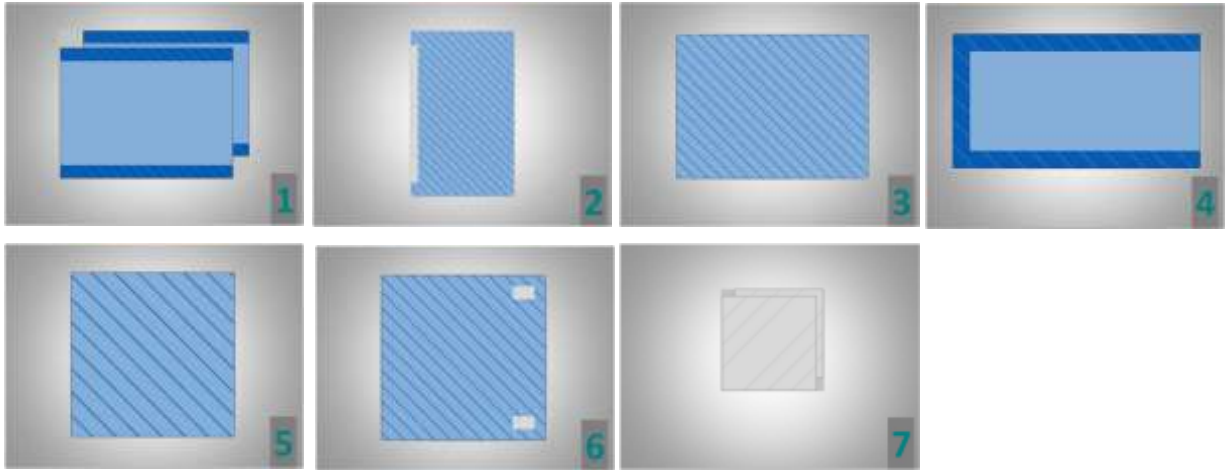

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	160x180	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	XL	2
6	Karpal Tunel Örtüsü / Carpal Tunnel Drape	150x150	1
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.025.01


Disposable Steril Kongenital Kardiyovasküler Seti / Disposable Sterile Congenital Cardiovascular Pack

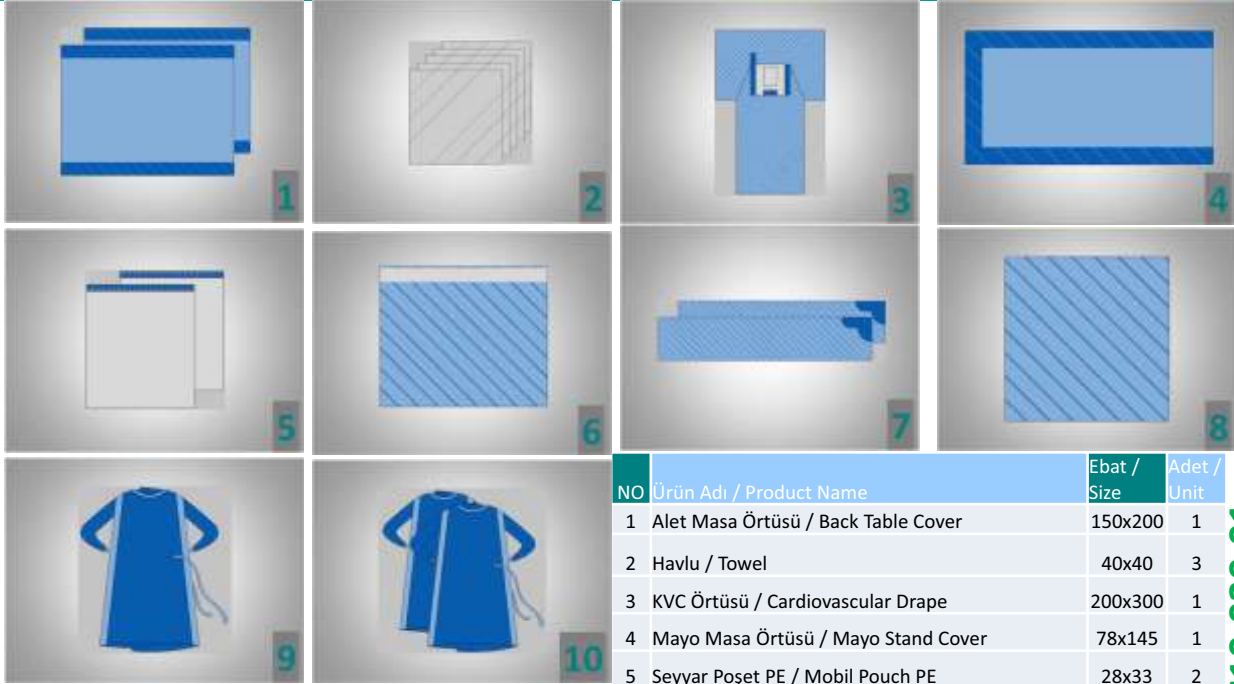

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Havlu / Towel	40x40	3
3	KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape	200x300	1
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Seyyar Poşet PE / Mobil Pouch PE	28x33	2
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	1
7	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	M	1
10	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.030.01


Disposable Steril Kardiyovasküler Seti ("U" Yarıklı) / Disposable Sterile Cardiovascular Pack ("U" Split)

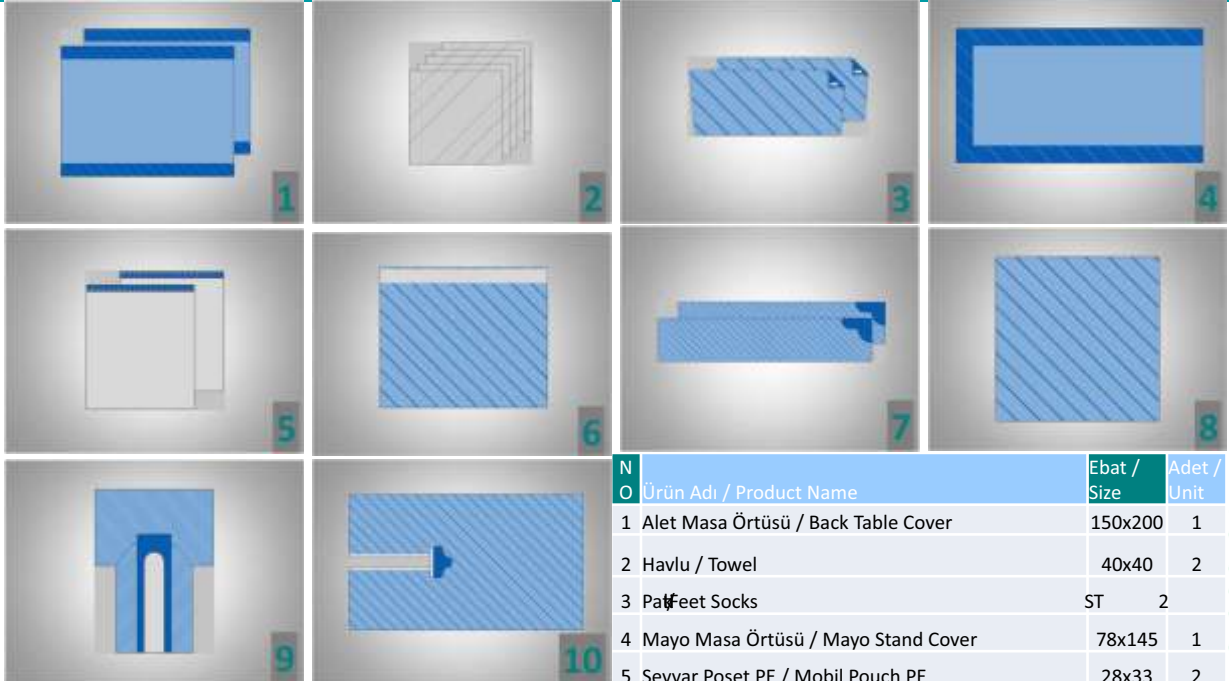

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	Paçet Socks	ST	2
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Seyyar Poşet PE / Mobil Pouch PE	28x33	2
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	1
7	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	"U" KVC Örtüsü(15x200 "U" Açıklık Bantlı) / Cardiovascular Drape with "U" Split	250x220 x340	1
10	"U" Yarıklı Perine Örtüsü / "U" Split Perineum Drape	150x260	1

Ref. Code Z10.030.01


Disposable Steril Toraks Seti / Disposable Sterile Thorax Pack

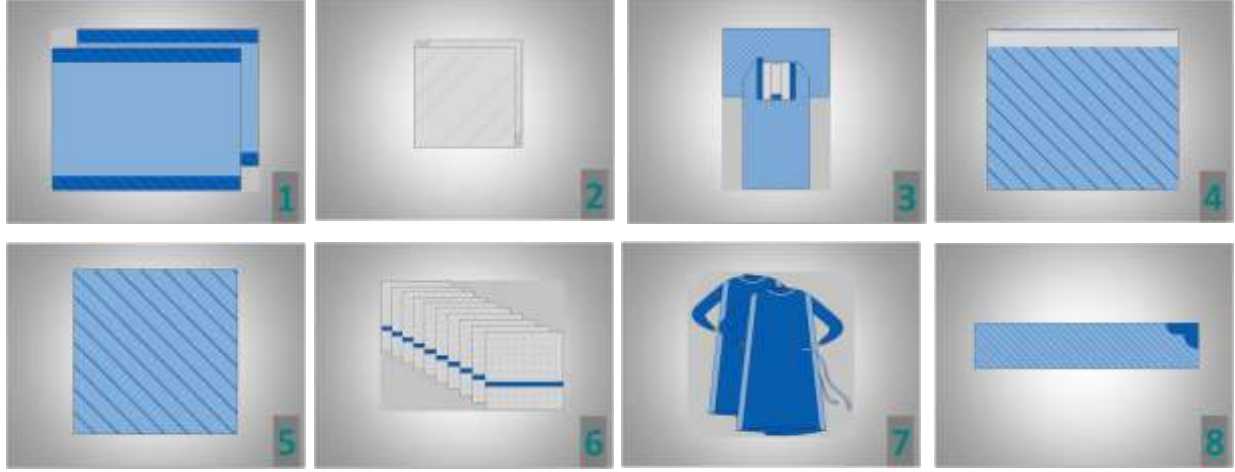

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	50x65	2
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	Toraks Örtüsü (35x45 İnsüzyonlu) / Thorax Drape with incise film (35x45)	250x350	1
4	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x120	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	20
7	Korunmalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
8	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1

Ref. Code Z10.038.01

Disposable Steril Toraks Seti-2 / Disposable Sterile Thorax Pack-2

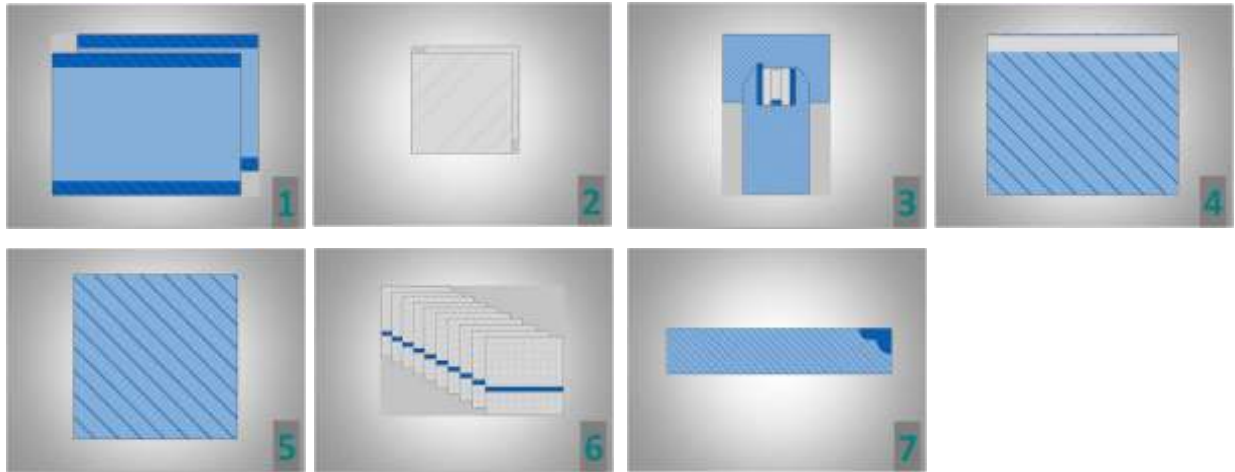

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	50x65	2
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	Toraks Örtüsü (35x45 İnsüzyonlu) / Thorax Drape with incise film (35x45)	250x350	1
4	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x120	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	20
7	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1


Ref. Code Z10.038.01



**BEYİN
CERRAHİ**

**BRAIN
SURGERY**


Disposable Steril Beyin Cerrahi Seti / Disposable Sterile Craniotomy Pack

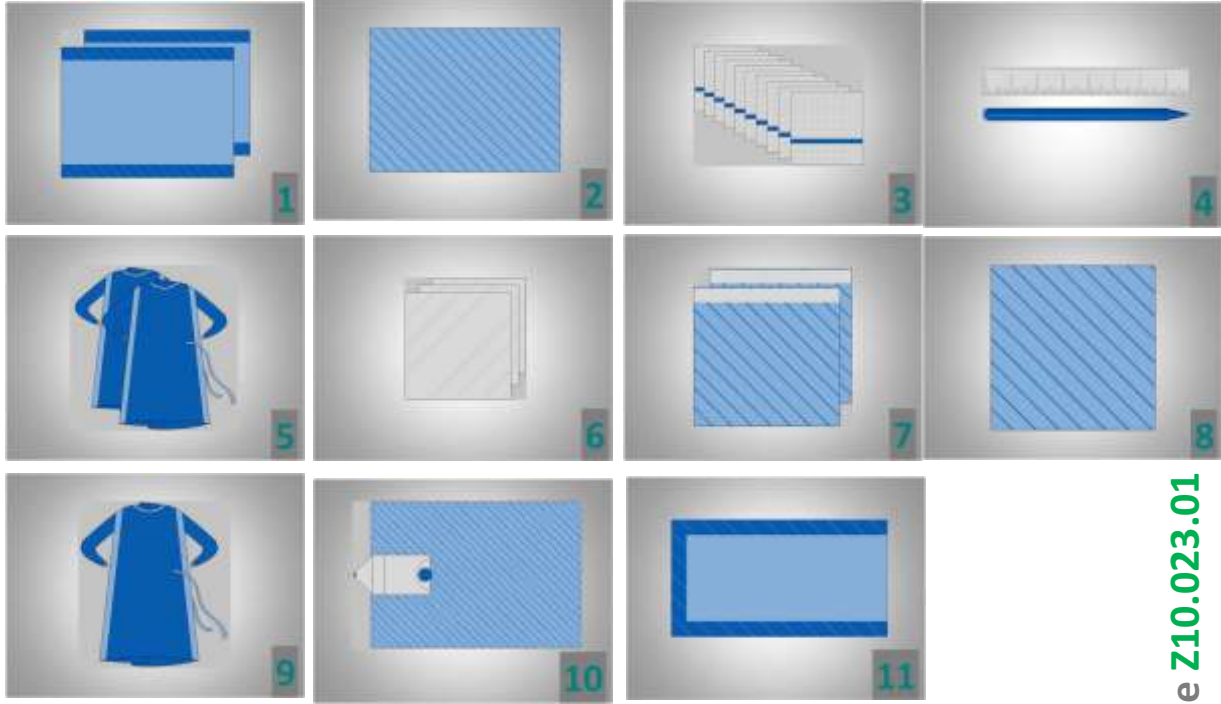

Ref. Code Z10.023.01

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Düz Örtü / Basic Drape	150x250	1
3	Gaz Spanç / Gauze Swab	10x10	10
4	Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	XL	2
6	Havlu / Towel	40x40	3
7	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	M	1
10	Kraniyotomi Örtüsü / Craniotomy Drape	230x330	1
11	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1


Disposable Steril Beyin Cerrahi Seti-2 / Disposable Sterile Craniotomy Pack-2

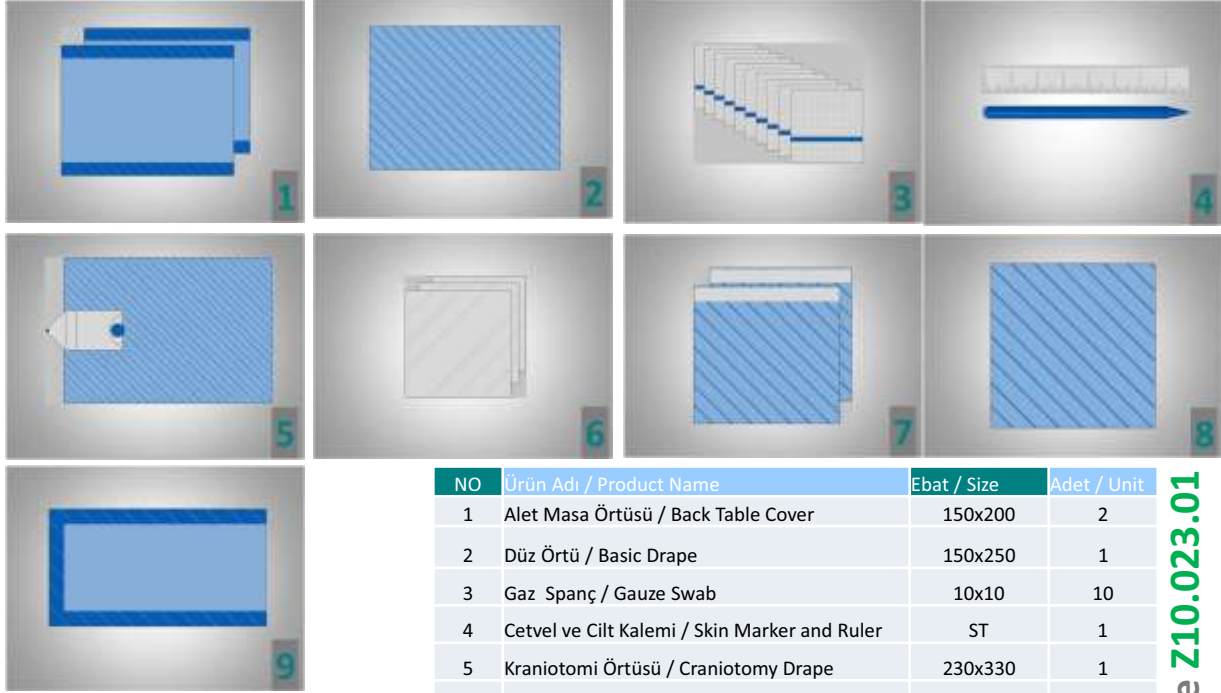

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Düz Örtü / Basic Drape	150x250	1
3	Gaz Spanç / Gauze Swab	10x10	10
4	Cetvel ve Cilt Kalem / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Kraniyotomi Örtüsü / Craniotomy Drape	230x330	1
6	Havlu / Towel	40x40	2
7	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1


Ref. Code Z10.023.01

Disposable Steril Shunt Örtü Seti / Disposable Sterile Shunt Surgery Pack

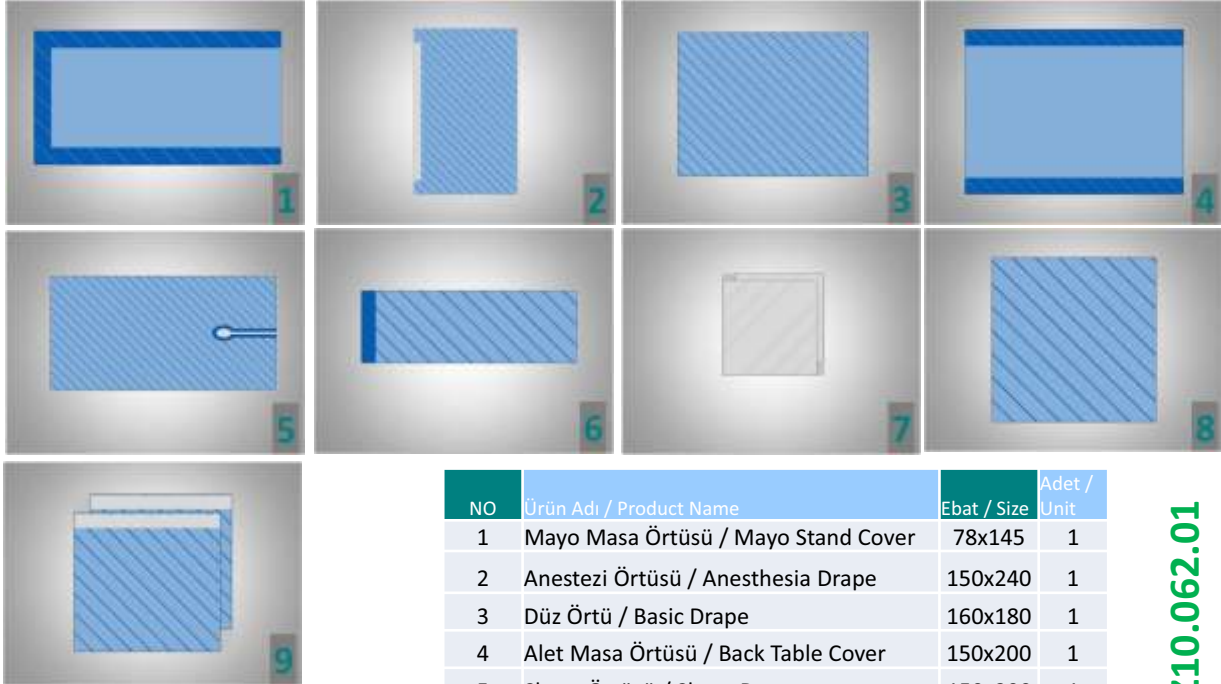


NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
2	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	160x180	1
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
5	Shunt Örtüsü / Shunt Drape	150x300	1
6	Drep (İnsuzyon) / Incise Film	25x75	1
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2

Ref. Code Z10.062.01

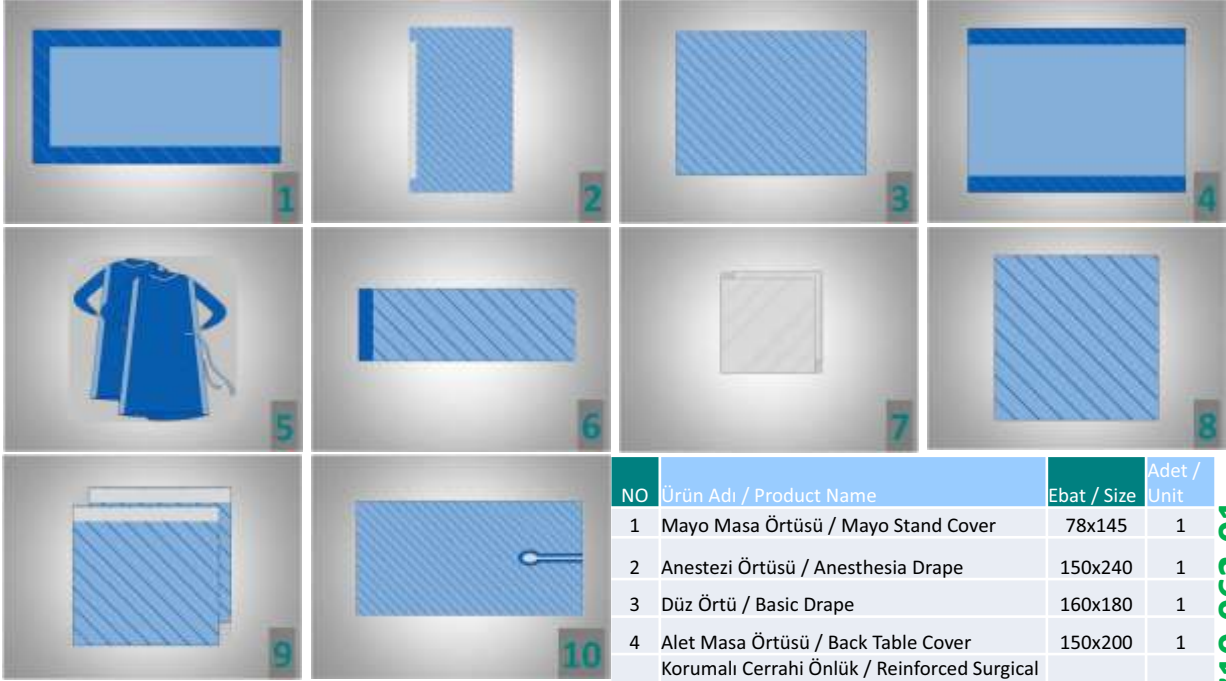**ZENMED**TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**BEYİN CERRAHİ - BRAIN SURGERY****Disposable Steril Shunt Örtü Seti - 2 / Disposable Sterile Shunt Surgery Pack - 2**

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
2	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	160x180	1
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	XL	2
6	Drep (İnsuzyon) / Incise Film	25x75	1
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
10	Shunt Örtüsü / Shunt Drape	150x300	1


Ref. Code Z10.062.01

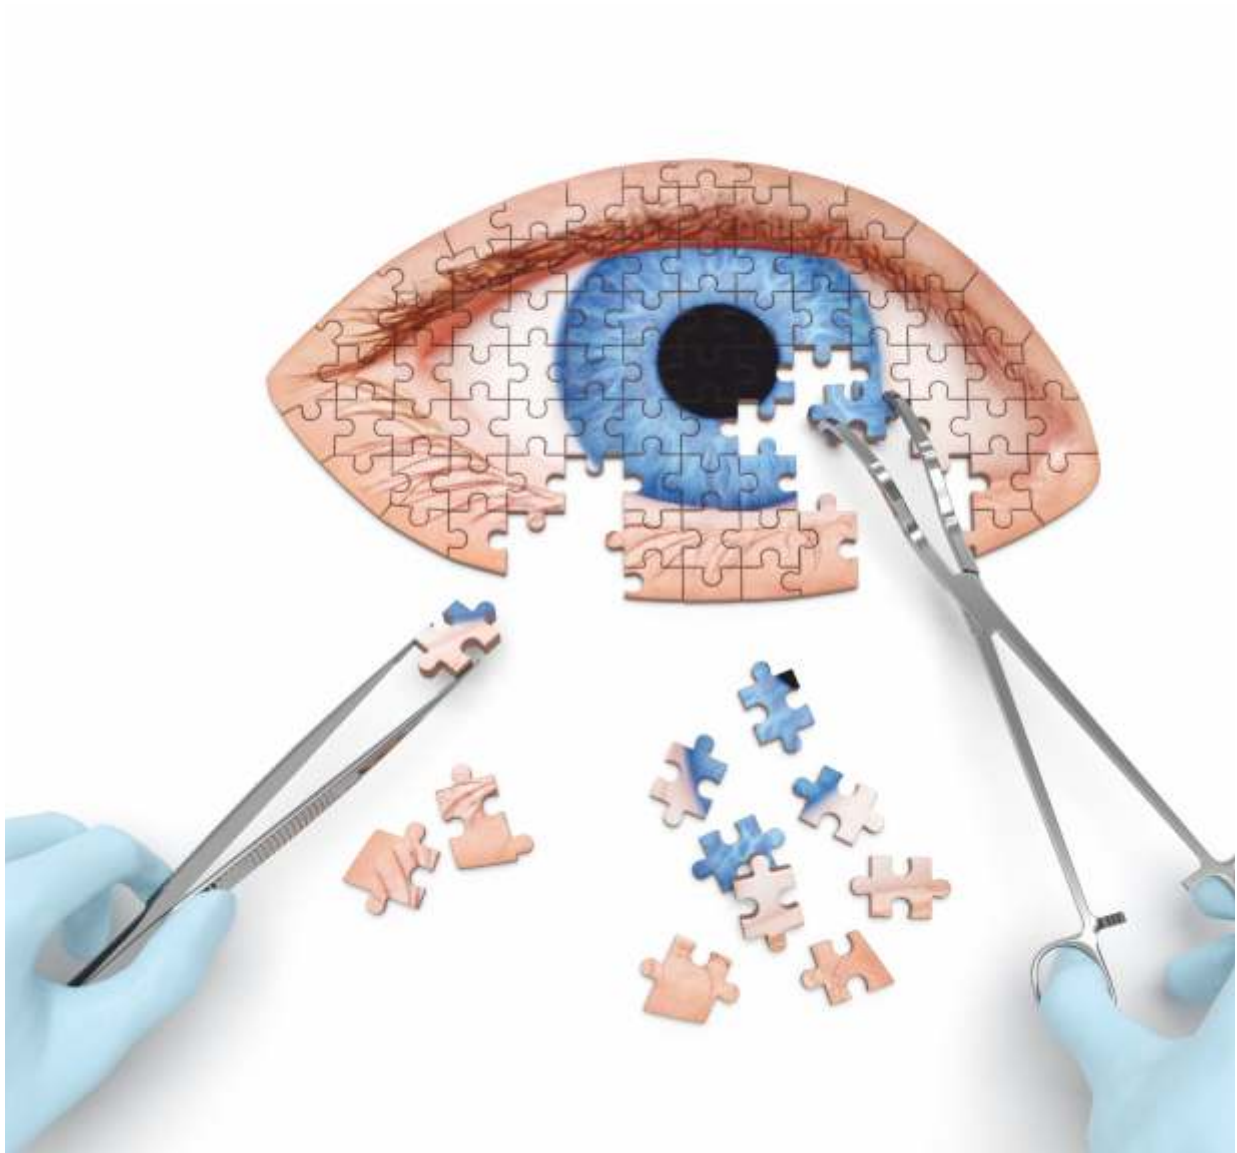

OFTOLMALOJİ

OPHTHALMOLOGY

Disposable Steril Oftalmik Set Çift Poşlu/ Disposable Sterile Ophthalmic Pack with Double Pouch

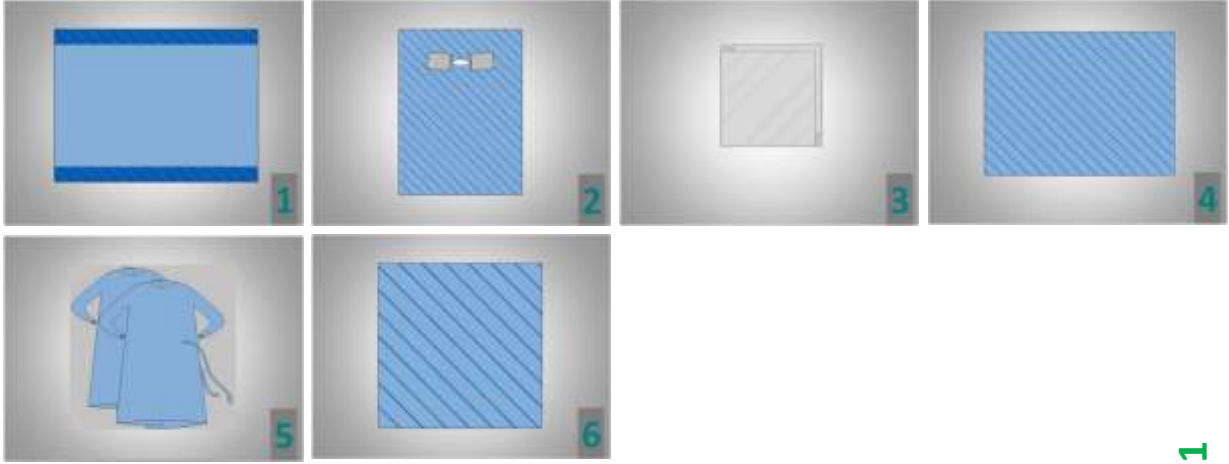

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x130	1
2	Çift Poşlu Oftalmik Örtü / Ophthalmic Drape with Double Pouch	150x200	1
3	Havlu / Towel	40x40	2
4	Düz Örtü / Basic Drape	150x180	1
5	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	L	2
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	75x75	1

Ref. Code Z10.015.01


Disposable Steril Oftalmik Set Çift Poşlu-2/ Disposable Sterile Ophthalmic Pack with Double Pouch-2



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x130	1
2	Çift Poşlu Oftalmik Örtü / Ophthalmic Drape with Double Pouch	150x200	1
3	Havlu / Towel	40x40	2
4	Düz Örtü / Basic Drape	150x180	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	75x75	1

Ref. Code Z10.015.01


Disposable Steril Oftalmik Set Tek Poşlu/ Disposable Sterile Ophthalmic Pack with Single Pouch

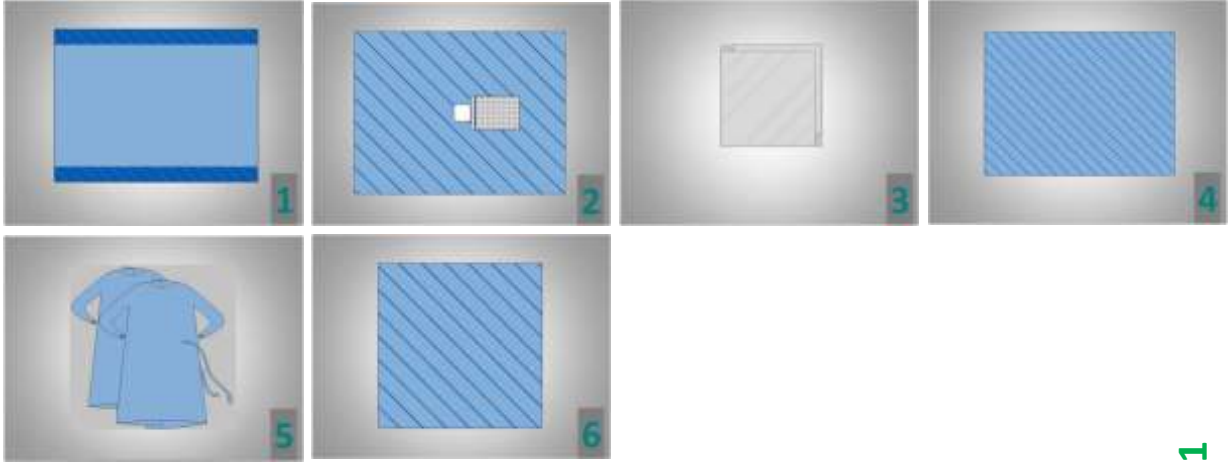

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x130	1
2	Tek Poşlu Oftalmik Örtü / Ophthalmic Drape with Single Pouch	100x130	1
3	Havlu / Towel	40x40	2
4	Düz Örtü / Basic Drape	150x180	1
5	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	L	2
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	75x75	1

Ref. Code Z10.014.01

Disposable Steril Oftalmik Set Tek Poşlu-2/ Disposable Sterile Ophthalmic Pack with Single Pouch-2

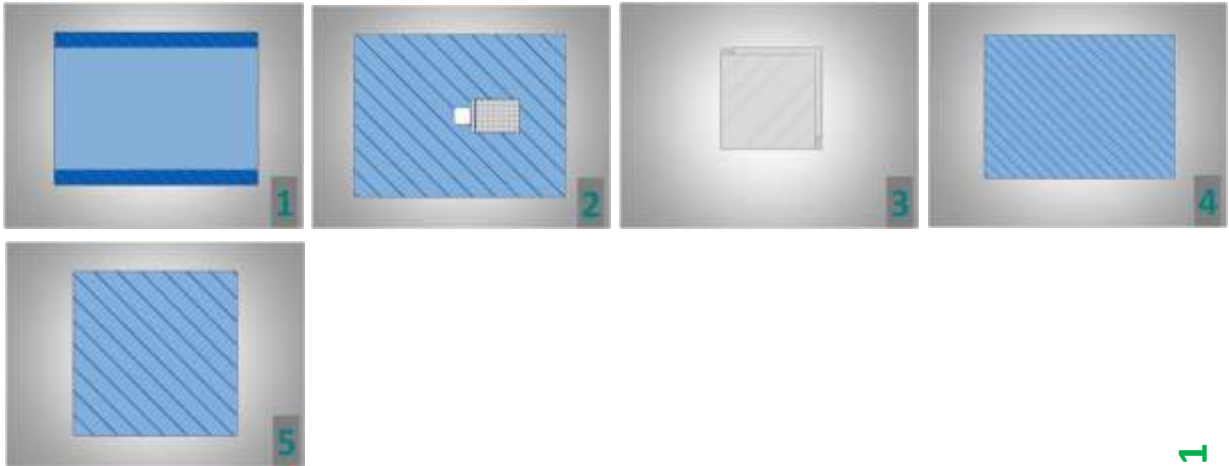

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x130	1
2	Tek Poşlu Oftalmik Örtü / Ophthalmic Drape with Single Pouch	100x130	1
3	Havlu / Towel	40x40	2
4	Düz Örtü / Basic Drape	150x180	1
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	75x75	1


Ref. Code Z10.014.01



**KULAK
BURUN BOĞAZ**

**EAR , NOSE
AND THYROID**


Disposable Steril KBB Seti - Boğaz / Disposable Sterile E.N.T Pack - Throat

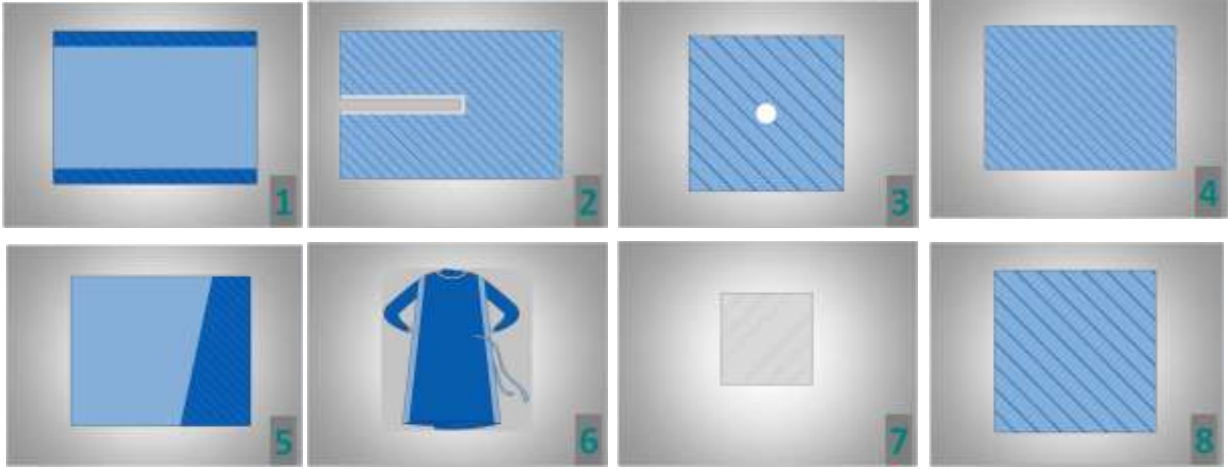

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	KBB Örtüsü / ENT Drape	160x240	1
3	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	100x100	1
4	Düz Örtü / Basic Drape	160x200	1
5	Bohça / Wrapping	50x60	1
6	Havlu / Towel	40x40	1
7	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.057.01


Disposable Steril KBB Seti –Boğaz 2/ Disposable Sterile E.N.T Pack –Throat2

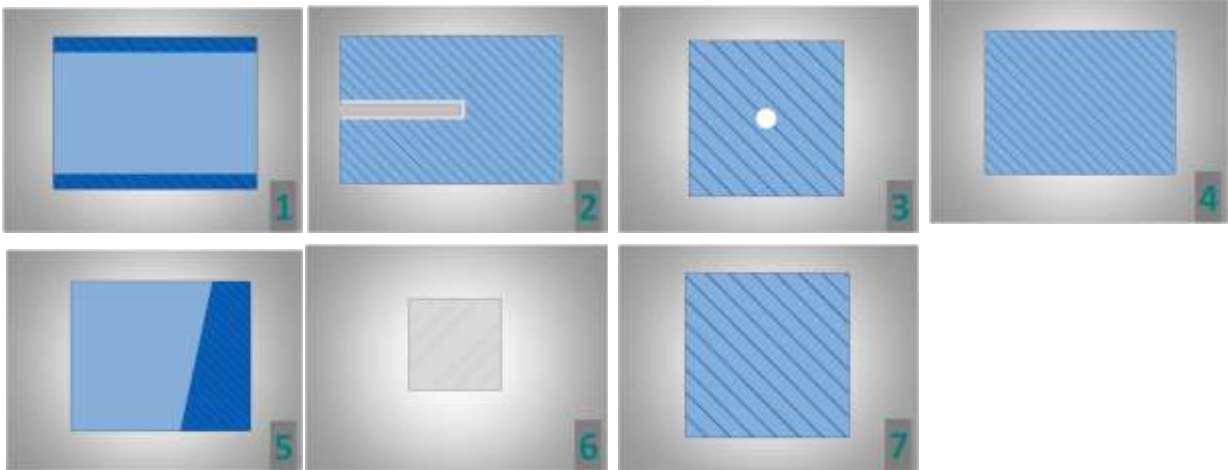

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	KBB Örtüsü / ENT Drape	160x240	1
3	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	100x100	1
4	Düz Örtü / Basic Drape	160x200	1
5	Bohça / Wrapping	50x60	1
6	Havlu / Towel	40x40	1
7	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.057.01


Disposable Steril KBB Seti - Burun / Disposable Sterile E.N.T Pack - Nose

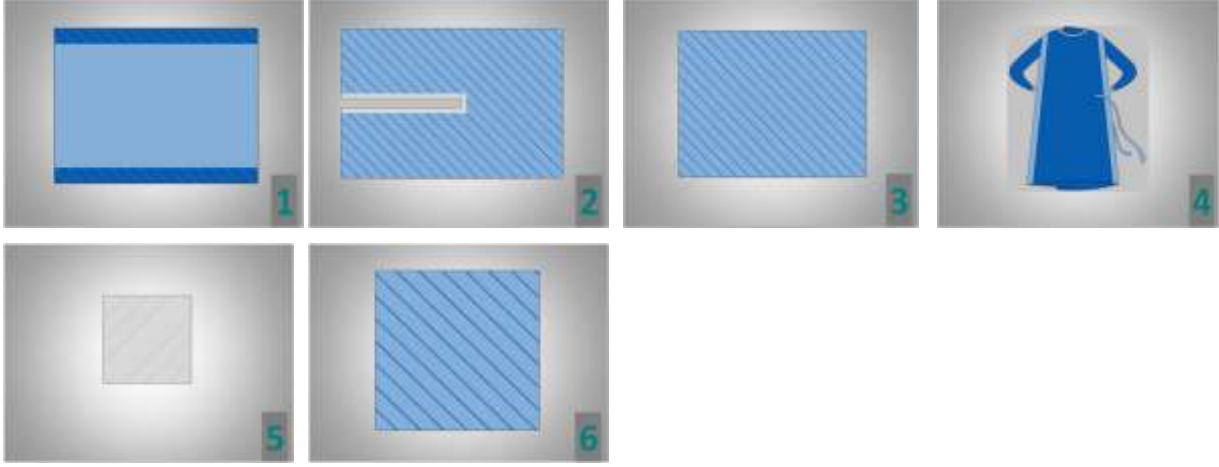

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	KBB Örtüsü / ENT Drape	160x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	160x200	1
4	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	1
5	Havlu / Towel	40x40	1
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.006.01


Disposable Steril KBB Seti – Burun-2 / Disposable Sterile E.N.T Pack – Nose-2

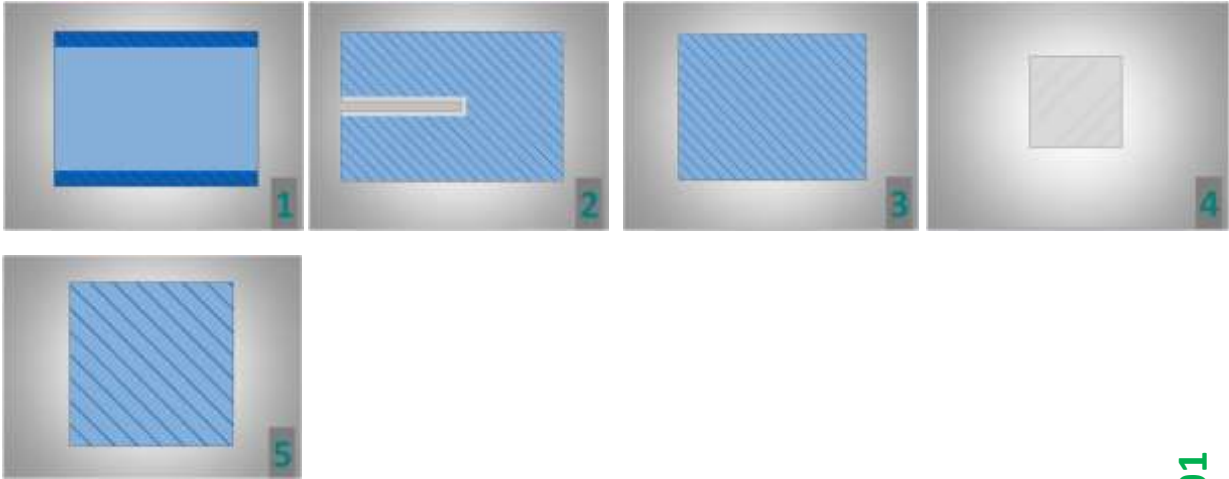

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	KBB Örtüsü / ENT Drape	160x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	160x200	1
4	Havlu / Towel	40x40	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.006.01


Disposable Steril Tonsil Adenoit Seti/ Disposable Sterile Tonsil Adenoid Pack

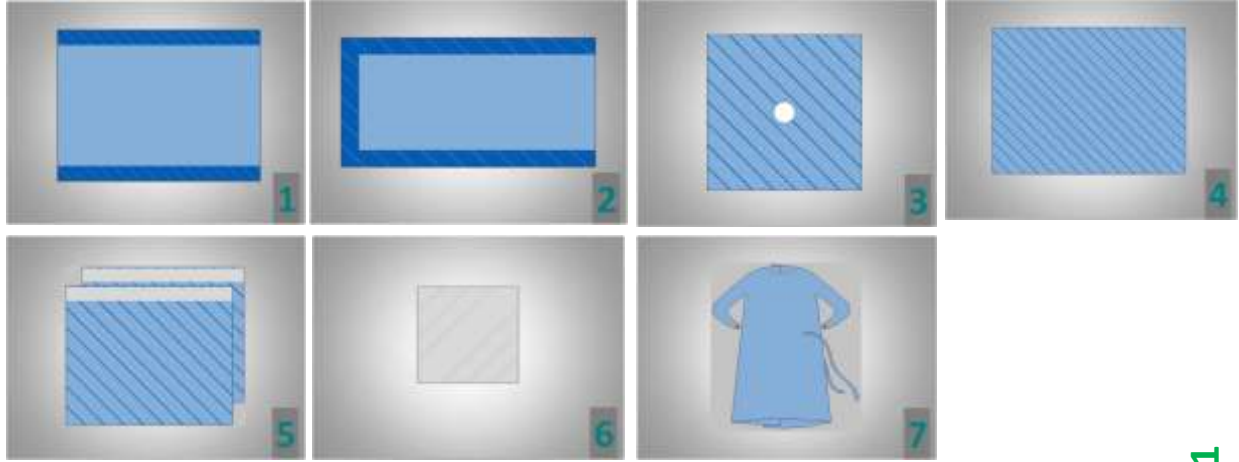

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	100x100	1
4	Düz Örtü / Basic Drape	100x120	1
5	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	150x240	2
6	Havlu / Towel	40x40	1
7	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	L	1

Ref. Code Z10.007.01


Disposable Steril Tonsil Adenoit Seti-2 / Disposable Sterile Tonsil Adenoid Pack-2

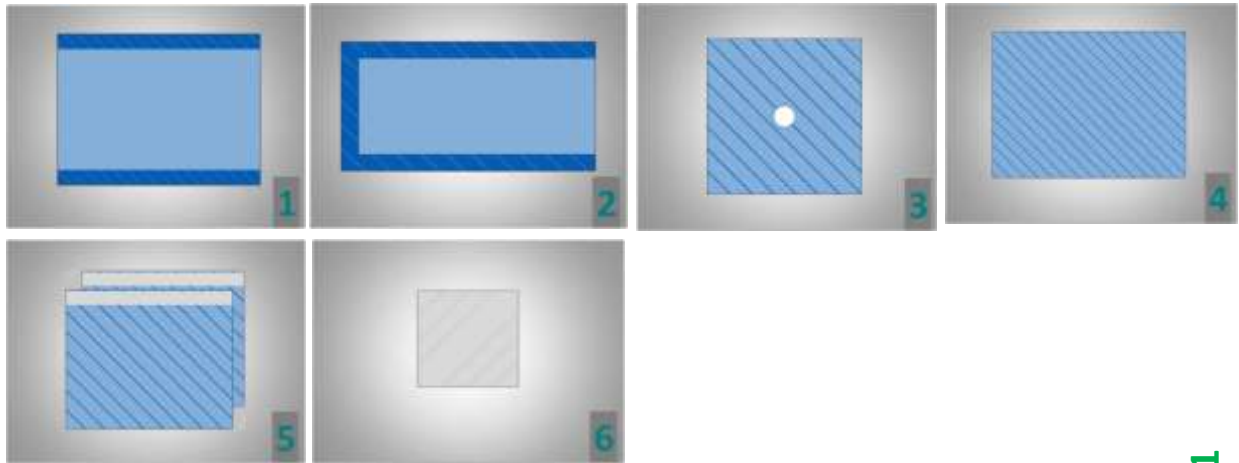

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	100x100	1
4	Düz Örtü / Basic Drape	100x120	1
5	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	150x240	2
6	Havlu / Towel	40x40	1

Ref. Code Z10.007.01


Disposable Steril Troid Seti / Disposable Sterile Thyroid Pack

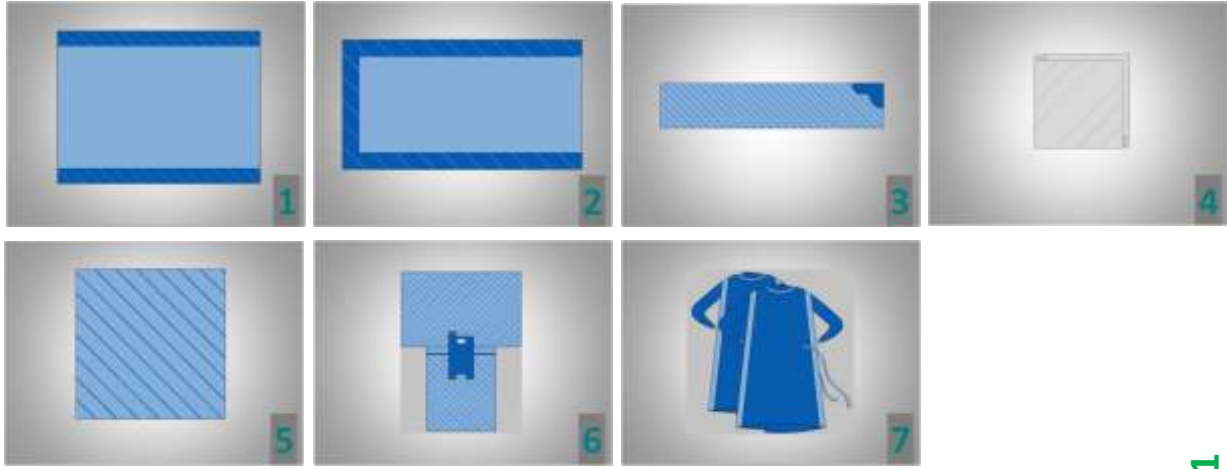

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Yapışkan Bant / OP Tape	10x30	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Troid Örtüsü / Thyroid Drape	240x320	1
7	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code **Z10.039.01**

Disposable Steril Troid Seti-2 / Disposable Sterile Thyroid Pack2

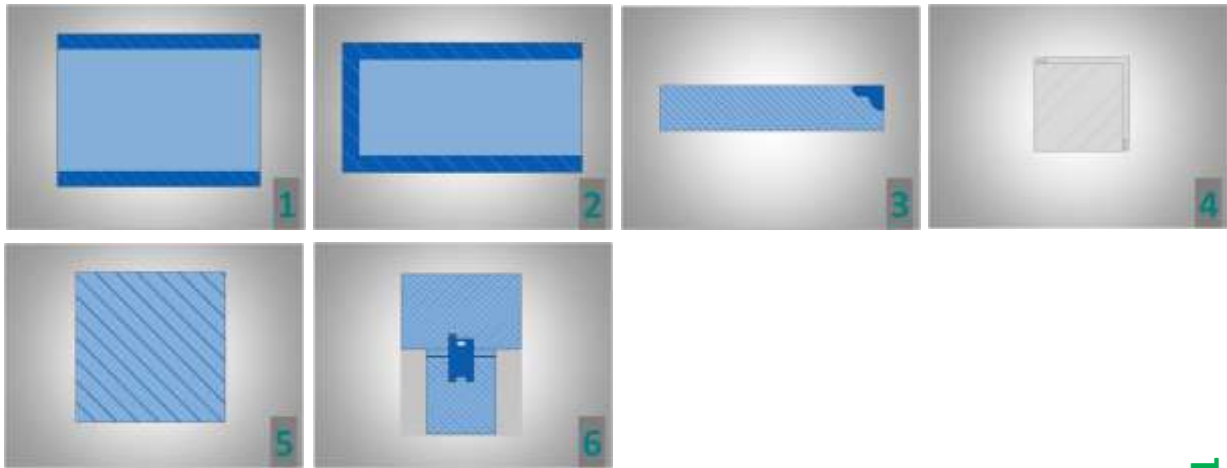

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Yapışkan Bant / OP Tape	10x30	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Troid Örtüsü / Thyroid Drape	240x320	1

Ref. Code **Z10.039.01**



ORTOPEDI

ORTHOPEDICS


Disposable Steril Poşlu Atroskopi Seti / Disposable Sterile Arthroscopy Pack with Pouch



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	40x75	1
4	Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Atroskopi Örtüsü Likit Toplamalı / Arthroscopy Drape with Pouch	200x300	1
6	Kamera Kılıfı / Tube Cover	14x250	1
7	Havlü / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1
10	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.009.01

Disposable Steril Poşlu Atroskopi Seti-2 / Disposable Sterile Arthroscopy Pack with Pouch-2

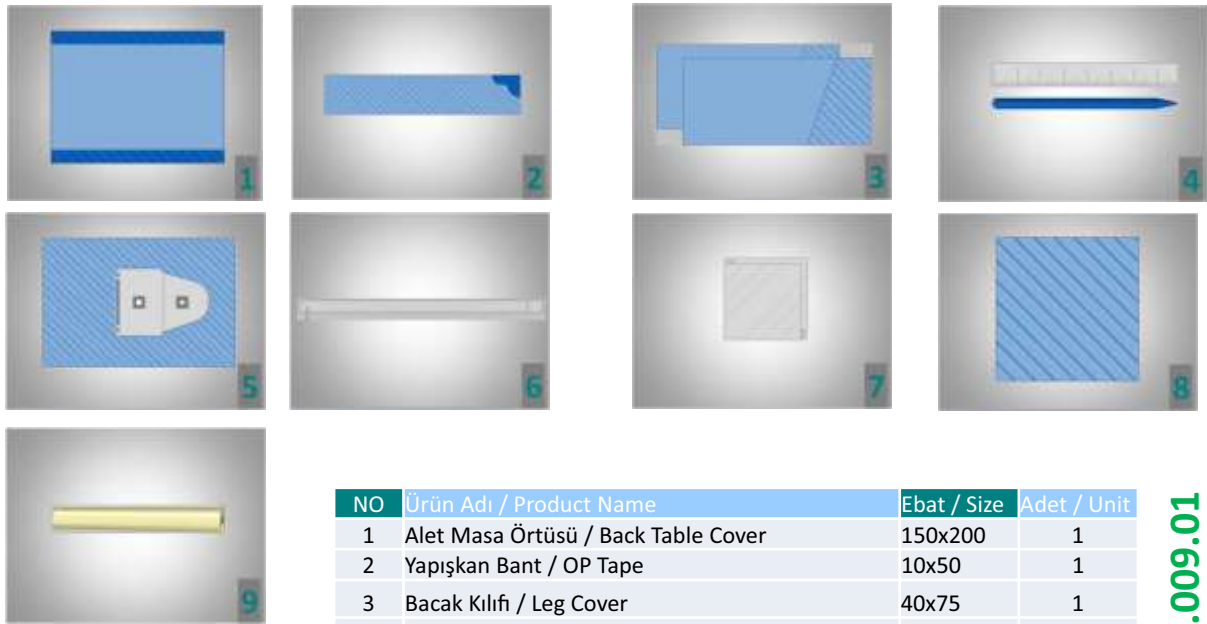

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	40x75	1
4	Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Atroskopi Örtüsü Likit Toplamalı / Arthroscopy Drape with Pouch	200x300	1
6	Kamera Kılıfı / Tube Cover	14x250	1
7	Havlü / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1

Ref. Code Z10.009.01

Disposable Steril Poşlu Atroskopi Seti-3 / Disposable Sterile Arthroscopy Pack with Pouch-3



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	40x75	1
4	Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Atroskopi Örtüsü Likit Toplamalı / Arthroscopy Drape with Pouch	200x300	1
6	Kamera Kılıfı / Tube Cover	14x250	1
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1

Ref. Code Z10.009.01

Disposable Steril Hip Seti / Disposable Hip Pack



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Röntgen Kaset Torbası / X - Ray Cassette Bag	60x80	2
3	'U' Yarıklı Örtü / "U" Split Drape	150x300	1
4	'U' Yarıklı Örtü PE / "U" Split Drape PE	150x200	1
5	Anestezi Örtüsü / Anesthesie Drape	150x240	1
6	Ayak Örtüsü / Foot Drape	160x180	1
7	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x120	2
8	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
9	Havlu / Towel	40x40	2
10	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.008.01


Disposable Steril Hip Seti-2 / Disposable Hip Pack-2



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Röntgen Kaset Torbası / X - Ray Cassette Bag	60x80	2
3	'U' Yarıklı Örtü / "U" Split Drape	150x300	1
4	'U' Yarıklı Örtü PE / "U" Split Drape PE	150x200	1
5	Anestezi Örtüsü / Anesthesie Drape	150x240	1
6	Ayak Örtüsü / Foot Drape	160x180	1
7	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x120	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Havlü / Towel	40x40	2

Ref. Code **Z10.008.01**


Disposable Steril Kalça Set / Disposable Sterile Hip Surgery Pack

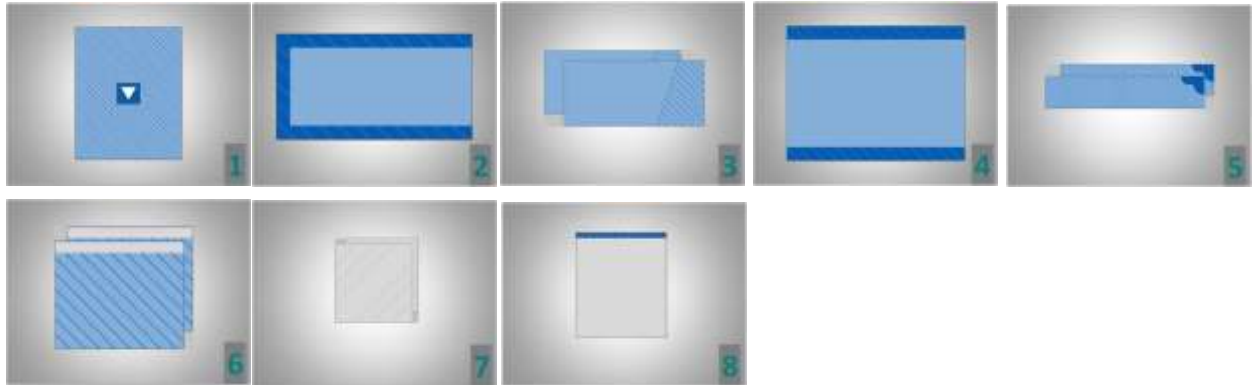

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Kalça Örtüsü Elastik Açıklık / Hip Drape with Elastic Fenestration	240x300	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	2
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	2
7	Havlü / Towel	40x40	2
8	Atık Poşeti / Waste Bag	33x38	1

Ref. Code **10.012.01**


Disposable Steril Kalça Set-2 / Disposable Sterile Hip Surgery Pack-2

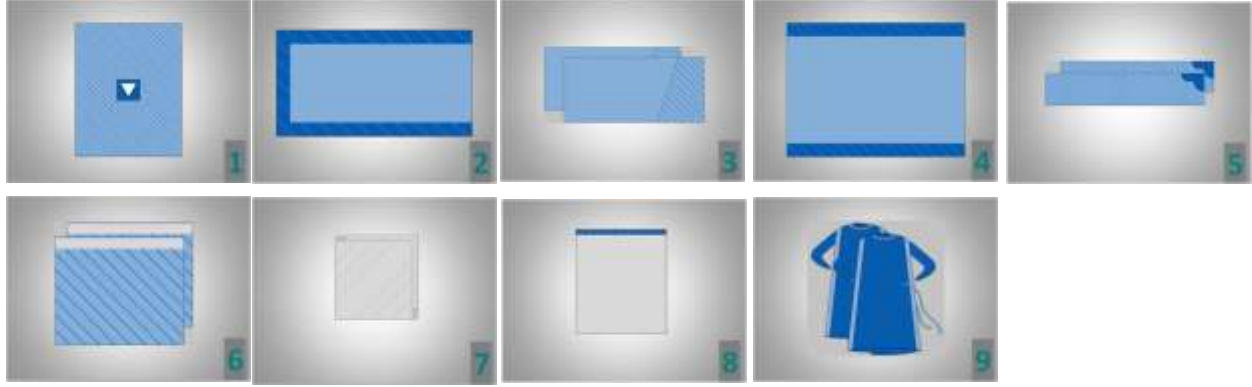

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Kalça Örtüsü Elastik Açıklık / Hip Drape with Elastic Fenestration	240x300	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	2
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	2
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Atık Poşeti / Waste Bag	33x38	1
9	Korunmalı Cerrahi Önlük / Rein Forcet Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.012.01


Disposable Steril Laminektomi Seti / Disposable Sterile Laminectomy Pack

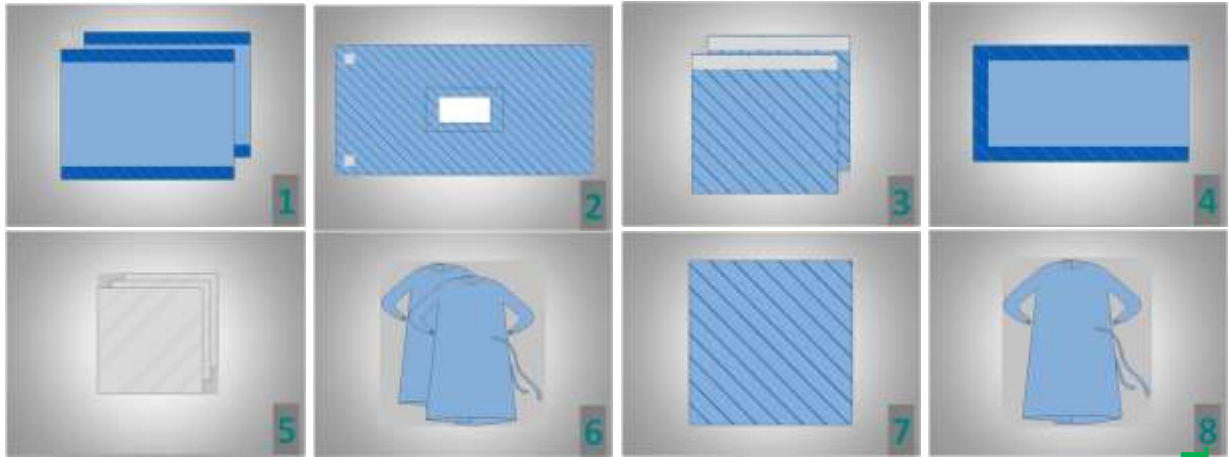

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Spinal Vertebra Örtüsü (İnsuzyon Film) / Spinal Vertebra Drape with Incise Film	150x300	1
3	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Havlu / Towel	40x40	3
6	Standart Cerrahi Önlük / Standart Surgical Gown	XL	2
7	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
8	Standart Cerrahi Önlük / Standart Surgical Gown	M	1

Ref. Code Z10.024.01


Disposable Steril Laminektomi Seti -2/ Disposable Sterile Laminectomy Pack-2

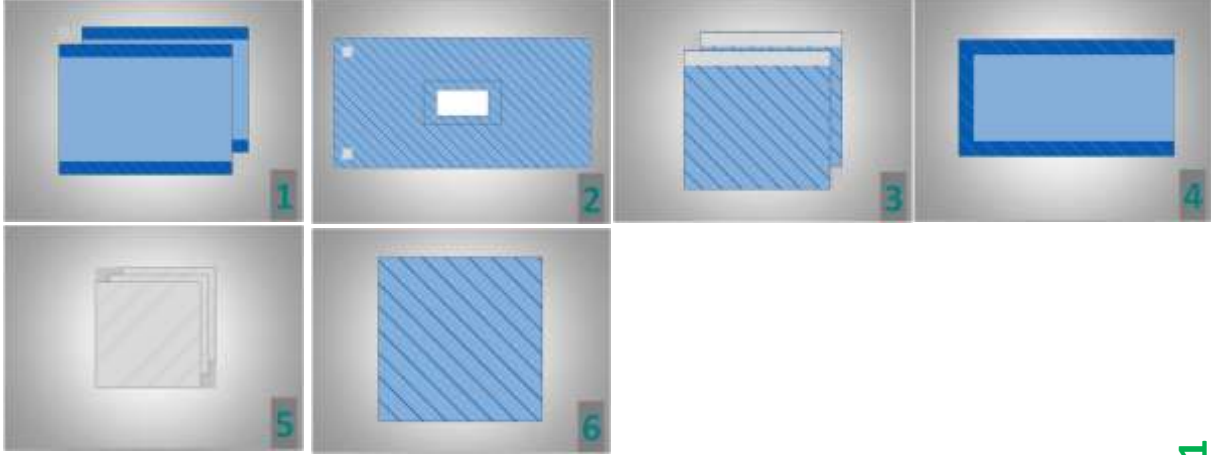

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Spinal Vertebra Örtüsü (İnsuzyon Film) / Spinal Vertebra Drape with Incise Film	150x300	1
3	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
4	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
5	Havlu / Towel	40x40	3
6	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.024.01


Disposable Steril Omuz Artroskopi Seti Elastik Açıklık / Disposable Sterile Shoulder Arthroscopy Pack (with Elastic Fenestration)

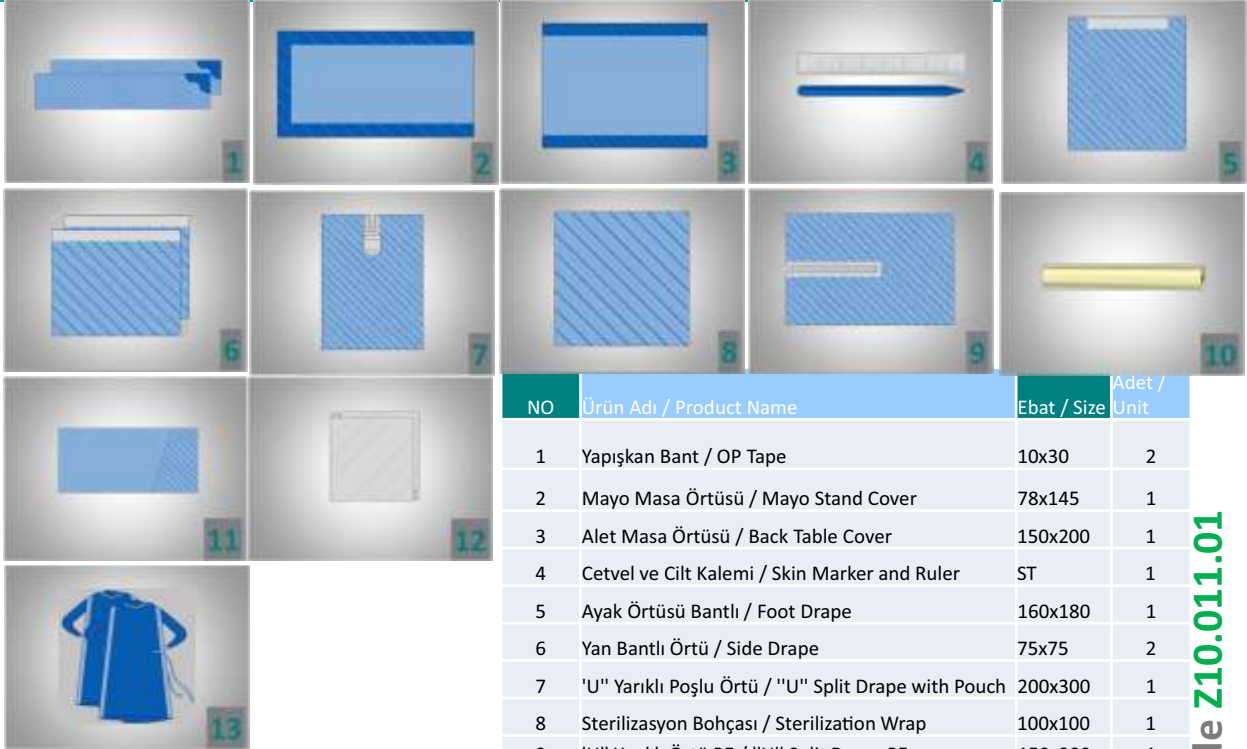

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Yapışkan Bant / OP Tape	10x30	2
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Cetvel ve Cilt Kalem / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180	1
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	2
7	'U' Yarıklı Poşlu Örtü / "U" Split Drape with Pouch	200x300	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	'U' Yarıklı Örtü PE / "U" Split Drape PE	150x200	1
10	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1
11	Stokinet / Stockinette	30x60	1
12	Havlu / Towel	40x40	2
13	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.011.01


Disposable Steril Omuz Artroskopi Seti Elastik Açıklık -2/ Disposable Sterile Shoulder Arthroscopy Pack
(with Elastic Fenestration)-2

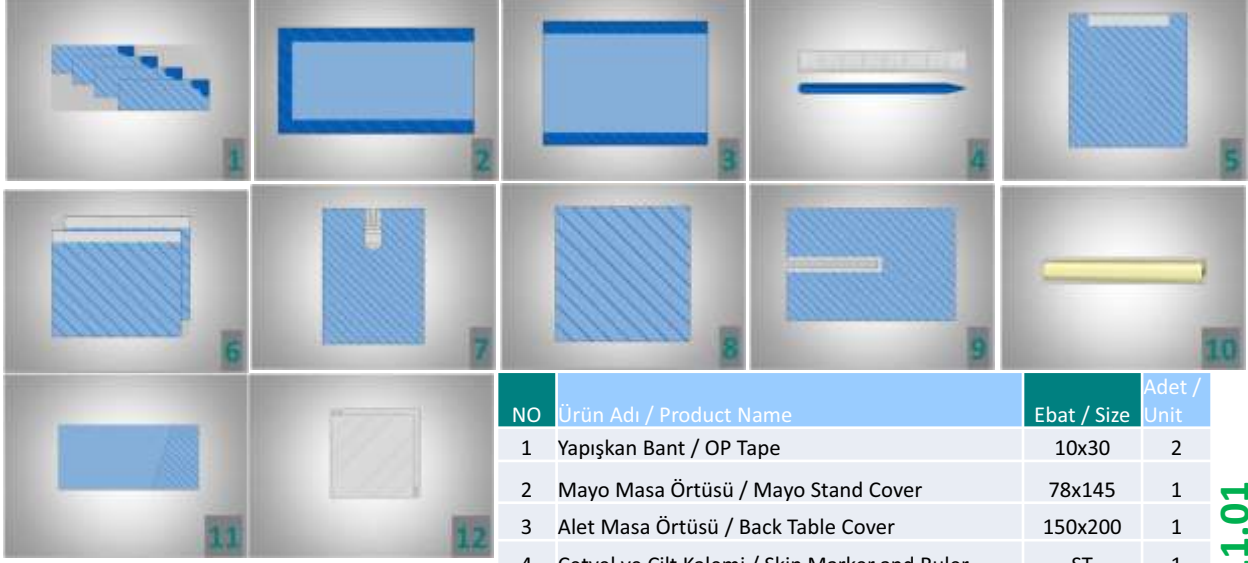

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Yapışkan Bant / OP Tape	10x30	2
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180	1
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	2
7	'U' Yarıklı Poşlu Örtü / "U" Split Drape with Pouch	200x300	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	'U' Yarıklı Örtü PE / "U" Split Drape PE	150x200	1
10	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1
11	Stokinet / Stockinette	30x60	1
12	Havlu / Towel	40x40	2

Ref. Code Z10.011.01


Disposable Steril Omuz Artroskopi Seti Elastik Açıklık / Disposable Sterile Shoulder Arthroscopy Pack (with Elastic Fenestration)

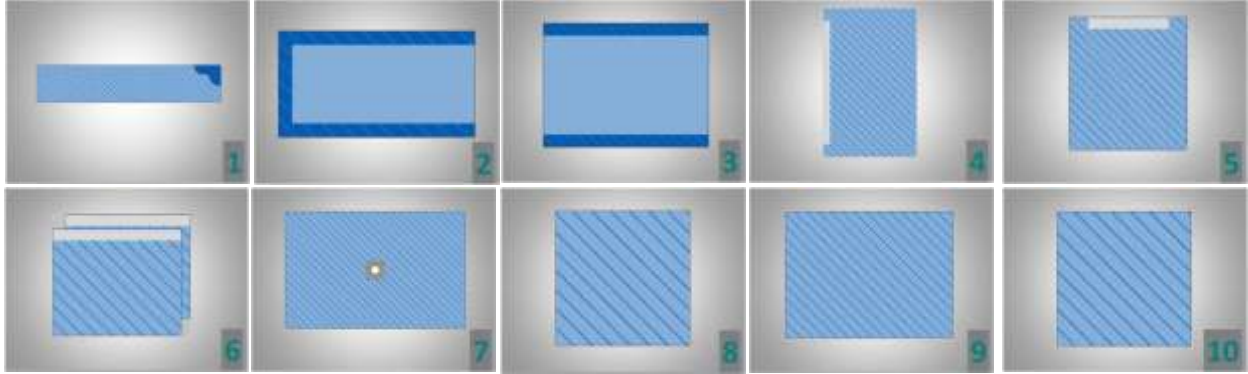

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
5	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180	1
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	2
7	Extremite Örtüsü Elastik Açıklık / Extremity Drape with Elastic Fenestration	200x300	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Düz Örtü / Basic Drape	100x120	1
10	PE Örtü / PE Drape	100x100	1
11	Stokinet / Stockinette	30x60	1
12	Havlu / Towel	40x40	2
13	Korunmalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.064.01


Disposable Steril Omuz Artroskopi Seti Elastik Açıklık -2/ Disposable Sterile Shoulder Arthroscopy Pack
(with Elastic Fenestration) -2

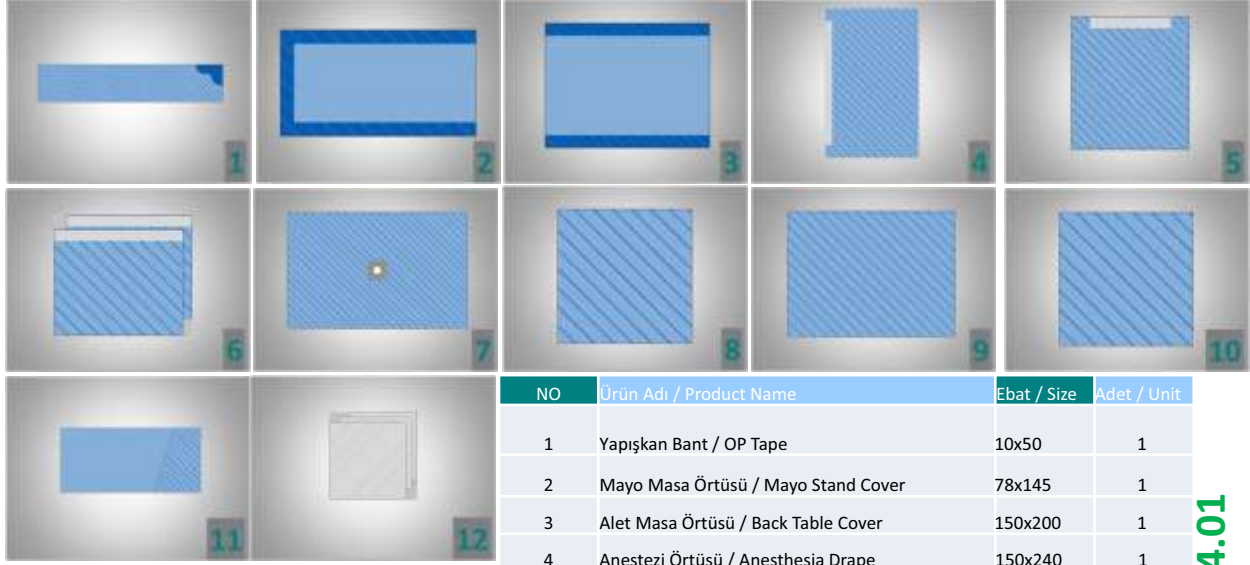

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
5	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180	1
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	2
7	Ekstremité Örtüsü Elastik Açıklık / Extremity Drape with Elastic Fenestration	200x300	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Düz Örtü / Basic Drape	100x120	1
10	PE Örtü / PE Drape	100x100	1
11	Stokinet / Stockinette	30x60	1
12	Havlu / Towel	40x40	2

Ref. Code Z10.064.01


Disposable Steril Poşsuz Artroskopi Seti/ Disposable Sterile Arthroscopy Pack without Pouch

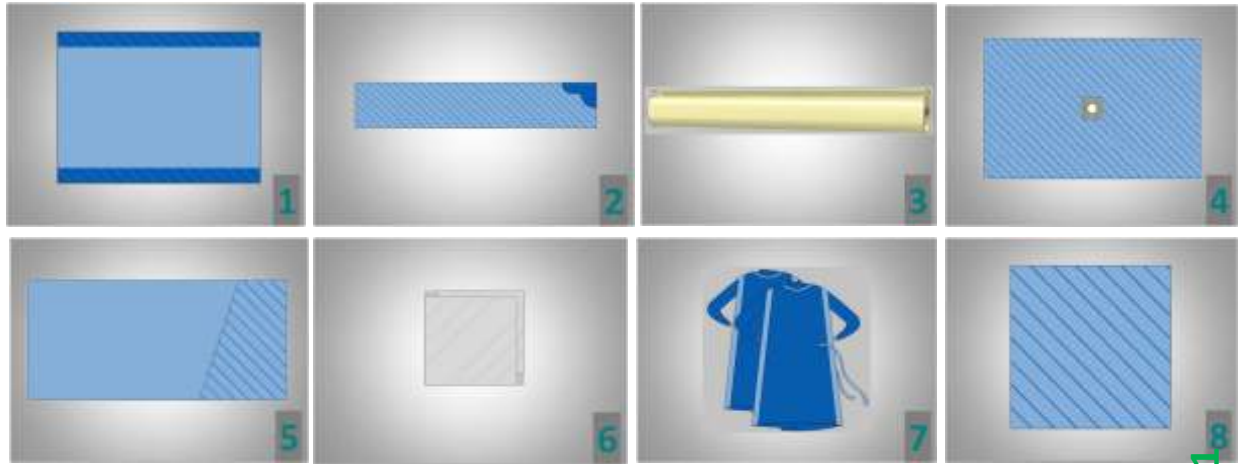

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
3	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1
4	Alt Ekstremité Örtüsü / Sub - Extremity Drape	200x310	1
5	Bacak Kılıfı / Leg Cover	40x75	1
6	Havlu / Towel	40x40	2
7	Korunmalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.058.01


Disposable Steril Poşuz Atroskopi Seti-2/ Disposable Sterile Arthroscopy Pack without Pouch-2

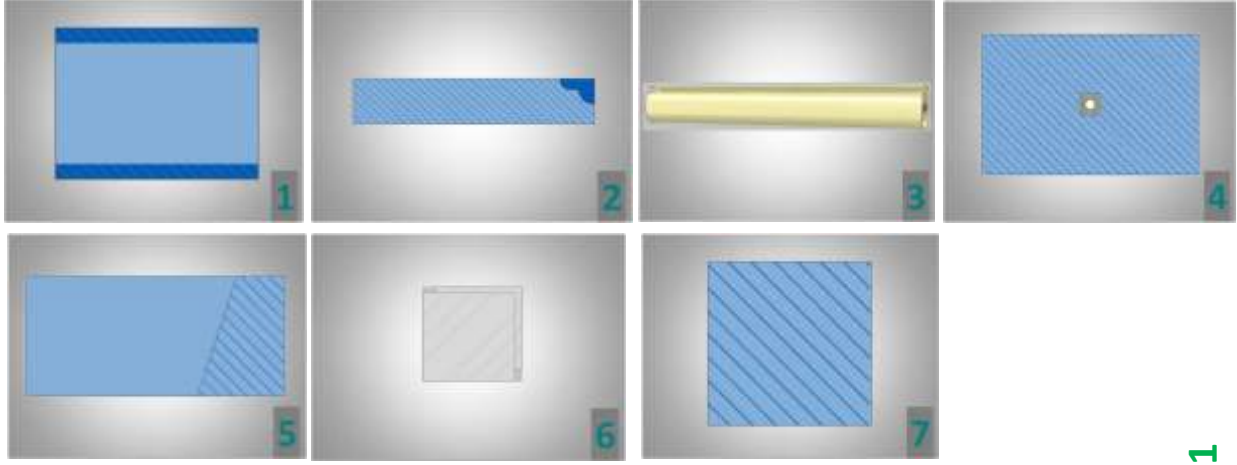

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
3	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1
4	Alt Ekstremité Örtüsü / Sub - Extremity Drape	200x310	1
5	Bacak Kılıfı / Leg Cover	40x75	1
6	Havlu / Towel	40x40	2
7	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.058.01


Disposable Steril Vertikal İzolasyon Örtü Seti / Disposable Sterile Vertical Isolation Drape Pack

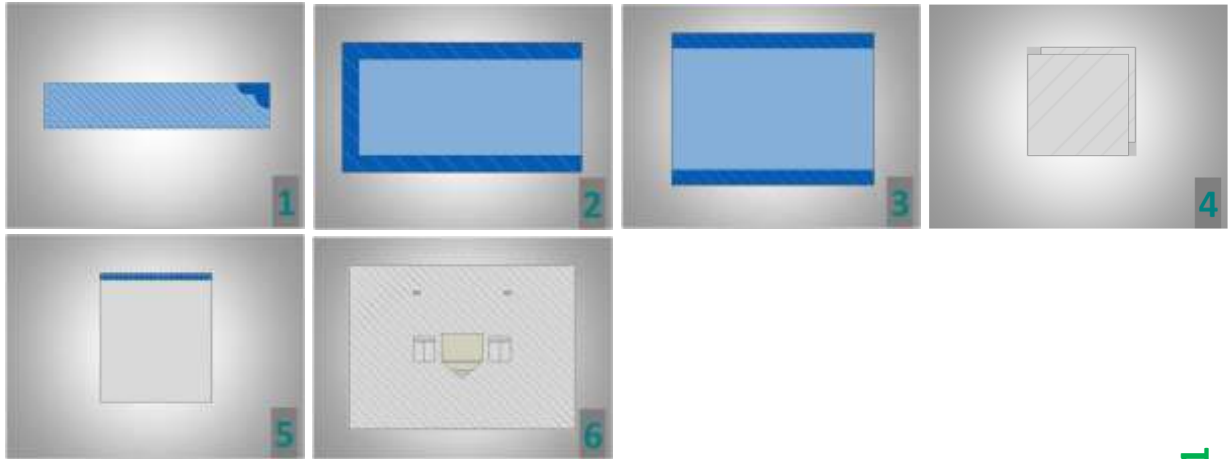

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Atık Poşeti / Waste Bag	33x38	1
6	Vertikal İzolasyon Örtü / Vertical Isolation Drape	240x330	1

Ref. Code Z10.013.01


Disposable Steril Üst Extremité Seti / Disposable Sterile Upper Extremity Pack

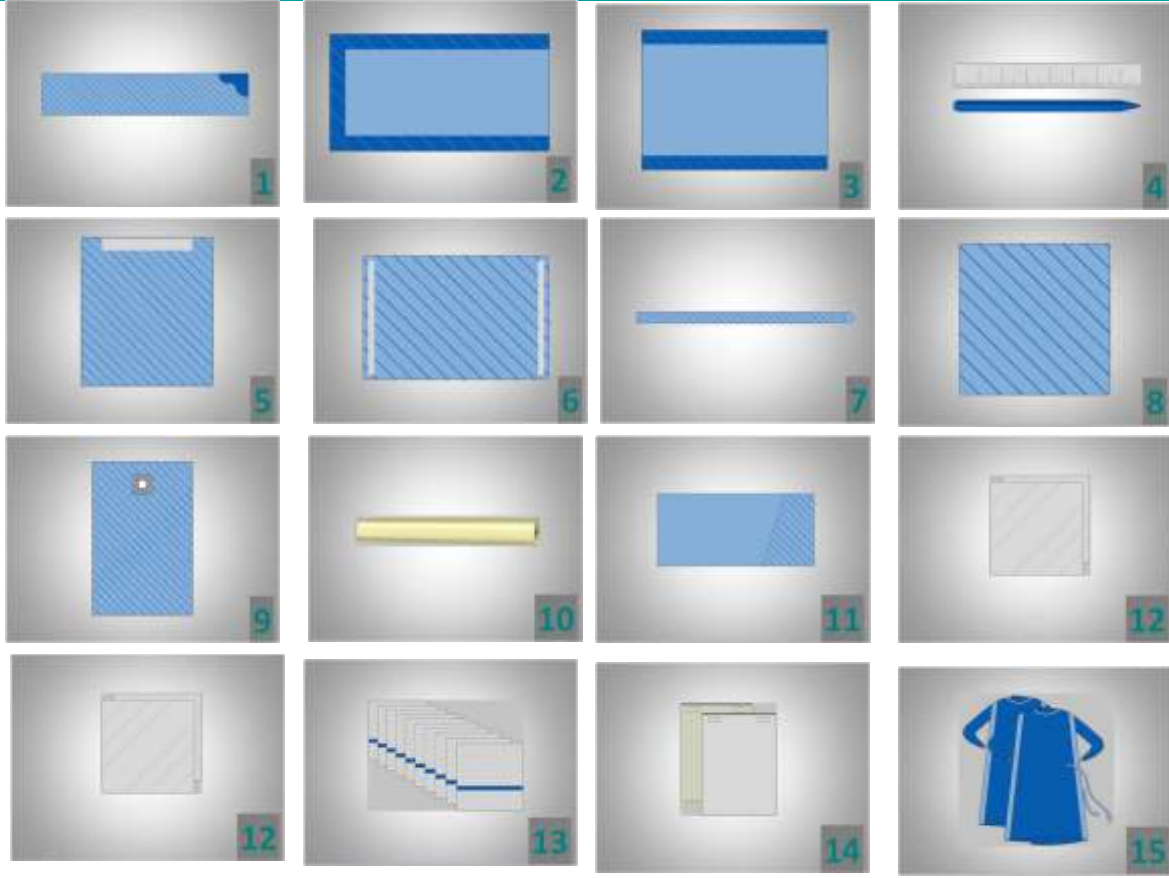

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Yapışkan Bant / OP Tape	10x30	2
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180	1
6	El Altı Örtüsü / Arm Drape	100x150	1
7	Esmach / Esmach	5x200	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Üst Extremité Örtüsü / Upper-Extremity Drape	160x240	1
10	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1
11	Stokinet / Stockinette	30x60	1
12	Havlu / Towel	40x40	2
13	Gaz Spanç / Gauze Swab	10x10	10
14	Röntgen Kaset Torbası / X - Ray Cassette Bag	60x80	2
15	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.010.01

Disposable Steril Üst Extremité Seti -2 / Disposable Sterile Upper Extremity Pack - 2

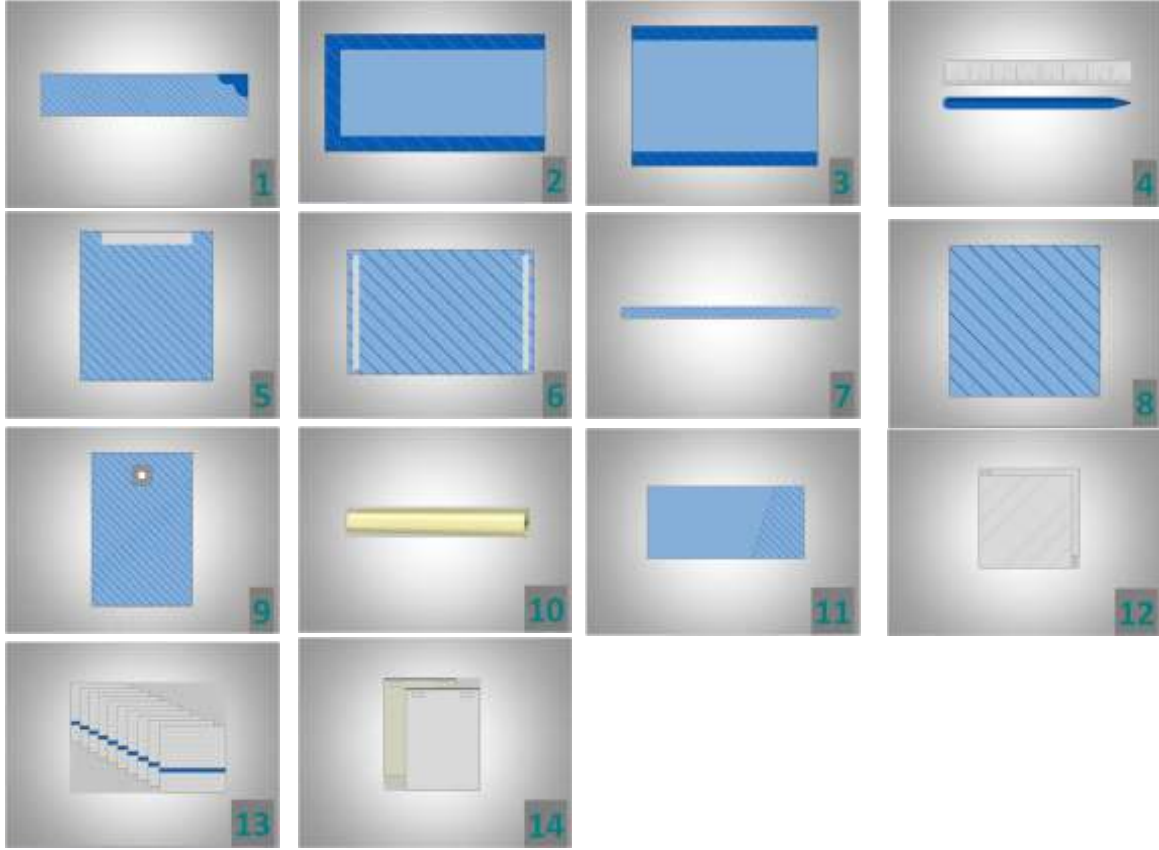

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Yapışkan Bant / OP Tape	10x30	2
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
4	Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler	ST	1
5	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180	1
6	El Altı Örtüsü / Arm Drape	100x150	1
7	Esmach / Esmach	5x200	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
9	Üst Extremité Örtüsü / Upper-Extremity Drape	160x240	1
10	Elastik Bandaj / Elastic Bandage	10x150	1
11	Stokinet / Stockinette	30x60	1
12	Havlu / Towel	40x40	2
13	Gaz Spanç / Gauze Swab	10x10	10
14	Röntgen Kaset Torbası / X - Ray Cassette Bag	60x80	2


Ref. Code Z10.010.02



JİNEKOLOJİ

GYNECOLOGY


Disposable Steril Acil Doğum Seti / Disposable Sterile Emergency Delivery Pack

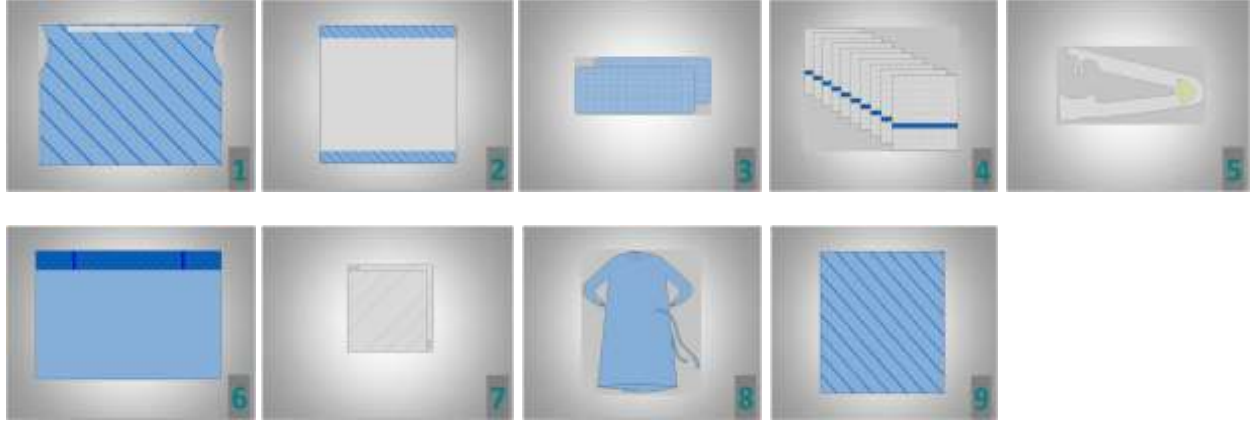

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Abdominal Örtü / Abdominal Drape	100x120	1
2	Bebek Örtüsü / Baby Drape	100x100	1
3	Doğum Pedi / Maternity Pad	L	2
4	Gaz Spanç / Gauze Swab	7,5x7,5	10
5	Göbek Klempi / Umbilical Clamp	ST	1
6	Hasta Alt Örtüsü / Underbuttocks Drape	75x100	1
7	Havlu / Towel	40x40	1
8	Standart Cerrahi Önlük / Standart Surgical Gown	L	1
9	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.017.01


Disposable Steril Doğum Seti Poşlu / Disposable Sterile Delivery Pack with Pouch

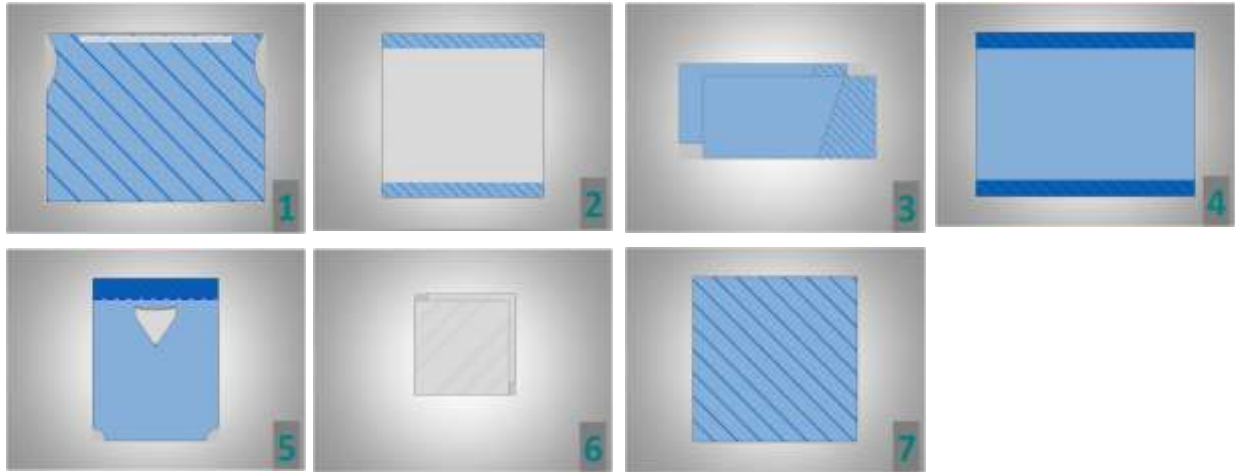

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Abdominal Örtü / Abdominal Drape	100x120	1
2	Bebek Örtüsü / Baby Drape	100x100	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Hasta Alt Örtüsü Poşlu / Underbuttocks Drape with Pouch	100x130	1
6	Havlu / Towel	40x40	1
7	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.016.01


Disposable Steril Doğum Seti / Disposable Sterile Delivery Pack

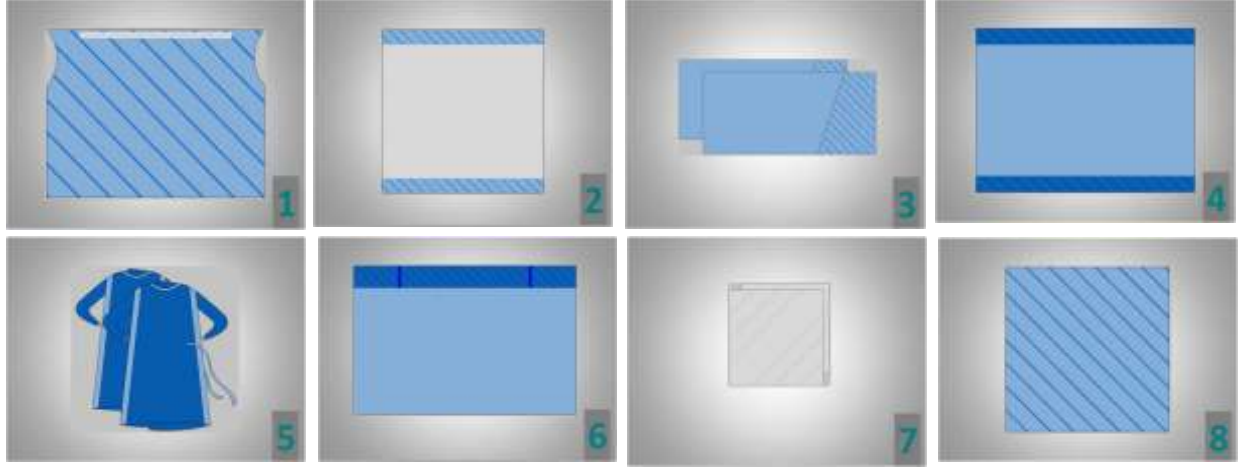

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Abdominal Örtü / Abdominal Drape	100x120	1
2	Bebek Örtüsü / Baby Drape	100x100	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
6	Hasta Alt Örtüsü / Underbuttocks Drape	75x100	1
7	Havlu / Towel	40x40	1
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.016.01


Disposable Steril Doğum Seti-2 / Disposable Sterile Delivery Pack-2

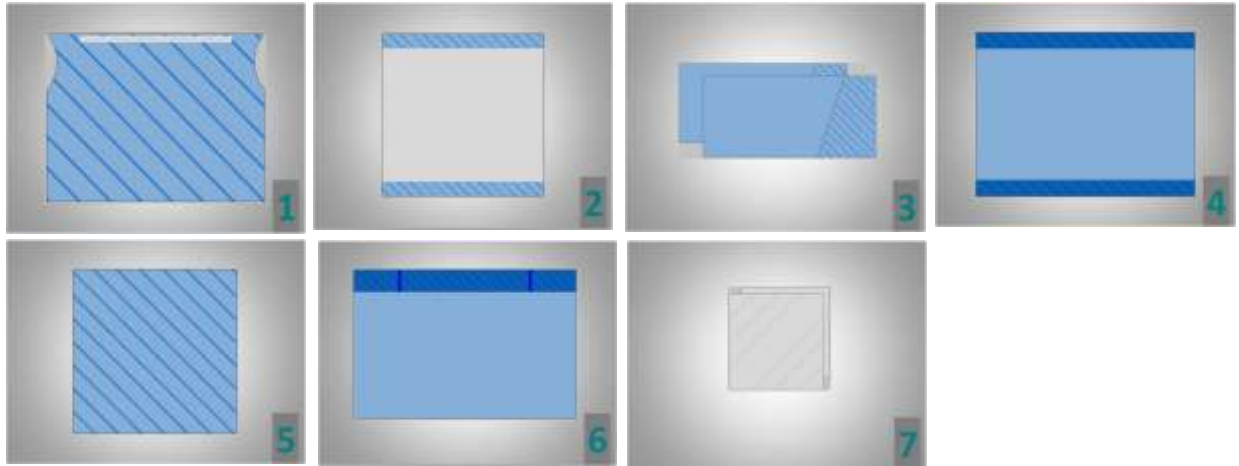

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Abdominal Örtü / Abdominal Drape	100x120	1
2	Bebek Örtüsü / Baby Drape	100x100	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
6	Hasta Alt Örtüsü / Underbuttocks Drape	75x100	1
7	Havlu / Towel	40x40	1

Ref. Code Z10.016.01

Disposable Steril Jinekoloji OPU Set/ Disposable Sterile Gynaecology Opu Pack

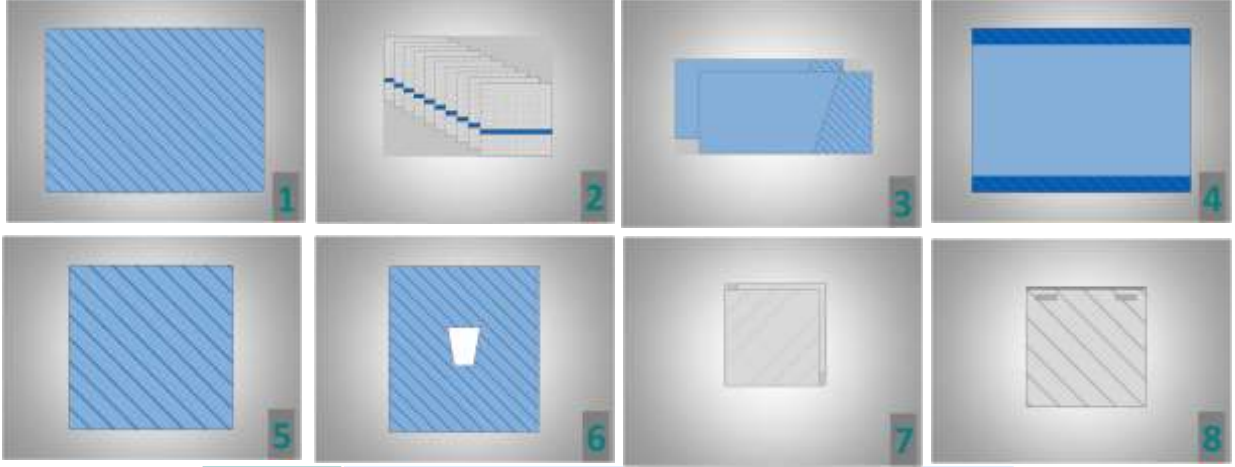

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Düz Örtü / Basic Drape	80x90	1
2	Gaz Spanç / Gauze Swab	7,5x7,5	10
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
6	O.P.U. Örtüsü (Delikli) / OPU Drape, Fenestrated	135x150	1
7	Havlu / Towel	40x40	1
8	Yapışkan Bantlı Şeffaf Örtü PE / Transparent PE Adhesive Drape	60x60	1

Ref. Code Z10.019.01


Disposable Steril Jinekoloji OPU Set-2/ Disposable Sterile Gynaecology Opu Pack-2



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Düz Örtü / Basic Drape	80x90	1
2	Gaz Spanç / Gauze Swab	7,5x7,5	10
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
6	O.P.U. Örtüsü (Delikli) / OPU Drape, Fenestrated	135x150	1
7	Havlu / Towel	40x40	1
8	Yapışkan Bantlı Şeffaf Örtü PE / Transparent PE Adhesive Drape	60x60	1

Ref. Code Z10.019.01


Disposable Steril Jinekoloji Set/ Disposable Sterile Gynaecology Pack

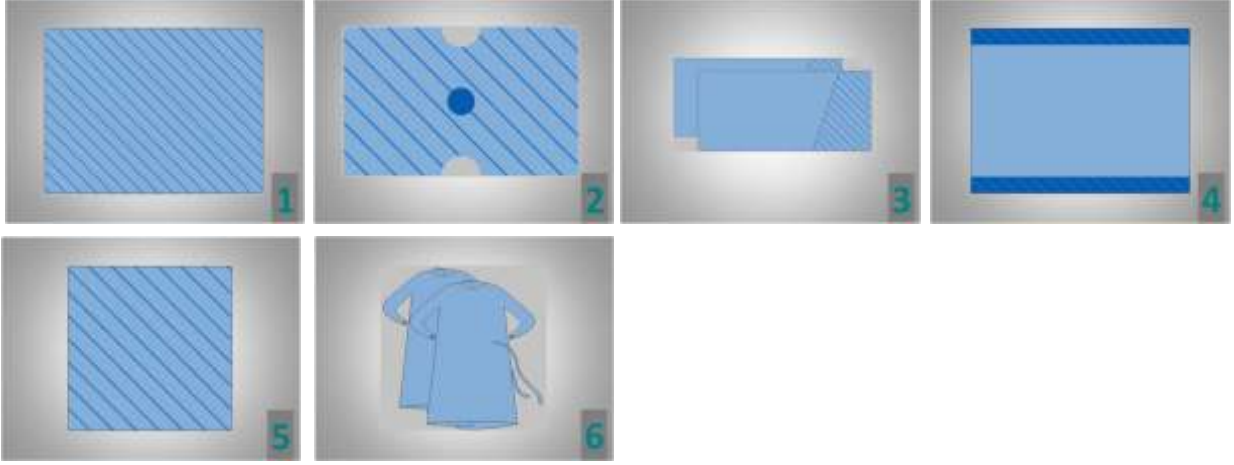

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Düz Örtü / Basic Drape	80x90	1
2	Jinekoloji Örtüsü / Gynaecology Drape	75x120	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
6	Standart Cerrahi Önlük / Standart Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.021.01

Disposable Steril Jinekoloji Seti Poşlu / Disposable Sterile Gynaecology Pack (with Pouch)

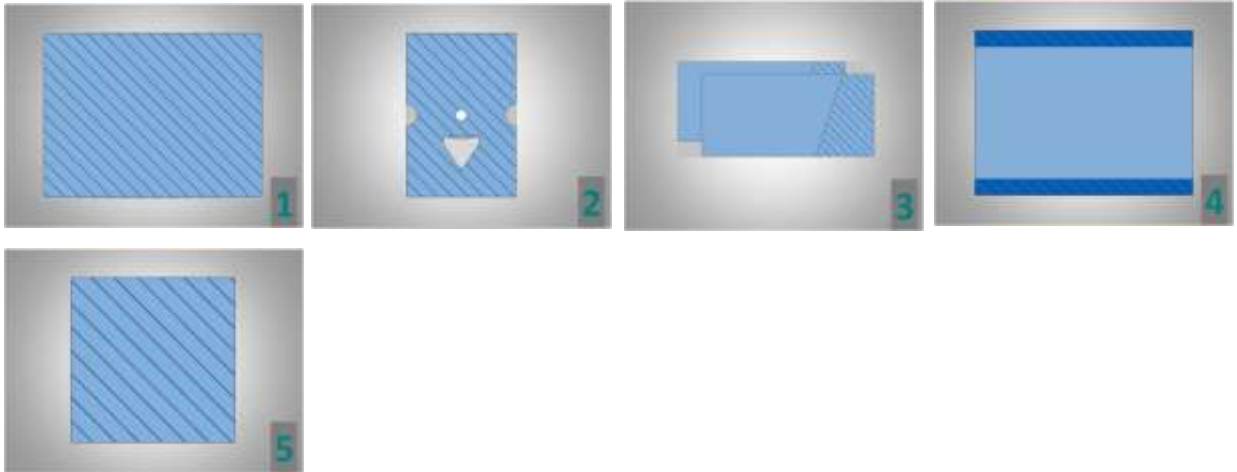

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Düz Örtü / Basic Drape	100x150	1
2	Jinekoloji Örtüsü Poşlu / Gynaecology Drape with Pouch	100x150	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x110	2
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.019.01

Disposable Steril Litotomi Jinekoloji Seti / Disposable Sterile Lithotomy Gynaecology Pack



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Litotomik Poşlu Jinekoloji Örtüsü / Lithotomy Gynaecology Drape with Pouch	240x240	1
3	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	75x75	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Tüp Tutucu (Bantlı Cırt) / Tube Holder (Velcro)	2,5x30	1

Ref. Code Z10.022.01


Disposable Steril Litotomi Jinekoloji Seti-2 / Disposable Sterile Lithotomy Gynaecology Pack-2



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Litotomik Poşlu Jinekoloji Örtüsü / Lithotomy Gynaecology Drape with Pouch	240x240	1
3	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	75x75	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Tüp Tutucu (Bantlı Cırt) / Tube Holder (Velcro)	2,5x30	1
6	Standart Cerrahi Önlük / Standart Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.021.01


Disposable Steril L.T.T. Sezeryan Set/ Disposable Sterile Cesarian Section Pack

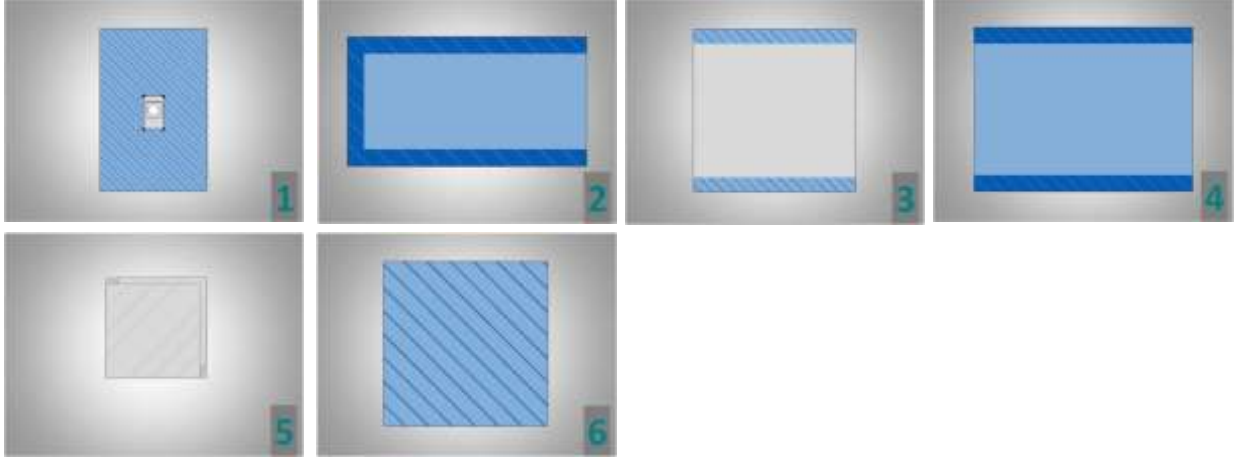

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Sezeryan Örtüsü L.T.T. / Section Drape with Pouch	200x300	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Bebek Örtüsü / Baby Drape	100x100	1
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Havlu / Towel	40x40	2
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1


Ref. Code Z10.018.01

Disposable Steril L.T.T. Sezeryan Set-2/ Disposable Sterile Cesarian Section Pack-2

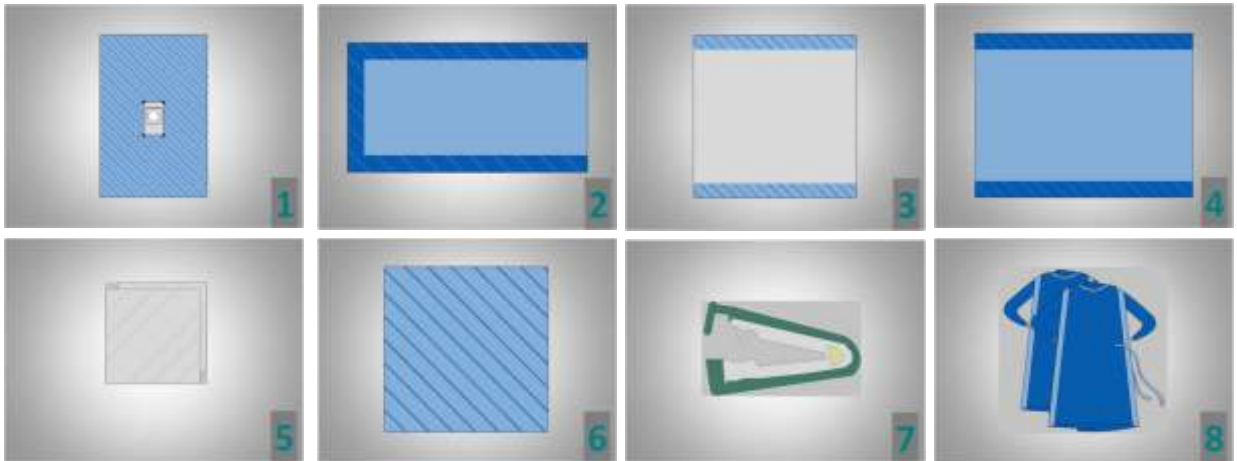

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Sezeryan Örtüsü L.T.T. / Section Drape with Pouch	200x300	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Bebek Örtüsü / Baby Drape	100x100	1
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Havlu / Towel	40x40	2
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
7	Göbek Klempsi Otomatik / Umbilical Clamp (Automatic)	ST	1
8	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.018.01

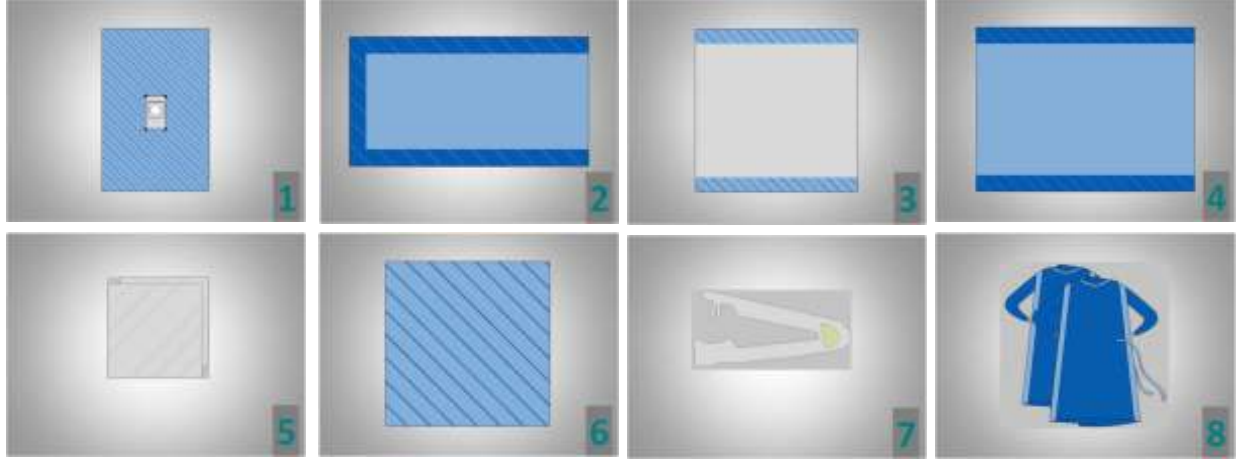**ZENMED**TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**JİNEKOLOJİ - GYNECOLOGY****Disposable Steril L.T.T. Sezeryan Set-3/ Disposable Sterile Cesarian Section Pack-3**

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Sezeryan Örtüsü L.T.T. / Section Drape with Pouch	200x300	1
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Bebek Örtüsü / Baby Drape	100x100	1
4	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150	1
5	Havlu / Towel	40x40	2
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
7	Göbek Klempi / Umbilical Clamp	ST	1
8	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2


Ref. Code Z10.018.01



ÜROLOJİ

UROLOGY


Disposable Steril Perkütan Seti/ Disposable Sterile Percutaneous Pack

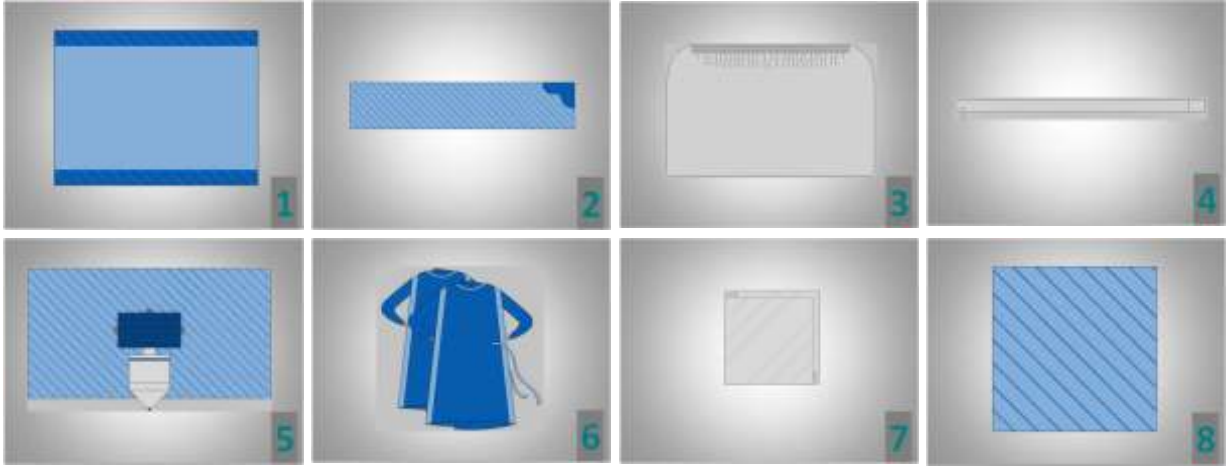

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	50x10	1
3	Scopi Kılıfı / Scopy Cover	50x80	1
4	Kamera Kılıfı / Camera Cover	12x240	1
5	Perkütan Örtüsü / Percutaneous Drape	160x300	1
6	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.004.01


Disposable Steril Perkütan Seti-2/ Disposable Sterile Percutaneous Pack-2

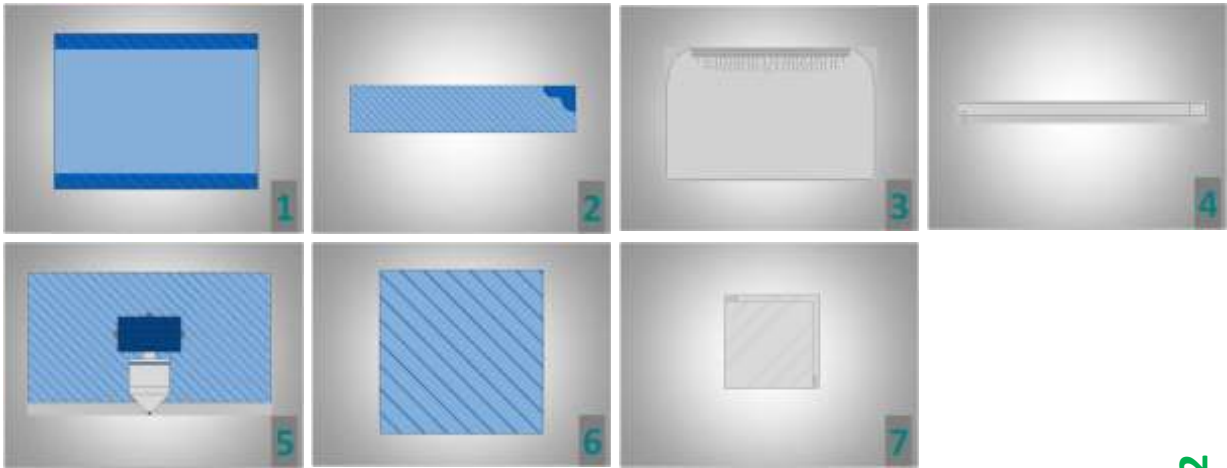

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	50x10	1
3	Scopi Kılıfı / Scopy Cover	50x80	1
4	Kamera Kılıfı / Camera Cover	12x240	1
5	Perkütan Örtüsü / Percutaneous Drape	160x300	1
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1
7	Havlu / Towel	40x40	2

Ref. Code Z10.004.02


Disposable Steril Sistoskopi Seti/ Disposable Sterile Cystoscopy Pack

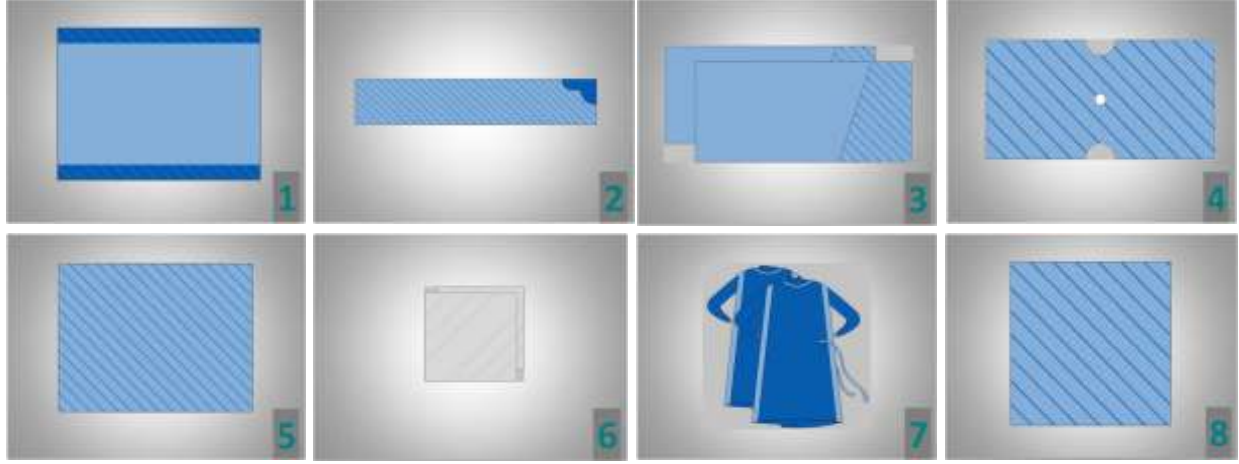

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x130	2
4	Sistoskopi Örtüsü / Cystoscopy drape	75x150	1
5	Düz Örtü / Basic Drape	75x90	1
6	Havlu / Towel	40x40	2
7	Korunmalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
8	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.005.01


Disposable Steril Sistoskopi Seti-2 / Disposable Sterile Cystoscopy Pack - 2

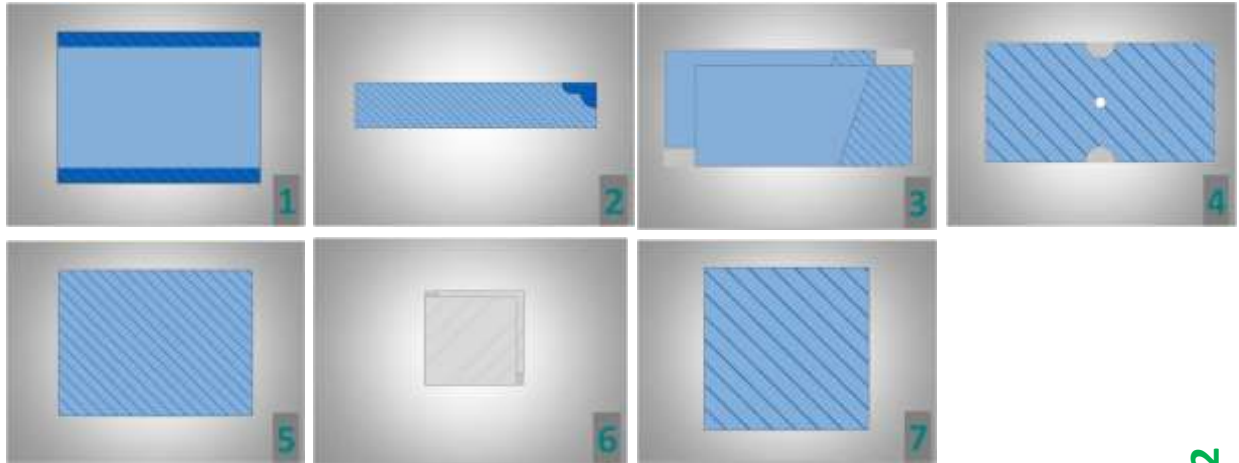

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
3	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x130	2
4	Sistoskopi Örtüsü / Cystoscopy drape	75x150	1
5	Düz Örtü / Basic Drape	75x90	1
6	Havlu / Towel	40x40	2
7	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.005.02


Disposable Steril TUR Set/ Disposable Sterile TUR Pack

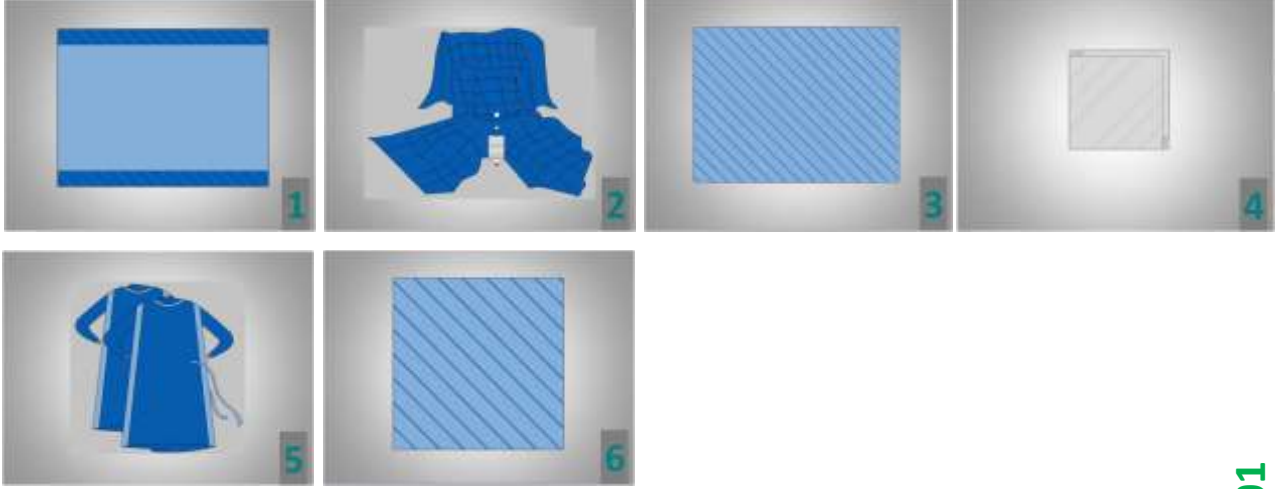

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	TUR Örtü L.T.T. / TUR Drape with Pouch	175x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	150x200	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.002.01

Disposable Steril TUR Set-2/ Disposable Sterile TUR Pack-2

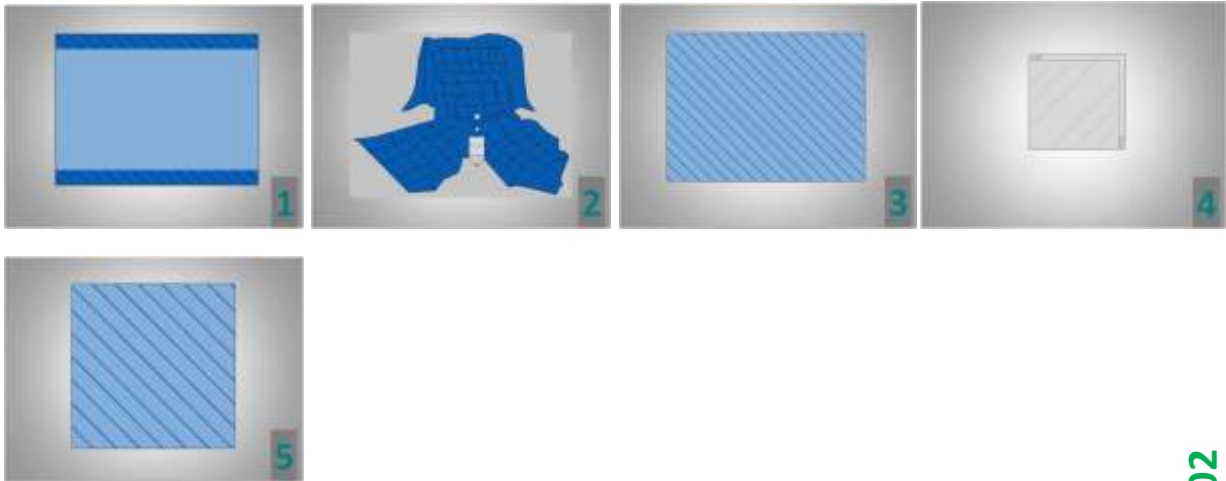

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	TUR Örtü L.T.T. / TUR Drape with Pouch	175x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	150x200	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.002.02


Disposable Steril Üroloji Set / Disposable Sterile Urology Pack



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Üroloji Örtüsü / Urology Drape	175x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	160x200	1
4	Bohça / Wrapping	50x60	1
5	Havlu / Towel	40x40	2
6	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2
7	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.003.01

Disposable Steril Üroloji Set-2 / Disposable Sterile Urology Pack-2

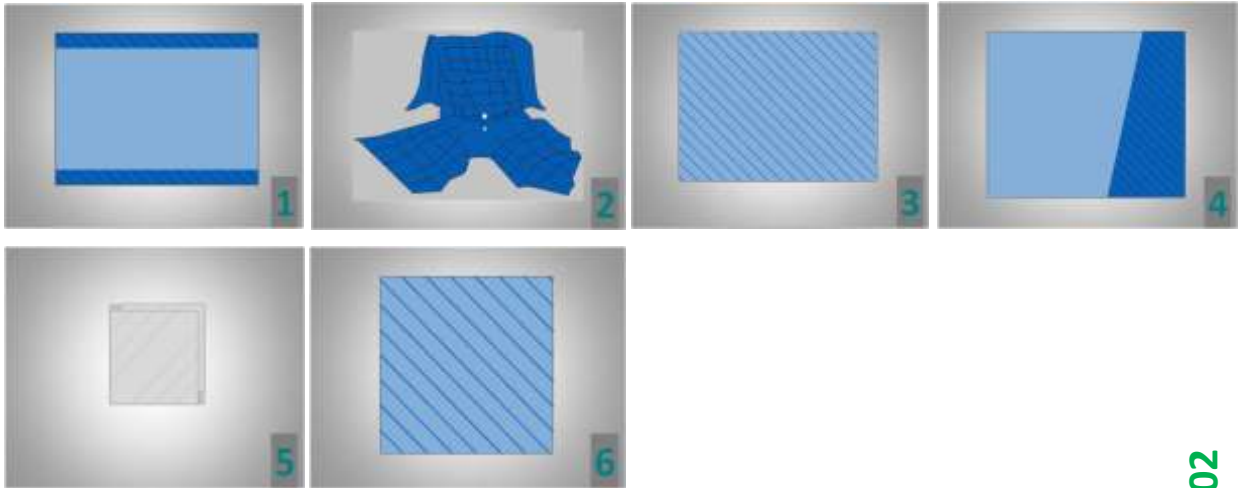


NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Üroloji Örtüsü / Urology Drape	175x240	1
3	Düz Örtü / Basic Drape	160x200	1
4	Bohça / Wrapping	50x60	1
5	Havlu / Towel	40x40	2
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code Z10.003.02

**DİĞER
SETLER**

**THE OTHER
PACKS**


Disposable Steril Dental Mini Set / Disposable Sterile Dental Mini Pack

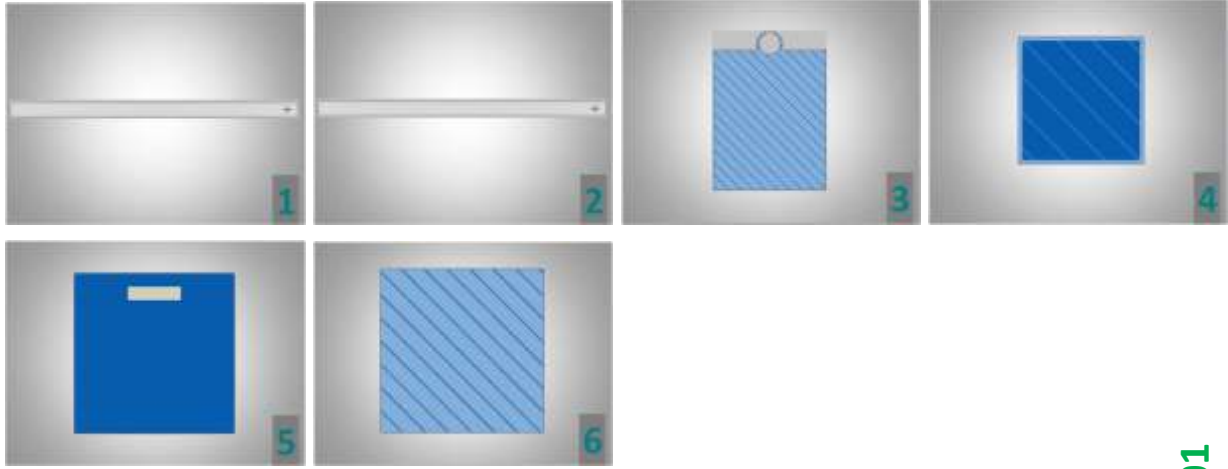

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Şeffaf Hortum Kılıfı / Transparent Tube Cover	10x200	1
2	Şeffaf Hortum Kılıfı / Transparent Tube Cover	10x60	1
3	Cırtlı Hasta Önlüğü / Patient Gown (with Velcro)	65x65	1
4	Tabla Örtüsü / Table Drape	40x46	1
5	Reflektör Drebi / Reflector Drape	15x15	1
6	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1

Ref. Code **Z10.042.01**


Disposable Steril E.T. Set/ Disposable Sterile E.T. Pack

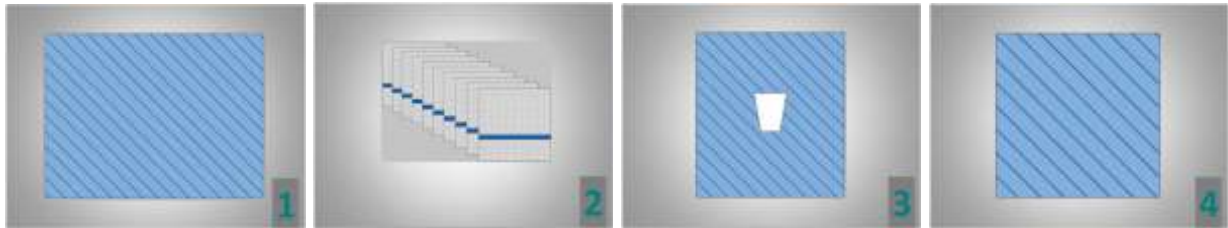

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Düz Örtü / Basic Drape	80x90	1
2	Gaz Spanç / Gauze Swab	7,5x7,5	10
3	O.P.U. Örtüsü (Delikli) / OPU Drape, Fenestrated	135x150	1
4	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	75x75	1

Ref. Code **Z10.020.01**


Disposable Steril El Cerrahi Seti / Disposable Sterile Hand Surgery Pack

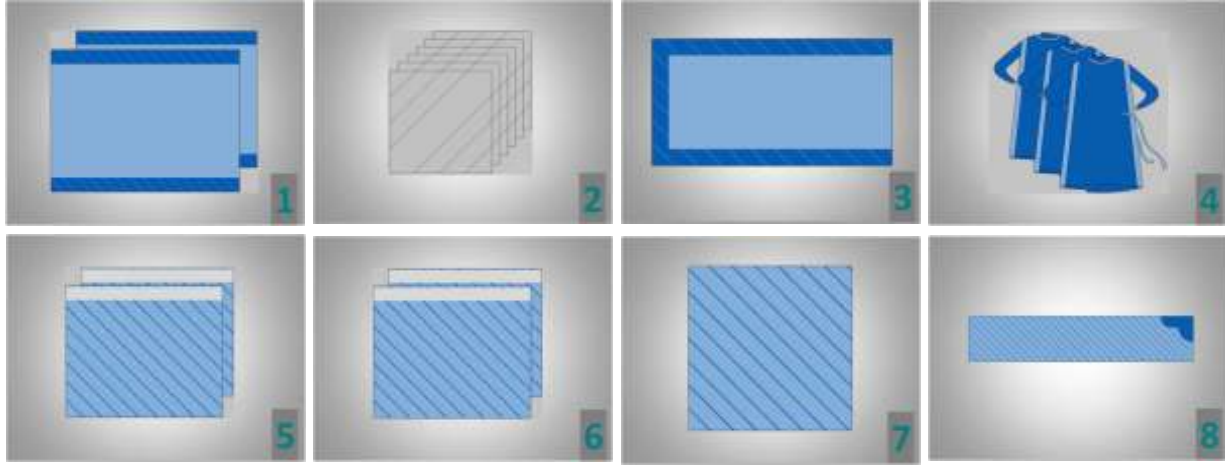

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Havlu / Towel	40x40	3
3	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
4	Korunmalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	XL	3
5	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	150x240	2
6	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x90	2
7	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
8	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1

Ref. Code **Z10.036.01**


Disposable Steril El Cerrahi Seti-2 / Disposable Sterile Hand Surgery Pack-2

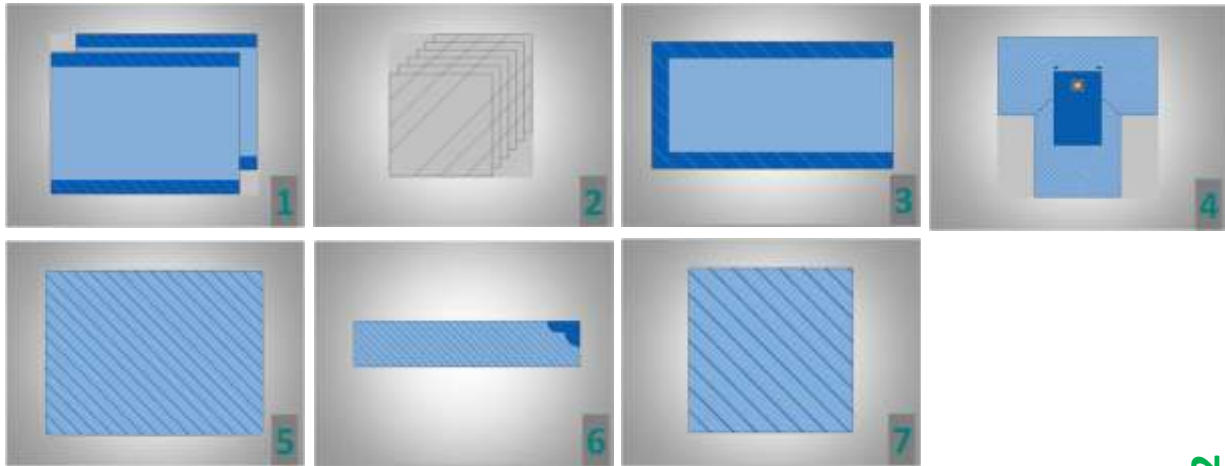

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
4	El Cerrahi Örtüsü (Elastik Açıklık) / Hand Surgery Drape with Elastic Fenestration '	200x370	1
5	El Altı Örtüsü DL (Düz Örtü) / Basic Hand Drape DL	100x150	1
6	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1
7	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1

Ref. Code **Z10.036.02**


Disposable Steril Implant Seti / Disposable Sterile Implant Pack

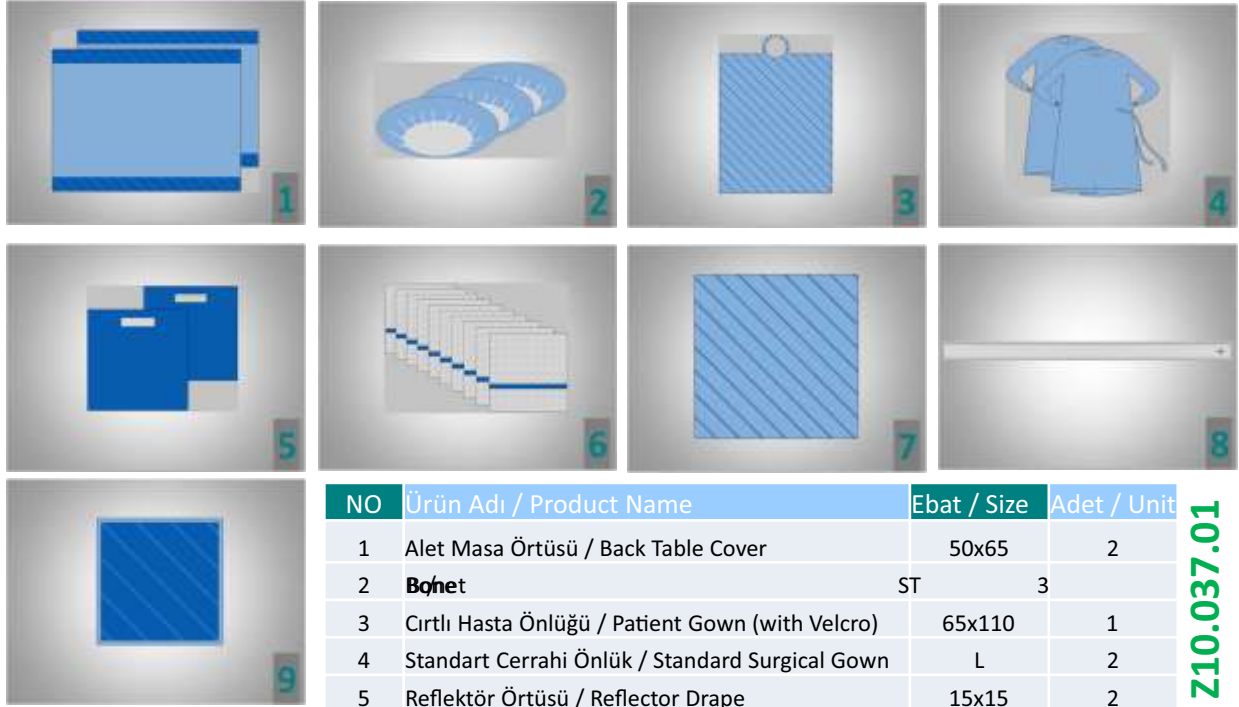

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	50x65	2
2	Bonnet	ST	3
3	Cırtlı Hasta Önlüğü / Patient Gown (with Velcro)	65x110	1
4	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	L	2
5	Reflektör Örtüsü / Reflector Drape	15x15	2
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	10x10	10
7	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
8	Şeffaf Hortum Kılıfı / Transparent Tube Cover	10x200	1
9	Tabla Örtüsü / Table Drape	50x50	1

Ref. Code **Z10.037.01**


Disposable Steril Implant Seti-2 / Disposable Sterile Implant Pack-2

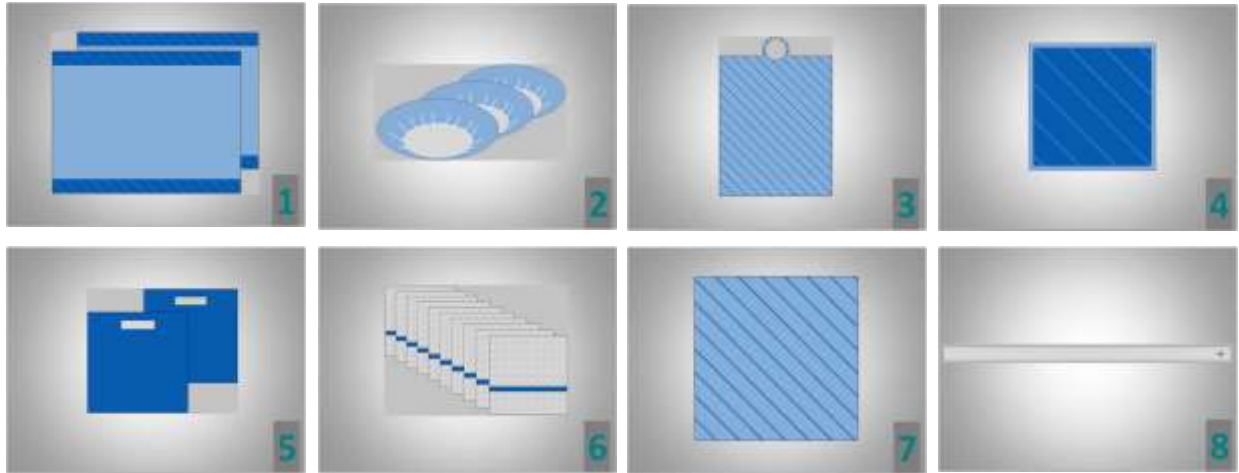

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	50x65	2
2	Bonnet	ST	3
3	Cırtlı Hasta Önlüğü / Patient Gown (with Velcro)	65x110	1
4	Tabla Örtüsü / Table Drape	50x50	1
5	Reflektör Örtüsü / Reflector Drape	15x15	2
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	10x10	10
7	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
8	Şeffaf Hortum Kılıfı / Transparent Tube Cover	10x200	1

Ref. Code **Z10.037.02**


Disposable Steril Kafa Set/ Disposable Sterile Head Pack

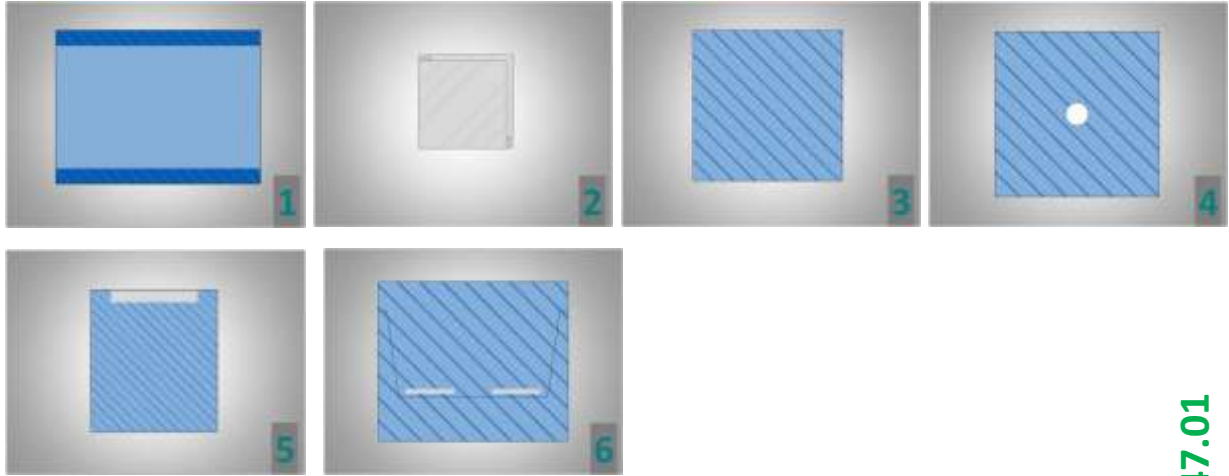

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	1
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	50x50	1
4	Delikli Örtü DL / Fenestrated Drape	150x240	1
5	Bantlı Ayak Örtüsü / Foot Drape	150x180	1
6	Baş Örtüsü Turban / Head Drape	100x120	1

Ref. Code Z10.047.01


Disposable Steril Kemoterapi Seti / Disposable Sterile Chemoterapy Pack

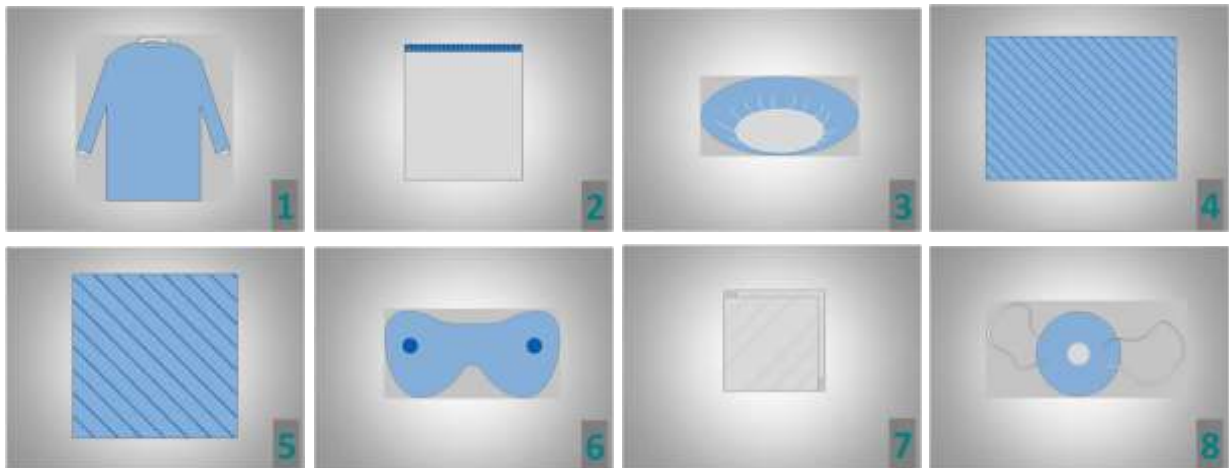

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Korumalı Kemoterapi Önlük / Reinforced Chemotherapy Gown	L	1
2	Atık Poşeti / Waste Bag	40x80	1
3	Bone / Bonnet	50x50	1
4	Düz Örtü / Basic Drape	40x80	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	75x85	1
6	Kemoterapi Gözlüğü / Chemoterapy Glases	ST	1
7	Havlu / Towel	40x40	2
8	Maske / Mask	ST	1

Ref. Code Z10.033.01


Disposable Steril Minör Cerrahi Seti / Disposable Sterile Minor Surgery Pack

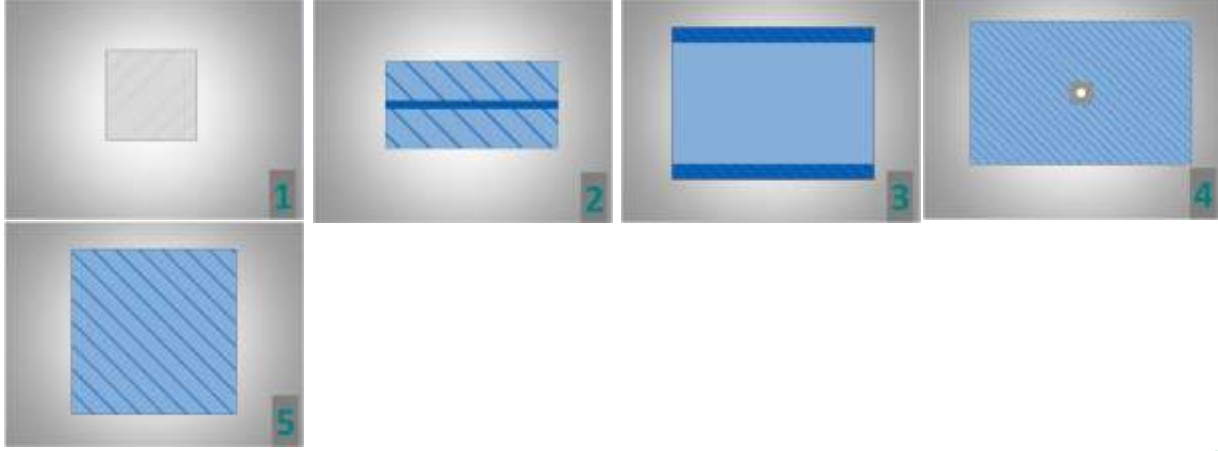

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Havlu / Towel	40x40	1
2	Yara Kapama Bandı / Wound Dressing Pack	10x20	1
3	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	50x50	1
4	Minör Cerrahi Örtüsü / Minor Surgery Drape	75x80	1
6	Sterilizasyon Bohçası / Sterilization Wrap	100x100	1

Ref. Code **Z10.031.01**


Disposable Steril Müdahale Seti / Disposable Sterile Operation Pack

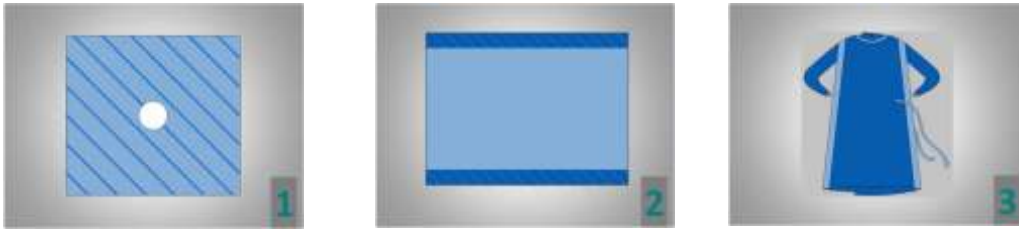

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	78x85	1
2	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x120	1
3	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	1

Ref. Code **Z10.041.01**


Disposable Steril Plastik Cerrahi Seti / Disposable Sterile Plastic Surgery Pack

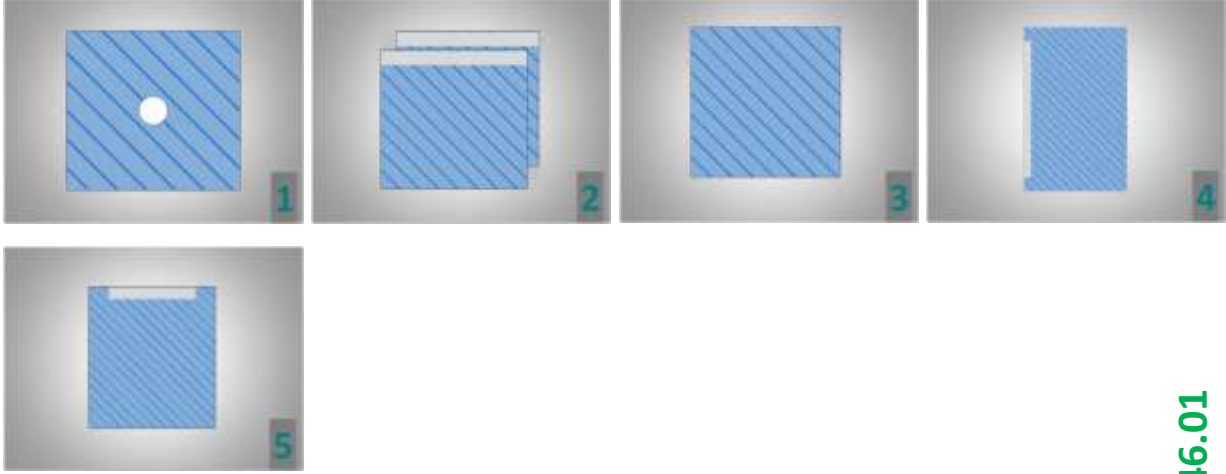

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Delikli Örtü DL / Fenestrated Drape	75x75	1
2	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	2
3	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	50x50	1
4	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240	1
5	Bantlı Ayak Örtüsü / Foot Drape	150x180	1

Ref. Code **Z10.046.01**

Disposable Steril Saç Ekim Seti / Disposable Sterile Hair-Implant Pack

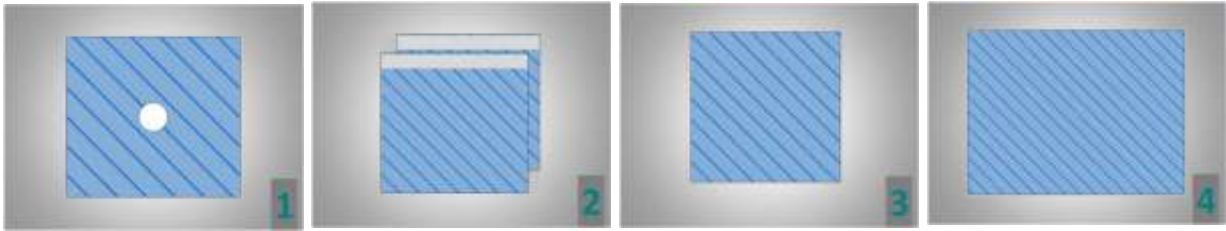

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Delikli Örtü DL / Fenestrated Drape	75x75	1
2	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	75x75	2
3	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	50x50	1
4	Düz Örtü / Basic Drape	75x75	1

Ref. Code **Z10.045.01**






Disposable Steril Sünnet Seti / Disposable Sterile Circumcision Pack



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	40x50	1
2	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	5
3	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	50x50	1

Ref. Code Z10.044.01


Disposable Steril Toraks Seti-2 / Disposable Sterile Thorax Pack-2



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	50x65	2
2	Havlu / Towel	40x40	2
3	Toraks Örtüsü (35x45 İnsüzyonlu) / Thorax Drape with incise film (35x45)	250x350	1
4	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x120	1
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Gaz Spanç / Gauze Swab	7.5x7.5	20
7	Yapışkan Bant / OP Tape	10x50	1

Ref. Code Z10.038.01


Disposable Steril Troid Seti / Disposable Sterile Thyroid Pack

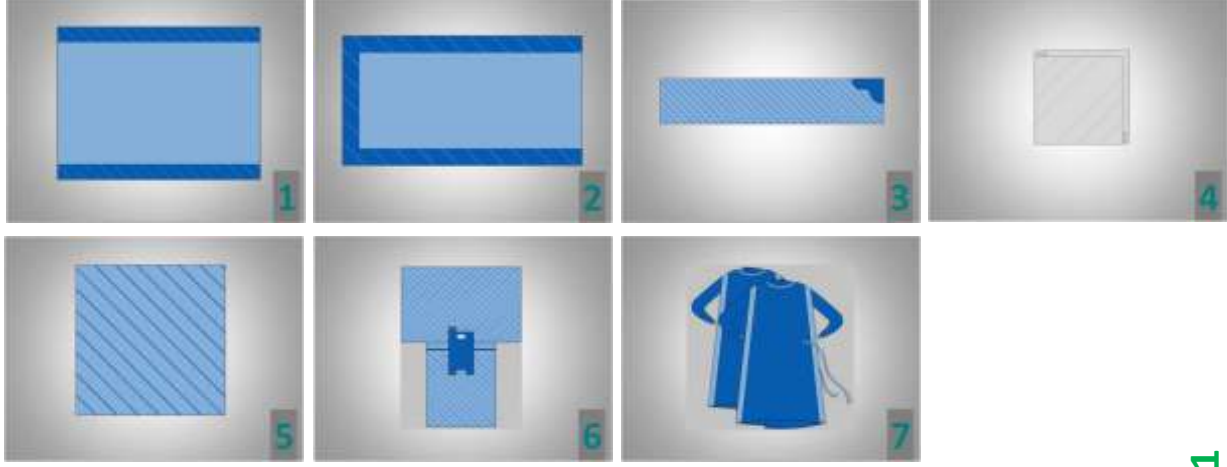

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Yapışkan Bant / OP Tape	10x30	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Troid Örtüsü / Thyroid Drape	240x320	1
7	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	2

Ref. Code Z10.039.01

Disposable Steril Troid Seti-2 / Disposable Sterile Thyroid Pack2

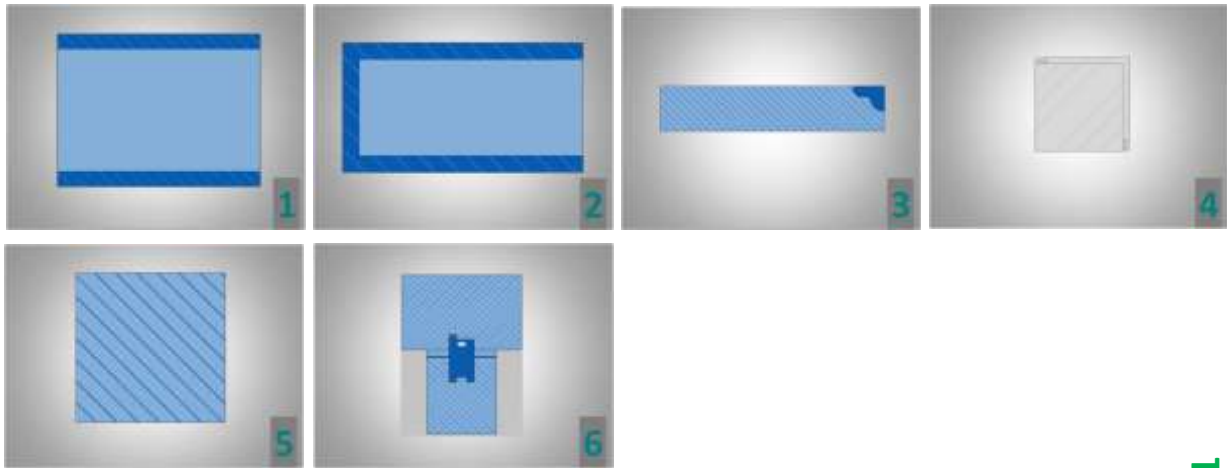

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200	2
2	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x145	1
3	Yapışkan Bant / OP Tape	10x30	1
4	Havlu / Towel	40x40	2
5	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1
6	Troid Örtüsü / Thyroid Drape	240x320	1

Ref. Code Z10.039.01


Disposable Steril Veteriner Seti / Disposable Sterile Veterinary Pack



NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	78x85	1
2	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x120	1
3	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	L	1
4	Düz Örtü / Basic Drape	120x150	1
5	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x150	1

Ref. Code **Z10.043.01**

Disposable Steril Veteriner Seti-2 / Disposable Sterile Veterinary Pack-2

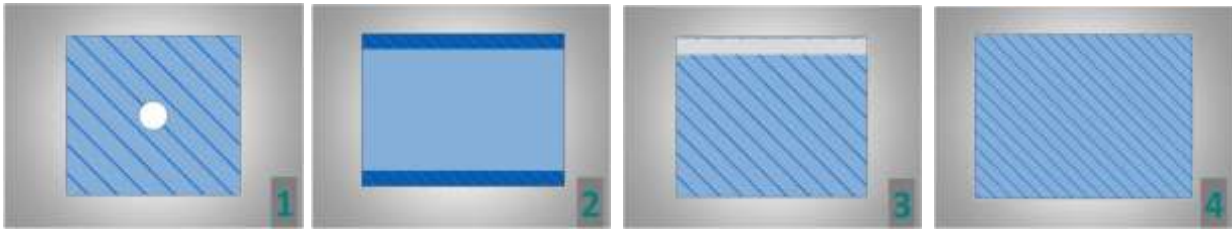

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	78x85	1
2	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x120	1
3	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x150	1
4	Düz Örtü / Basic Drape	120x150	1



Ref. Code **Z10.043.02**



ZENMED
TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DİĞER SETLER - THE OTHER PACKS

Disposable Steril X - Ray Seti / Disposable Sterile X - Ray Pack

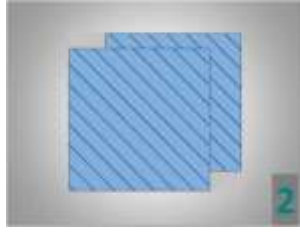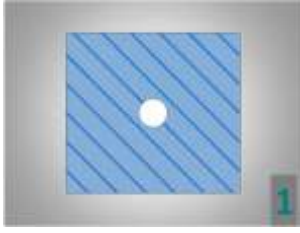

NO	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size	Adet / Unit
1	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	78x85	1
2	Düz Örtü / Basic Drape	100x100	2
3	Sterilizasyon Bohçası / Strilization Wrap	100x100	1

Ref. Code **Z10.040.01**



**CERRAHİ
ÖNLÜKLER**

**SURGERY
GOWNS**

Steril Önlük / Sterile Gown



NO	Ref. Kod/ Ref Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z30.002.01	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	Small
2	Z30.001.01	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	Small

NO	Ref. Kod/ Ref Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z30.002.02	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	Medium
2	Z30.001.02	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	Medium

NO	Ref. Kod/ Ref Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z30.002.03	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	Large
2	Z30.001.03	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	Large


NO	Ref. Kod/ Ref Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z30.002.04	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	X Large
2	Z30.001.04	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	X Large

NO	Ref. Kod/ Ref Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z30.002.05	Korumalı Cerrahi Önlük / Reinforced Surgical Gown	XX Large
2	Z30.001.05	Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown	XX Large

**CERRAHİ
ÖRTÜLER**


**SURGERY
DRAPES**

Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover

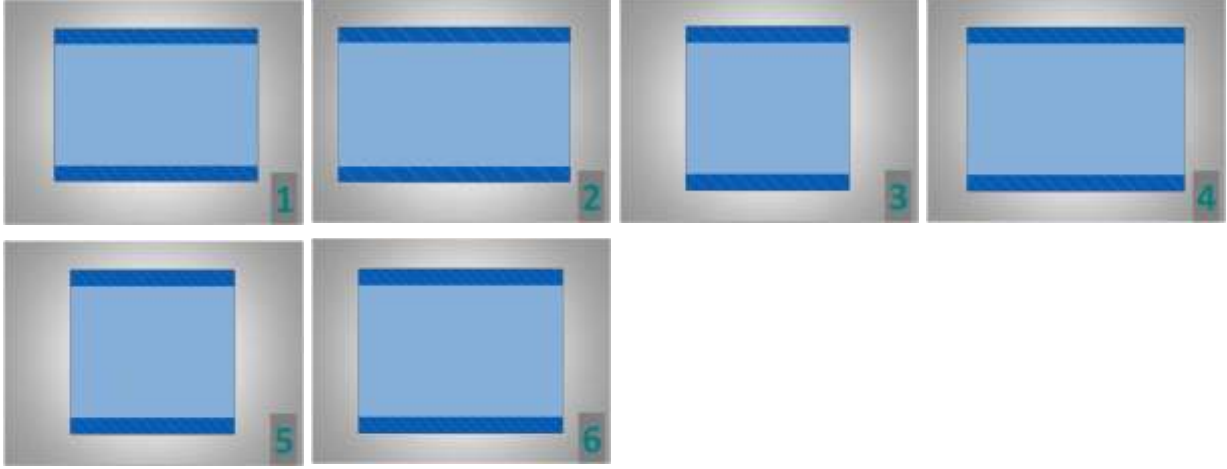


NO	Ref. Kodu / Ref Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.049.01	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x130
2	Z20.059.01	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	100x150
3	Z20.061.01	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x180
4	Z20.060.01	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	150x200
5	Z20.062.01	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	200x200
6	Z20.076.01	Alet Masa Örtüsü / Back Table Cover	200x250

Steril Örtüler / Sterile Drape

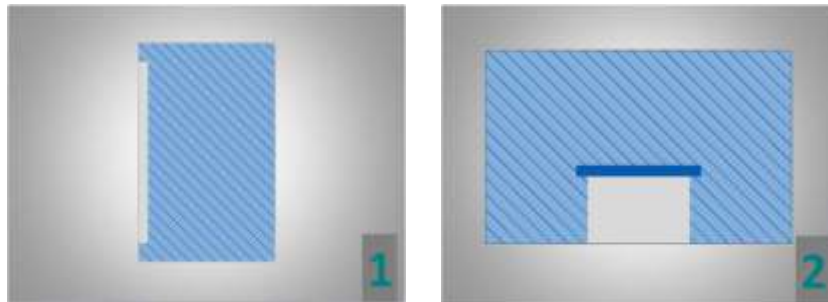

NO	Ref. Kod / Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.004.01	Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape	150x240
2	Z20.057.01	Anestezi "C" Bar Örtüsü / "C" Bar Anesthesia Drape	170x270

Steril Örtüler / Sterile Drape

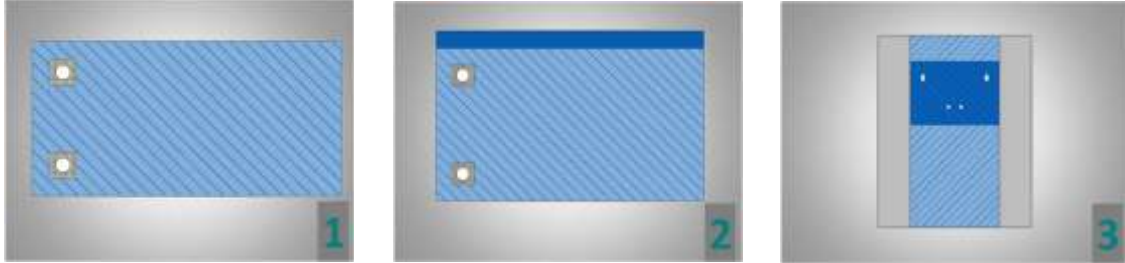




NO	Ref. Kod / Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.005.01	Anjiyo Örtüsü / Angiography Drape	150x300
2	Z20.070.01	Panelli Anjiyo Örtüsü / Angiography Drape with Transparent Panel	195x300
3	Z20.071.01	Femoral Radial Anjiyo Örtüsü / Femoral Radial Angiography Drape with Transparent Panel	240x300

Steril Örtüler / Sterile Drapes





NO	Ref. Kod / Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.002.01	Ayak Örtüsü Bantlı / Foot Drape	160x180
2	Z20.003.01	Yan Bantlı Örtü / Side Drape	100x120
3	Z20.001.01	Ameliyat Örtüsü Düz / Basic Surgery Drape	150x200

Steril Örtüler / Sterile Drape

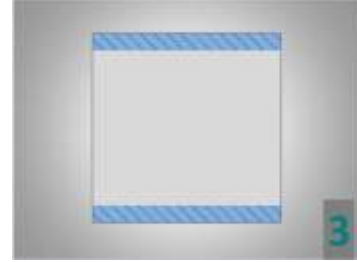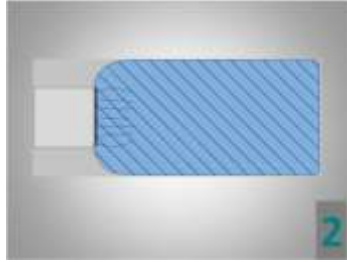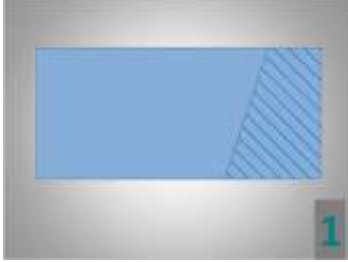


NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.038.01	Bacak Kılıfı / Leg Cover	60x120
2	Z20.039.01	Bacak Kılıfı Ribanalı / Leg Cover with Cuff	35x75
3	Z20.040.01	Bebek Örtüsü / Baby Drape	80x80

Steril Örtüler / Sterile Drape

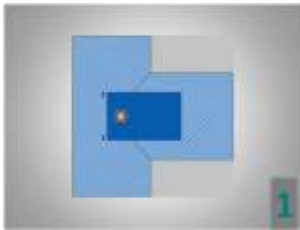


NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.006.01	El Cerrahi Örtüsü / Hand Surgery Drape	150x200
2	Z20.007.01	Artroskopi Örtüsü / Arthroscopy Drape	200x300
3	Z20.008.01	Extremite Örtüsü Alt / Sub-Extremity Drape	200x300
4	Z20.009.01	Extremite Örtüsü Üst / Upper-Extremity Drape	150x240

Steril Örtüler / Sterile Drape

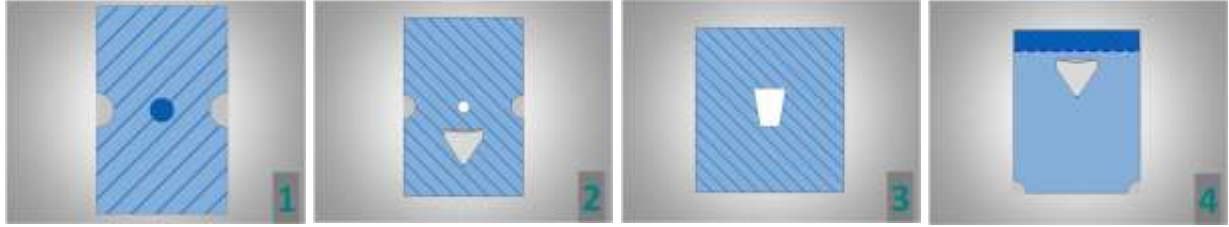


NO	Ref. Kod / Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.067.01	Jinekoloji Örtüsü / Gynaecology Drape	75x120
2	Z20.068.01	Jinekoloji Örtüsü Poşlu / Gynaecology Drape with Pouch	100x150
3	Z20.027.01	OPU Örtüsü Delikli / OPU Drape Fenestrated	135x150
4	Z20.028.01	Hasta Alt Örtüsü Poşlu / Under Buttocks Drape with Pouch	100x130

Steril Örtüler / Sterile Drape

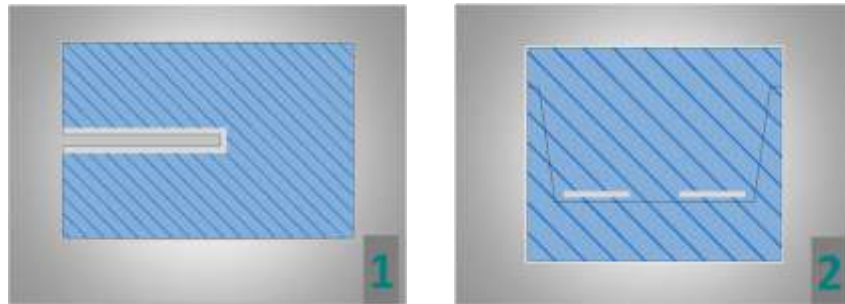


NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.014.01	KBB Örtüsü / ENT Drape	160x240
2	Z20.015.01	Baş Örtüsü (Türban) / Head (Turban) Drape	100x120

Steril Örtüler / Sterile Drape

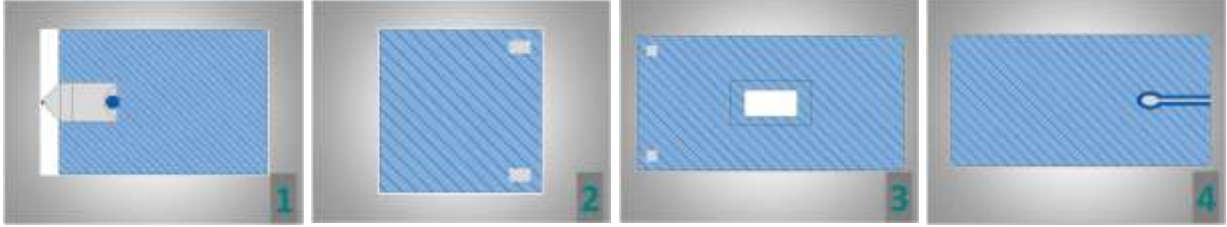



NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.016.01	Kraniotomi Örtüsü / Craniotomy Drape	230x330
2	Z20.017.01	Karpal Tunel Drape / Carpal Tunnel Drape	150x150
3	Z20.018.01	Spinal Vertebra Örtüsü / Spinal Vertebra Drape	200x300
4	Z20.069.01	Shunt Örtüsü / Shunt Drape	150x300

Steril Örtüler / Sterile Drape

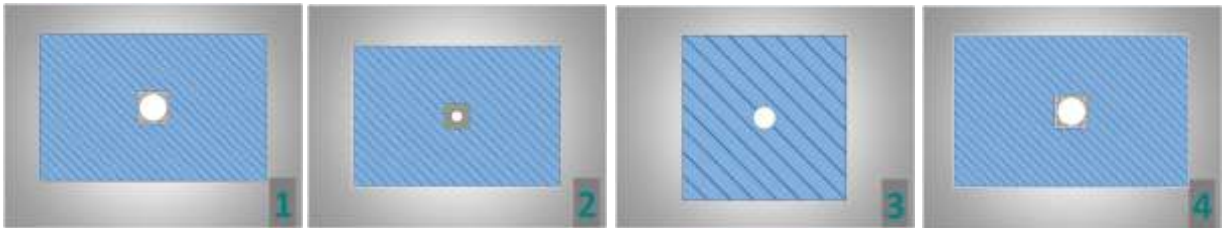



NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.035.01	Küçük Müdahale Örtüsü / Minor Procedure Drape	75x80
2	Z20.036.01	Minör Cerrahi Örtüsü / Minor Surgery Drape	75x80
3	Z20.037.01	Delikli Örtü / Fenestrated Drape	100x100
4	Z20.058.01	Delikli Bantlı Örtü / Drape with Adhesive Fenestration	

Steril Örtüler / Sterile Drape

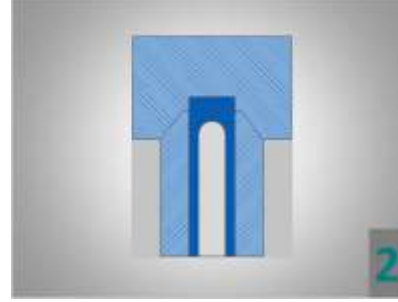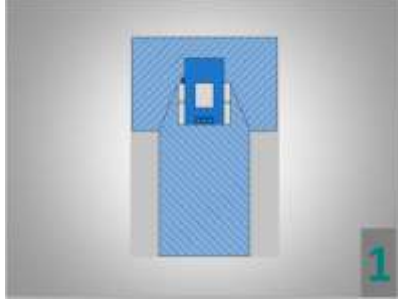


NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.019.01	KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape	240x360
2	Z20.072.01	"U" Yarıklı KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape with "U" Split	250x220x340

Steril Örtüler / Sterile Drape

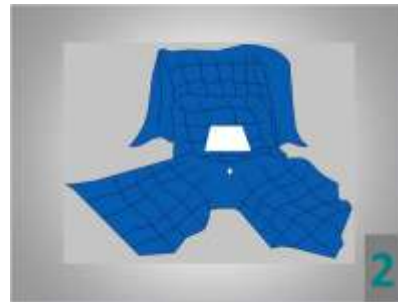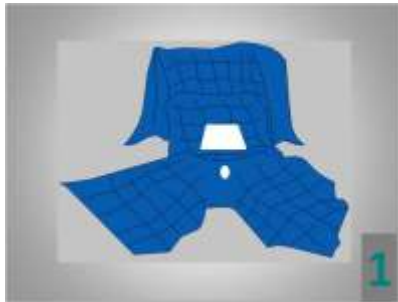


NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.032.01	Laparoskopik Abdominal Perineal Örtü / Laparoscopic Abdominal Perineal Drape	150x200
2	Z20.074.01	Laparoskopik Pelviskopi Örtü / Laparoscopic Pelviscopy Abdominal Drape	150x260

Steril Örtüler / Sterile Drape

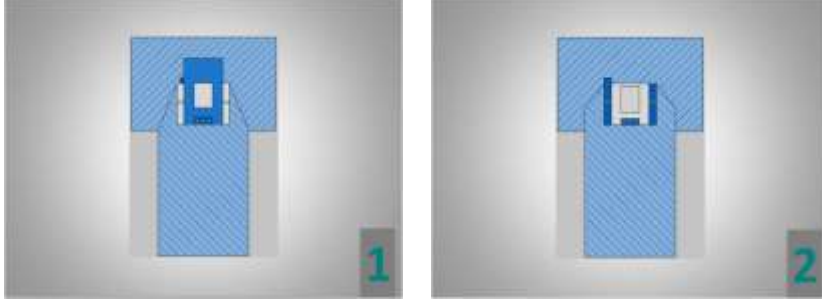



NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.020.01	Laparotomi Örtüsü İnsizyonlu/ Laparotomy Drape with Incise Film	240x320
2	Z20.073.01	Laparotomi Örtüsü İnsizyonlu-Poşlu/ Laparotomy Drape with Incise Film and Pouch	250x220x340

Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover

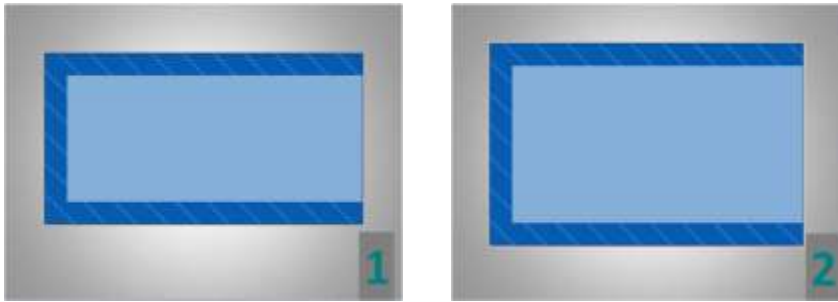


NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.050.01	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	78x147
2	Z20.063.01	Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover	90x145

Steril Örtüler / Sterile Drape

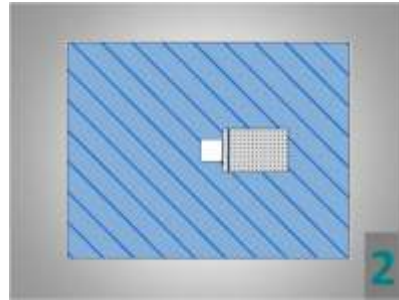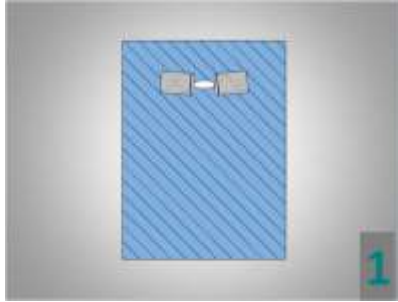




NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.033.01	Çift Poşlu Oftalmik Örtü / Ophtalmic Drape with Double Pouch	150x200
2	Z20.034.01	Tek Poşlu Oftalmik Örtü / Ophtalmic Drape with Single Pouch	100x130

Steril Örtüler / Sterile Drape

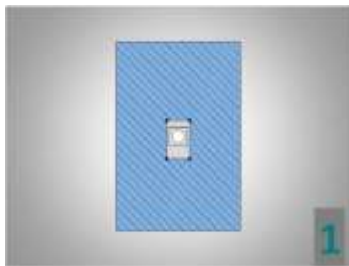




NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.025.01	Sezeryan Örtüsü L.T.T. / Cesarean Section Drape with Pouch	200x300
2	Z20.026.01	Litotomik Poşlu Jinekoloji Örtüsü / Lithotomic Gynaecology Drape with Pouch	240x240
3	Z20.066.01	Litotomik Jinekoloji Örtüsü / Lithotomic Gynaecology Drape	240x240

Steril Örtüler / Sterile Drape

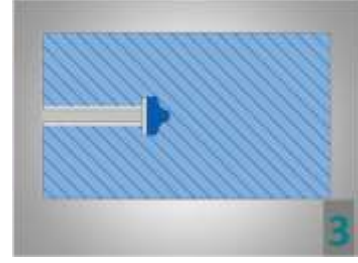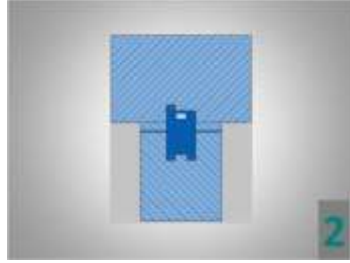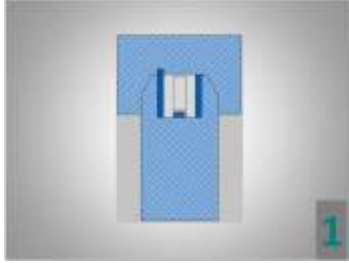

NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.029.01	Toraks Örtüsü / Thorax Drape with Incise Film	240x350
2	Z20.030.01	Troid Örtüsü / Thyroid Drape	240x320
3	Z20.031.01	"U" Yarıklı Perine Örtüsü / "U" Split Perineum Drape	150x260

Steril Örtüler / Sterile Drape

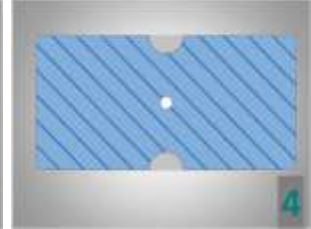


NO	Ref. Kod/ Ref. Code	Ürün Adı / Product Name	Ebat / Size
1	Z20.021.01	Likit Toplamalı TUR Örtüsü / TUR Drape with Pouch	175x240
2	Z20.022.01	Perkütan Örtü / Percutaneous Drape	150x300
3	Z20.023.01	Üroloji Örtüsü / Urology Drape	150x300
4	Z20.024.01	Sistoskopi Örtüsü / Cystoscopy Drape	75x150



ZENMED

TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CERRAHİ ÖRTÜLER - SURGERY DRAPES

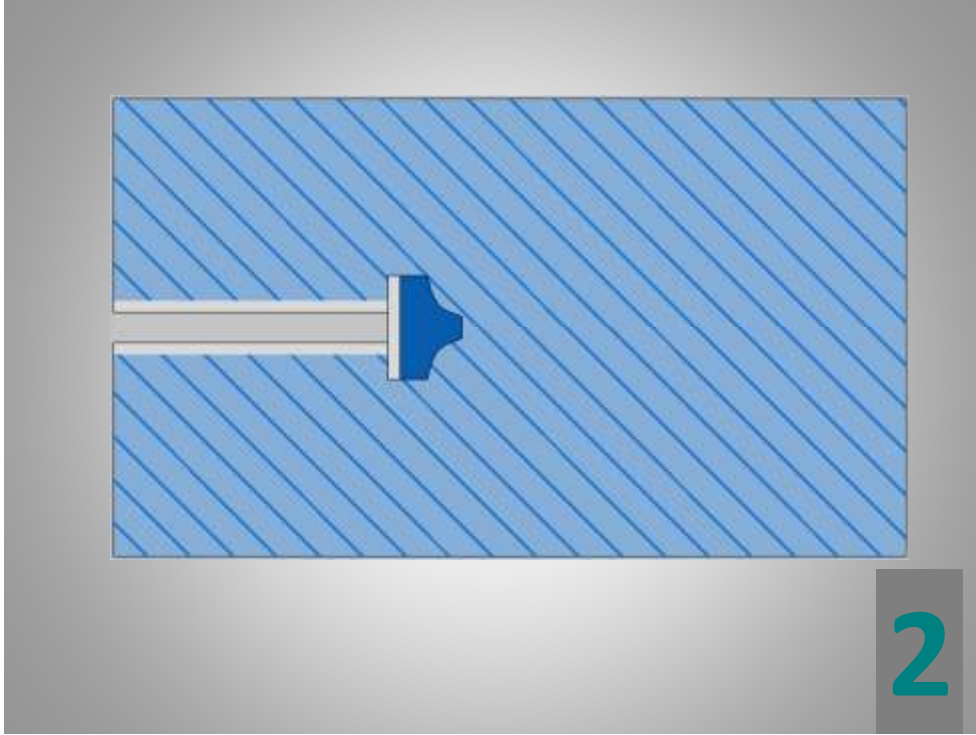





kiwa

EC Certificate
Production Quality Assurance System according to
Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex-V
Certificate Number: 1984-MDD-18-504

We hereby declare that an examination has been carried out following the requirements of the national legislation to which the undersigned is subject, transposing Annex-V of the Directive 93/42/EEC on medical devices. We certify that the production quality system conforms with the relevant provisions of the aforementioned legislation.


Organization:
ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mahmutbey Mahallesi 2567. Sokak no: 1 işyeri no: 11, 21
Bağcılar, İstanbul, Türkiye

Product: Sterile Disposable Surgical Gown, Drape, Drapes and Gowns Sets

The certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact Kiwa for details.

Report Number: M-5071.01
Expiry Date: 19 April 2021

Kiwa Certification Services Inc. is Notified Body under Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with identification number: 1384.


20 April 2018, İstanbul, Turkey Head of Notified Body

Kiwa Certification Services Inc.
1702B A Cad. No:19 Tuzluca, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 580 20 11, Fax: +90 216 580 20 12
Web: www.kiwa.com.tr, e-mail: kiwa@kiwa.com.tr

kiwa

AT Sertifikası
Üretim Kalite Güvence Sistemi
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT Ek-V
Sertifika Numarası: 1984-MDD-18-504

Aşağıda bahsi geçen kuruluşun üretim kalite güvence sistemine ait incelenmesinin, tıbbi cihazlara dair 93/42/AT yönetmeliği Ek-V gereksinimlerine göre yapıldığını bakan edersin. Üretim kalite güvence sisteminin yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin ilgili koşullarına uygunluğunu tasdik ederiz.

Kuruluş:
ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mahmutbey Mahallesi 2567. Sokak no: 1 işyeri no: 11, 21
Bağcılar, İstanbul, Türkiye

Ürün: Steril Tek Kullanımlık Cerrahi Örtükler, Örtüler, Örtü ve Örtük Setleri

Sertifika son kullanma tarihine kadar geçerli olup periyodik gözetim denetimlerinin bakan ile tamamlanmasına tabidir. Detaylar için lütfen Kiwa Belgelendirme Hizmetleri'ne başvurunuz.

Rapor No: M-5071.01
Şerh Geçerlilik Tarihi: 19 Nisan 2021

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT altında bir onaylanmış kuruluş olup kimlik numarası 1384'dir.


20 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye Onaylanmış Kuruluş Başkanı

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
1702B A Cad. No:19 Tuzluca, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 580 20 11, Fax: +90 216 580 20 12
Web: www.kiwa.com.tr, e-mail: kiwa@kiwa.com.tr

kiwa

ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MAHUTBEY MAHALLESİ 2567. SOKAK NO: 1 İŞYERİ NO: 11, 21
BAĞCILAR - İSTANBUL - TÜRKİYE

with a scope of:

DESIGN, MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF DISPOSABLE STERILE - NON STERILE GOWNS, DRAPES AND STERILE SURGICAL DRAPES AND GOWNS SETS

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
"Following elements of the standard are excluded"
"1.2.2.2" "1.2.2.3" "1.2.2.4" "1.2.2.5" "1.2.2.6" "1.2.2.7"

EN ISO 13485:2012

Certificate No: M-10990
Initial Certification Date: 20 April 2018
Certification Date: 20 April 2018
Expiration Date: 28 February 2019


General Manager

Kiwa Certification Services Inc.
1702B A Cad. No: 19 Tuzluca, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 580 20 11, Fax: +90 216 580 20 12
Web: www.kiwa.com.tr, e-mail: kiwa@kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits.
Please contact Kiwa for further information.

İstanbul, Türkiye
20 April 2018, 16:46

kiwa

ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MAHUTBEY MAHALLESİ 2567. SOKAK NO: 1 İŞYERİ NO: 11, 21
BAĞCILAR - İSTANBUL - TÜRKİYE

TEK KULLANIMLIK STERİL - NON STERİL ÖNLÜKLER, ÖRTÜLER VE STERİL CERRAHİ ÖRTÜ-ÖNLÜK SETLERİ TASARIMI, ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

kapasitesinde

EN ISO 13485:2012
Tıbbi Cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
"Following elements of the standard are excluded"
"1.2.2.2" "1.2.2.3" "1.2.2.4" "1.2.2.5" "1.2.2.6" "1.2.2.7"

Certificate No: M-10990
Initial Certification Date: 20 April 2018
Certification Date: 20 April 2018
Expiration Date: 28 February 2019


General Manager

Kiwa Certification Services Inc.
1702B A Cad. No: 19 Tuzluca, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 580 20 11, Fax: +90 216 580 20 12
Web: www.kiwa.com.tr, e-mail: kiwa@kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits.
Please contact Kiwa for further information.

İstanbul, Türkiye
20 Nisan 2018, 16:46



ZENMED

TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

📍 Mahmutbey Mh. Mostar Köprüsü Cd.
2567 Sokak No: 1/11
Bağcılar / İstanbul / Türkiye

☎ +90 212 445 45 25

☎ +90 212 445 45 49

🌐 www.zenmed.com.tr



Введите текст для поиска...										
Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data	Cod vamal
						zenmed				
DM000368113	SET CHIRURGICAL STERIL				Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368126	CEARŞAF MEDICAL		200 X150, SMS 29-35 G/M2		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368136	HALAT CHIRURGICAL STERIL		XL, RANFORSAT		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368134	HALAT CHIRURGICAL STERIL		M, RANFORSAT		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368143	HALAT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ		XXXL		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368132	HALAT CHIRURGICAL STERIL		SMS, M		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368128	HALAT CHIRURGICAL STERIL		SMS, L		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368112	SET PENTRU NAȘTERE STERIL				Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
						ZENMED TIBBI				



Введите текст для поиска...										
Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data	Cod vamal
						zenmed				
DM000368114	SET CHIRURGICAL PENTRU INTERVENȚII LABORIOASE				Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368137	HALAT CHIRURGICAL STERIL		XXL, RANFORSAT		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368133	HALAT CHIRURGICAL STERIL		L, RANFORSAT		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368127	CEARȘAF MEDICAL		50 X 40, SMS 29-35 G/M2		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368131	HALAT CHIRURGICAL STERIL		SMS, S		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368139	HALAT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ		M		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368140	HALAT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ		L		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368125	SET PENTRU CEZARIANĂ				Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
						ZENMED TIBBI				



Введите текст для поиска...										
Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Prodicatorul	Reprezentant	Ordin	Data	Cod vamal
						zenmed				
DM000368141	HALAT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ		XL		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368138	HALAT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ		S		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368115	SET PENTRU ANESTEZIE EPIDURALĂ				Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000368130	HALAT CHIRURGICAL STERIL		SMS, XL		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	AELO GRUP S.R.L.	Rg04-000198	24-08-2022	
DM000349526	CEARSAF MEDICAL STERIL		200 X 150 CM		Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI	ROMEDCOM S.R.L.	Rg04-000102	22-04-2022	

Страница 3 из 3 (Всего элементов: 25)

1

2

3

Сcorexnum((Productatorul), "zenmed")

Очистить



CERTIFICATE



ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MAHMUTBEY MAHALLESİ 2567. SOKAK NO: 1 İŞYERİ NO: 11, 21 BAĞCILAR - İSTANBUL - TÜRKİYE

TEK KULLANIMLIK STERİL - NON STERİL ÖNLÜKLER, ÖRTÜLER VE STERİL CERRAHİ
ÖRTÜ-ÖNLÜK SETLERİ TASARIMI, ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

kapsamında

EN ISO 13485:2016

Uluslararası Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim
sistemi kurmuştur.

"Standardın aşağıda verilen maddeleri hariç tutulmuştur"

"7.5.3" "7.5.4" "7.5.9.2"

Sertifika No : M 10960

İlk Belgelendirme Tarihi : 20 Nisan 2018

Sertifika Tarihi : 16 Nisan 2021

Son Geçerlilik Tarihi : 15 Nisan 2024

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No: 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Türkiye

Tel: + 90 216 593 25 75

Faks: + 90 216 593 25 74

info@kiwa.com.tr

www.kiwa.com.tr

Genel Müdür



TÜRKAK BDS NO
YS-3F97-7F8B

Sertifikalar periyodik ara denetimlerin
başarılı ile tamamlanması kaydıyla
geçerlidir. Detaylı bilgi için yukarıdaki
numaralara başvurulabilir.

Sertifika Son Güncelleme Tarihi : 16 Nisan 2021 - R 02



CERTIFICATE

ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MAHMUTBEY MAHALLESİ 2567. SOKAK NO: 1 İŞYERİ NO: 11, 21 BAĞCILAR - İSTANBUL - TURKEY

**DESIGN, MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF DISPOSABLE STERILE - NON
STERILE GOWNS, DRAPES AND STERILE SURGICAL DRAPES AND GOWNS SETS**

with a scope of

EN ISO 13485:2016

Has established a management system in accordance
with international Medical Devices Quality Management System Standard

"Following elements of the standard are excluded"

"7.5.3" "7.5.4" "7.5.9.2"

Certificate No	: M 10960
Initial Certification Date	: 20 April 2018
Certification Date	: 16 April 2021
Expiration Date	: 15 April 2024

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No. 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Turkey

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

General Manager



TÜRKAK BDS NO
YS-3F97-7F8B

Certificate is valid till expiration date,
subject to successful completion of
periodical surveillance audits.
Please contact above numbers for
detailed information.



ZENMED
TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER: ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADDRESS: MAHMUTBEY MAHALLESİ 2567. SOKAK NO: 1/11, 21 BAĞCILAR – İSTANBUL / TURKEY

PRODUCT: **PRODUCT LIST GIVEN ANNEX I**

PRODUCT	GMDN CODE
STERILE SURGICAL DRAPES	47783
STERILE SURGICAL GOWNS	35778
STERILE SURGICAL SETS	33961

CLASSIFICATION: CLASS 1S, RULE 1, ANNEX IX OF MDD 93/42 EEC.

CONFORMITY

ASSESSMENT ROUTE: ANNEX V

WE HEREWITH DECLARE THAT THE ABOVE MENTIONED PRODUCTS MEET THE PROVISIONS OF THE COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC (2007/47/EC) FOR MEDICAL DEVICES, DO NOT CONTAIN HUMAN BLOOD AND DERIVATIVES, DO NOT CONTAIN ANIMAL TISSUE, DO NOT CONTAIN DRUG AND PHARMACEUTICAL COMPONENTS. ALL SUPPORTING DOCUMENTATION IS RETAINED UNDER THE PREMISES OF THE MANUFACTURER.

THE PRODUCTS ARE "LATEX FREE"

**ZENMED**TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK
ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**APPLICATION STANDARDS:**

EN ISO 13485: 2012	MDD 93/42/AT	EN ISO 14971: 2012
EN ISO 15223-1: 2016	EN 1041: 2014	EN 62366-1: 2015
EN ISO 10993-1: 2011	EN ISO 10993-5: 2010	EN ISO 10993-10: 2014
EN ISO 11607-1: 2010	EN ISO 11607-2: 2006	MEDDEV 2.12/1 rev.8
MEDDEV 2.12/2 rev.2	MEDDEV 2.7/1 rev.4	TS ISO 13795+A1
TS EN ISO 22612: 2016	EN ISO 14644-1: 2015	EN ISO 11135: 2014
EN ISO 14644-2: 2015	EN ISO 14644-3: 2005	EN ISO 14644-4: 2001
EN ISO 14644-5: 2004	EN ISO 14644-6: 2007	EN ISO 14644-7: 2004

PRODUCTS:

STERILE SURGICAL GOWNS, SURGICAL DRAPES, STERILE SURGICAL SETS.

NOTIFIED BODY

: KIWA BELGELENDİRME HİZMETLERİ

NOTIFIED BODY ADDRESS: İTOSB 9. Cad. No: 15 Tepeören - TUZLA -
İSTANBUL

www.kiwa.com.tr

NOTIFIED BODY NUMBER

: 1984

START OF CE-MARK

: 20.04.2018

VALIDITY OF CE-MARK

: 27.05.2024

REVISION NUMBER

: 02

NUMBER OF CERTIFICATE(S)

: M.5071.03

PLACE, DATE OF ISSUE

: İSTANBUL / 24.06.2022

SIGNATURE:: M. ZEKİ KÜÇÜKKAYA
General Manager

**ZENMED TIBBİ CİHAZLAR
VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.**
Mahmutbey Mah. 2567 Sk. No: 1/11 İş Yeri No: 11,21
Bağcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0212 445 45 25 Tic.Sic.No: 794704
Güneşli M.D.: 897 067 1942

Page: 2/2



CERTIFICATE



AT Sertifikası
Üretim Kalite Güvence Sistemi
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT Ek-V
Sertifika Numarası: 1984-MDD-18-504

Aşağıda bahsi geçen kuruluşun üretim kalite güvence sistemine ait incelemesinin, tıbbi cihazlara dair 93/42/AT yönetmeliği Ek-V gereksinimlerine göre yapıldığını beyan ederiz. Üretim kalite güvence sisteminin yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin ilgili koşullarına uygunluğunu tasdik ederiz.

Kuruluş:

ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mahmutbey Mahallesi 2567. Sokak no: 1 iş yeri no: 11, 21 Bağcılar, İstanbul, Türkiye

Ürünler: Steril Tek Kullanımlık Cerrahi Önlükler, Örtüler, Örtü ve Önlük Setleri

Sertifika son kullanma tarihine kadar geçerli olup periyodik gözetim denetimlerinin başarı ile tamamlanmasına tabidir. Detaylar için lütfen Kiwa Belgelendirme Hizmetleri'ne başvurunuz.

Rapor No: M.5071.03
İlk Yayın Tarihi: 20 Nisan 2018
Son Yayın Tarihi: 02 Aralık 2020
Revizyon Numarası: 02
Son Geçerlilik Tarihi: 27 Mayıs 2024

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek V'e uygun olarak steril şartların güvence altına alınması ve muhafaza edilmesi ile ilgili üretim yönleriyle sınırlı olan kalite sistemini denetlemiş ve kalite sisteminin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek V'deki uygulanabilir şartları karşıladığını tespit etmiştir.

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT altında bir onaylanmış kuruluş olup kimlik numarası 1984'tür.

Muhteşem Gökhan Yücel
Onaylanmış Kuruluş Başkanı

02 Aralık 2020, İstanbul, Türkiye



CERTIFICATE



EC Certificate

Production Quality Assurance System according to Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex-V

Certificate Number: 1984-MDD-18-504

We hereby declare that an examination has been carried out following the requirements of the national legislation to which the undersigned is subject, transposing Annex-V of the Directive 93/42/EEC on medical devices. We certify that the production quality system conforms with the relevant provisions of the aforementioned legislation.

Organization:

ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mahmutbey Mahallesi 2567. Sokak no: 1 iş yeri no: 11, 21 Bağcılar, İstanbul, Turkey

Products: Sterile Disposable Surgical Gown, Drapes, Drapes and Gowns Sets

The certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact Kiwa for details.

Report Number: M.5071.03

Date of first issue: 20 April 2018

Date of last issue: 02 December 2020

Revision Number: 02

Expiry Date: 27 May 2024

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. has audited the quality system restricted to the aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions in accordance with MDD Annex V and found that the quality system meets the applicable requirements in MDD Annex V.

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. is Notified Body under Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with identification number: 1984

Muhteşem Gökhan Yücel
Head of Notified Body

02 December 2020, Istanbul, Turkey

AB-0583-T
21036446- İNG
12-21

Customer name: ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Address: MAHMUTBEY MAHALLESİ 2567 SOK. NO:1 İŞ YERİ NO:11,21 BAĞCILAR/İSTANBUL
Buyer name: -
Contact Person: BUSENUR KILIÇ
Order No: LOT NO:012021291025
Article No: DISPOSABLE DRAPE AND GOWN
Name and identity of test item: Blue non woven surgical gown (claimed to be; 10 Pcs / Blue)
The date of receipt of test item: 30.11.2021
Re-submitted/re-confirmation date: -
Date of test: 30.11.2021-15.12.2021
Remarks: -
Sampling: The results given in this report belong to the received sample by vendor.
End-Use: -
Care Label: Not specified.
Number of pages of the report: 8

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.
EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number [AB-0583-T] for ISO 17025:2017 as test laboratory.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report

Seal
Date
15.12.2021

Customer Representative
Zahide TAPAN

Head of Testing Laboratory
Sevim A. RAZAK
15.12.2021

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036446-
İNG

12-21

REQUIRED TESTS	EVALUATION	COMMENTS
MICROBIOLOGICAL TEST		
Microbial Cleanliness (Bioburden)	P	
Resistance to Bacterial Penetration-Wet Method	P	
Resistance to Microbial Penetration-Dry Method	P	
PHYSICAL PROPERTIES TESTS		
Tensile Strength / Dry	P	
Tensile Strength / Wet	P	
Bursting Strength / Dry	P	
Bursting Strength / Wet	P	
Water Permeability	P	
Lint and Other Particles Generation From Nonwoven	P	
P: Pass F: Fail R: Refer to retailer technologist. Test results were evaluated according to EN 13795-1:2019(*) Standard Performance Properties limit values (Table 1)		

REMARK: Original samples are kept for 3 months and all technical records are kept for 5 years unless otherwise specified. If requested, measurement uncertainty will be reported. But unless otherwise specified, measurement uncertainty is not considered while stating compliance with specification or limit values. The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95 %. Tests marked (*) in this report are not included in the accreditation schedule.



This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036446-
İNG

12-21

TEST RESULTS

MICROBIAL CLEANLINESS (Bioburden) ; EN ISO 11737-1:2018

The sample is put in extraciton liquid after shaking well after shaking well (250 rpm,5 min), inoculated on the suitable agar.The plates are incubated for 3 days at 30 ± 1 °C for 72 hours, and 7 days at (20 to 25) °C for TSA and SDA plates respectively.
Total microoragnisms counts are calculated.

RESULTS

REQUIREMENT

Microbial cleanliness (cfu/100 cm²)

8 cfu/100 cm²

≤300 cfu/100 cm²

*cfu= Colony forming unit.

Total Uncertainty: 0,28

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036446-
İNG

12-21

TEST RESULTS

DETERMINATION OF RESISTANCE TO BACTERIAL PENETRATION-WET METHOD ; BS EN 22610: 2006

A test sample is placed on the agar plate on a rotating disc. Bacteria carrier material and coating film are placed on the test sample and all parts are fixed on the disk. A finger is placed on the test sample to apply a certain force ($3N \pm 0.02$). The finger moves on the test sample over the entire surface of the agar within 15 minutes. 5 studies are carried out for 15 minutes. 6. The study is repeated by inverting the sample.

Sample amount:	5 pieces 25x25cm ²
Carrier Material:	30 µm thin, 25x25cm ² Polyurethane Film
Coating Material:	25x25cm ² HDPE Film
Microorganism:	Staphylococcus aureus ATCC 29213
Bacterial Concentration (kob / ml):	5×10^4 kob / ml
Incubation Conditions:	(36 ± 1) ° C 48 hours

RESULTS			
Number of Populating Bacteria (cfu)		Penetration Rate	
X ₁	260	R _{CUM1}	0,08
X ₂	425	R _{CUM2}	0,22
X ₃	529	R _{CUM3}	0,39
X ₄	559	R _{CUM4}	0,58
X ₅	634	R _{CUM5}	0,78
Z	640		
T		3047	
X₁ X₅: Number of colonies growing in 5 parallel petri in the same sample Z: number of colonies growing in the sixth petri dish T: X₁ + X₂ + X₃ + X₄ + X₅ + Z $R_{CUM1} = X_1/T$ $R_{CUM2} = (X_2 + X_1)/T$ $R_{CUM3} = (X_3 + X_2 + X_1)/T$ $R_{CUM4} = (X_4 + X_3 + X_2 + X_1)/T$ $R_{CUM5} = (X_5 + X_4 + X_3 + X_2 + X_1)/T$			
Critical area		BARRIER INDEX (I _B)	
		Result	Expected value (*)
I _B		3,91	≥2.8
$I_B = 6 - (CUM1 + CUM2 + CUM3 + CUM4 + CUM5)$			

Total Uncertainty: 0,08

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036446-
İNG

12-21

TEST RESULTS

**DETERMINATION OF RESISTANCE TO MICROBIAL PENETRATION-DRY METHOD; ISO
22612:2005**

Samples and containers are sterilized. Agar plates are placed in each container. Samples are placed aseptically in the apparatus. The covers are closed. After making a pot in the sample with the piston, the pistons are removed and $0.5 \text{ g} \pm 0.1 \text{ g}$ are added to five samples from the powder contaminated with bacteria and the six to the non-contaminated powder. Then all openings are closed with a plastic bag. The device is operated to give 20,800 vibrations per minute. The test time is 30 minutes. After the test is over, all agar plates are incubated at 35°C for 24 hours.

Less Critical area

Sample amount:	6 pieces $20 \times 20 \text{ cm}^2$
Mikroorganism:	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 9372
Bacterial concentration (cfu/ml):	1×10^8 kob/ml
Incubation conditions:	35°C / 24 hours

RESULTS

Number of Populationg Bacteria (cfu)

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6 (Control)	0
Total	0
Logarithm	-

RESULT

Result (cfu/g)	Expected Value
0 cfu/g	$\leq 300 \text{ cfu/g}$

Total Uncertainty: 0,12

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036446-
İNG

12-21

TEST RESULTS

TENSILE STRENGTH; EN 29073-3:1996

Instron 5969 (Load: 5 kN), Strip Method.

Speed: 100 mm/min $\pm$ 10, Gauge length 200 mm.

Pre-load was not applied. Without wetting samples.

The average results are given for width and length direction of three samples

Performed in the conditioned room (20 $\pm$ 2°C-65% $\pm$ 4).

Dry ;

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Width	67,1 N	$\geq$ 20N (Dry)
Length	136,9 N	$\geq$ 20N (Dry)
Total Uncertainty: $\pm$ %4,9		

TENSILE STRENGTH; EN 29073-3:1996

Instron 5969 (Load: 5 kN), Strip Method.

Speed: 100 mm/min $\pm$ 10, Gauge length 200 mm.

Pre-load was not applied. Without wetting samples.

The average results are given for width and length direction of three samples

Performed in the conditioned room (20 $\pm$ 2°C-65% $\pm$ 4).

Wet;

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Width	52,5 N	$\geq$ 20N (Wet)
Length	129,3 N	$\geq$ 20N (Wet)
Total Uncertainty: $\pm$ %4,9		

BURSTING STRENGTH;; ISO 13938-1:1999

SDL ATLAS M229 tester. Test area: 30.5 mm diameter

The average results are given of five samples.

Performed in the conditioned room (20 $\pm$ 2°C-65% $\pm$ 4).

Less Critical area

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Dry ;	182 kPa	$\geq$ 40 kPa (Dry)
Height at Burst*	20,4 mm	

Total Uncertainty: $\pm$ %3,4

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036446-
İNG

12-21

TEST RESULTS

BURSTING STRENGTH;; ISO 13938-1:1999

SDL ATLAS M229 tester. Test area: 30.5 mm diameter
The average results are given of five samples.
Performed in the conditioned room (20±2°C-65%±4).

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Wet ;	151 kPa	≥ 40 kPa (Wet)
Height at Burst*	19,9 mm	
Total Uncertainty: ±%3,4		

WATER PERMEABILITY; ISO 811:2018

Hydrostatic Head Tester. Textest marka Fx 3000 model
Temperature of water 20°C. Pressure increase ratio 10 mbar/min.
Performed in the conditioned room (20±2°C-65%±4)

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Sample 1	189,7 cm H ₂ O	≥ 20 cm H ₂ O
Sample 2	205,0 cm H ₂ O	
Sample 3	196,9 cm H ₂ O	
Sample 4	209,1 cm H ₂ O	
Sample 5	207,1 cm H ₂ O	
Average	201,6 cm H ₂ O	

Total Uncertainty: ±%7,7

AB-0583-T

21036446-
İNG

12-21

TEST RESULT

LINT AND OTHER PARTICLES GENERATION FROM NONWOWEN;

Test Metod: ISO 9073-10: 2003

5 test samples that in cross direction are maintained to twisting and compression action with Gelbo Flex for inner and outer surface in a clean room condition (according to ISO 14644-1 Class 5).

Lint and particles detached from the sample are counted with counter device and classified to size range.

Min. measuring size of SOLAIR 3100 particles measuring device: 0,3 µm,

Max. measuring size of SOLAIR 3100 particles measuring device: 25 µm,

Air flow: 28,3 ± 1,4 L/min Working mode: 30 s x 10 consecutive periods

Critical area

SAMPLE, INNER SURFACE (3 µm - 25 µm)		SAMPLE, OUTER SURFACE (3 µm - 25 µm)	
Total linting	: 151	Total linting	: 72
Standard deviation	: 35	Standard deviation	: 16
Coefficient of variation	: 23%	Coefficient of variation	: 22%
Coefficient of linting (CL)	: 2	Coefficient of linting (CL)	: 2
SAMPLE, MATERIAL (TOTAL)			
Total linting	: 224		
Coefficient of linting (CL)*	: 2		

*According to EN ISO EN ISO 13795-1:2019, Coefficient of linting (CL) (log 10) should be ≤4 for analysis of critical product area and less critical product area of both standard performance and high performance testing.

Total Uncertainty (Inner surface): ±%9,4

Total Uncertainty (Out surface): ±%12,1

TEST REPORT
DENEY RAPORU

AB-0583-T
21036446
12-21

Müşterinin adı:	ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi:	MAHMUTBEY MAHALLESİ 2567 SOK. NO:1 İŞ YERİ NO:11,21 BAĞCILAR/İSTANBUL
Alıcı firma:	-
İlgili kişi:	BUSENUR KILIÇ
İstek numarası:	LOT NO:012021291025
Model numarası:	TEK KULLANIMLIK ÖRTÜ VE ÖNLÜK
Numunenin adı ve tarifi:	Mavi dokusuz yüzey cerrahi önlük(Müşteri tarafından belirtilmiştir; 10 Adet / Mavi)
Numunenin kabul tarihi:	30.11.2021
İlave numune ve/veya ilave bilgi geliş tarihi:	-
Deneyin yapıldığı tarih:	30.11.2021-15.12.2021
Açıklamalar:	-
Numune alımı:	Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir.
Numunenin son kullanımı:	-
Yıkama talimatı:	Belirtilmedi
Raporun sayfa sayısı:	8

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0583-T akreditasyon dosya numarası ile ISO 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması)

Mühür

Tarih
15.12.2021

Müşteri Temsilcisi
Zahide TAPAN

Laboratuvar Müdürü
Sevim A. RAZAK
15.12.2021

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036446

12-21

İSTENEN TESTLER	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ		
Mikrobiyal Temizlik Yüğü (Biyoyük Tayini)	P	
Bakteriyel Geçirgenliğe Olan Direncin Tayini-İslak Metot	P	
Mikrobiyal Geçirgenliğe Olan Direncin Tayini-Kuru Metot	P	
FİZİKSEL ÖZELLİK TESTLERİ		
Kopma Mukavemeti / Kuru	P	
Kopma Mukavemeti / Yaş	P	
Patlama Mukavemeti / Kuru	P	
Patlama Mukavemeti / Yaş	P	
Su Geçirgenliği	P	
Dokusuz Yüzeylerde Tiftik ve Partikül Oluşumu	P	
P: Geçer F: Kalır R: Alıcı firmanın teknik kişisine başvurunuz Test sonuçları EN 13795-1:2019 (*) Standart Performans Özellikleri limit değerlerine göre değerlendirilmiştir. (Tablo 1)		

Not: Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Müşteri tarafından talep edildiğinde testlere ait ölçüm belirsizliği raporlanır fakat "Geçer/Kalır" değerlendirmesinde ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınmaz. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Uygunluk beyanı Basit Kabul Karar Kuralına göre verilmiştir. Bu raporda (*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir.



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036446

12-21

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL TEMİZLİK (BİYOYÜK) ; EN ISO 11737-1:2018

5 numune çalışılır. Numune tartılır ve test çözeltisi içerisine atılarak iyice çalkalanır (250 rpm de 5 dk) ve uygun besiyerlerine ekilir. Toplam aerobik bakteriler için 30±1°C'de 72 saat, küf ve maya için ise 20-25 °C'de 7 gün inkübasyon sonrası agarda oluşan mikroorganizmalar sayılır.

	<u>SONUÇ</u>	<u>İSTENEN</u>
Mikrobiyal Temizlik (kob/100 cm²)	8 kob/100 cm ²	≤300 kob/100 cm ²

*kob:Koloni oluşturan birim

Toplam Belirsizlik: 0,28

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036446

12-21

TEST SONUÇLARI

BAKTERİYEL GEÇİRGENLİĞE OLAN DİRENCİN TAYİNİ-ISLAK METOT;

BS EN ISO 22610: 2006

Dönen bir disk üzerindeki agar plakasına bir test örneği konur. Test örneğinin üzerine bakteri taşıyıcı materyali ve kaplama filmi yerleştirilir ve bütün parçalar disk üzerinde sabitlenir. Test örneğine belirli bir kuvvet ($3N \pm 0,02$) uygulamak üzere bir parmak yerleştirilir. Parmak, 15 dakika içinde agarın tüm yüzeyi boyunca test örneği üzerinde hareket eder. 15 dakikalık 5 çalışma yapılır. 6. çalışma numune ters çevrilerek tekrarlanır..

Numune miktarı :	5 adet 25x25cm2
Taşıyıcı Materyal:	30 µm inceliğinde , 25x25cm2 Poliüretan Film
Kaplama Materyali:	25x25cm2 HDPE Film
Mikroorganizma:	Staphylococcus aureus ATCC 29213
Bakteri Konsantrasyonu (kob/ml) :	5x10 ⁴ kob/ml
İnkübasyon Koşulları:	(36±1)°C 48 saat

SONUÇLAR				
Nüfus Etme Zamanı (min)	Nüfus Eden Bakteri Sayısı (cfu)		Nüfus Etme Oranı	
15	X ₁	260	RCUM1	0,08
30	X ₂	425	RCUM2	0,22
45	X ₃	529	RCUM3	0,39
60	X ₄	559	RCUM4	0,58
75	X ₅	634	RCUM5	0,78
	Z	640		
	T			3047

X₁ X₅ : Aynı numunedeki 5 paralel petride üreyen koloni sayısı

Z : altıncı petride üreyen koloni sayısı

T: X₁ + X₂ + X₃ + X₄ + X₅

RCUM1 = X₁/T

RCUM2 = (X₂ + X₁)/T

RCUM3 = (X₃ + X₂ + X₁)/T

RCUM4 = (X₄ + X₃ + X₂ + X₁)/T

RCUM5 = (X₅ + X₄ + X₃ + X₂ + X₁)/T

BARİYER İNDEKSİ (IB)		
IB	Sonuç	Kabul edilen (*)
	3,91	≥2.8
IB = 6 - (CUM1 + CUM2 + CUM3 + CUM4 + CUM5)		

Toplam Belirsizlik: 0,08

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036446

12-21

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL GEÇİRGENLİĞE OLAN DİRENCİN TAYİNİ-KURU METOT ; ISO 22612:2005

Numuneler ve konteynerler steril edilir. Her bir konteynere agar plakaları konulur. Numuneler aseptik bir şekilde aparata yerleştirilir. Kapaklar kapatılır. Piston ile numunede bir potluk yapıldıktan sonra pistonlar çıkarılır ve beş adet numuneye bakteri ile kontamine edilmiş pudradan, altıncıya ise kontamine olmamış pudradan kontrol olarak 0,5 g $\pm$ 0,1 g eklenir. Ardından tüm açıklıklar plastik bir poşetle kapatılır. Dakikada 20.800 titreşim verecek şekilde cihaz çalıştırılır. Test süresi 30 dakikadır. Test bittikten sonra tüm agar plakaları 35°C'de 24 saat inkübe edilir.

Numune miktarı: 6 adet 20x20 cm²
Mikroorganizma: *Bacillus subtilis* ATCC 9372
Bakteri Konsantrasyonu (kob/ml): 1x10⁸ kob/ml
İnkübasyon Koşulları: 35°C / 24saat

SONUÇLAR

Nüfuz Eden Bakteri Sayısı (kob)

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6 (Kontrol)	0
Toplam	0
Logaritma	-

SONUÇ

Sonuç (kob/g)
0 kob/g

Beklenen Değer
≤300 kob/g

Toplam Belirsizlik: 0,12

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036446

12-21

TEST SONUÇLARI

KOPMA MUKAVEMETİ ; BS EN 29073-3:1992

Instron 5969 (Yük: 5 kN), Şerit Metodu.
Hız: 100 mm/dk±10, Çene mesafesi 200 mm.
Ön gerilme uygulanmamıştır. Islatma işlemi yapılmamıştır.
En ve boy yönlerinde 5 adet sonucun ortalaması verilmiştir.
Kondüsyon şartlarında test edilmiştir. (20±2°C - %65±4)

Kuru ;

	<u>SONUC</u>	<u>İSTENEN</u>
En	67,1 N	≥ 20N (Kuru)
Boy	136,9 N	≥ 20N (Kuru)

Toplam Belirsizlik: ±%4,9

KOPMA MUKAVEMETİ ; BS EN 29073-3:1992

Instron 5969 (Yük: 5 kN), Şerit Metodu.
Hız: 100 mm/dk±10, Çene mesafesi 200 mm.
Ön gerilme uygulanmamıştır. Islatma işlemi yapılmıştır.
En ve boy yönlerinde 5 adet sonucun ortalaması verilmiştir.
Kondüsyon şartlarında test edilmiştir. (20±2°C - %65±4)

Yaş ;

	<u>SONUC</u>	<u>İSTENEN</u>
En	52,5 N	≥ 20N (Yaş)
Boy	129,3 N	≥ 20N (Yaş)

Toplam Belirsizlik: ±%4,9

PATLAMA MUKAVEMETİ; ISO 13938-1:1999

Tru Brust James H. Test cihazı. Test alanı 30.5 mm çap
Hacim artış oranı: 29 cm³/dakika
5 adet sonucun ortalaması verilmiştir.
Kondüsyon şartlarında test edilmiştir (20±2°C-65%±4).

	<u>SONUC</u>	<u>İSTENEN</u>
Kuru ;	182 kPa	≥ 40 kPa (Kuru)
Şişirme mesafesi*	20,4 mm	

Toplam Belirsizlik: ±%3,4

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036446

12-21

TEST SONUÇLARI

PATLAMA MUKAVEMETİ; ISO 13938-1:1999

Tru Brust James H. Test cihazı. Test alanı 30.5 mm çap
Hacim artış oranı: 29 cm³/dakika
5 adet sonucun ortalaması verilmiştir.
Kondüsyon şartlarında test edilmiştir (20±2°C-65%±4).

	<u>SONUC</u>	<u>İSTENEN</u>
Yaş ;	151 kPa	≥ 40 kPa (Kuru)
Şişirme mesafesi*	19,9 mm	
Toplam Belirsizlik: ±%3,4		

SU GEÇİRGENLİĞİ; ISO 811:2018

Hidrostatik Başlık Cihazı, Textest marka Fx 3000 model
Su sıcaklığı 20°C. Basınç artış oranı 10 mbar/dk.
Kondüsyonlu ortamda test edilmiştir. (20±2°C-65%±4).

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Numune 1	189,7 cm H ₂ O	≥ 20cm H ₂ O
Numune 2	205,0 cm H ₂ O	
Numune 3	196,9 cm H ₂ O	
Numune 4	209,1 cm H ₂ O	
Numune 5	207,1 cm H ₂ O	
Ortalama	201,6 cm H ₂ O	

Toplam Belirsizlik: ±%7,7

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036446

12-21

TEST SONUÇLARI

DOKUSUZ YÜZEYLERDE TİFTİK VE PARTİKÜL OLUŞUMU ; ISO 9073-10: 2003

Boy yönünde 5 adet numune (iç ve dış yüzey için ayrı) test edilir. Numuneler ISO 14644-1' göre Sınıf 5 kategorisindeki bir temiz odada, bükülme ve sıkıştırma hareketi yapan Gelbo Flex cihazına cihazına yerleştirilir. Numuneden kopan tiftik ve partiküller, sayaç cihazı ile sayılır ve boyut aralığına göre sınıflandırılır.

SOLAIR 3100 partikül ölçme cihazı

Min. ölçüm boyutu: 0,3 µm,

Maks. ölçüm boyutu: 25 µm

Hava akışı: 28,3 ± 1,4 L/dk

Cihaz çalışma modu: 30 sn x 10 tur

NUMUNE (İÇ YÜZEY)

Toplam tüylenme/tiftiklenme : 151

Standart sapma : 35

Varyans Katsayısı : %23

Tüylenme/tiftiklenme katsayısı(CL): 2

NUMUNE (DIŞ YÜZEY)

Toplam tüylenme/tiftiklenme : 72

Standart sapma : 16

Varyans Katsayısı : %22

Tüylenme/tiftiklenme katsayısı(CL): 2

NUMUNE (TOPLAM)

Toplam tüylenme/tiftiklenme : 224

Tüylenme/tiftiklenme katsayısı(CL)*: 2

* TS EN ISO 13795-1:2019' e göre, kritik ve daha az kritik ürün alanlarında hem standart performans hem de yüksek performans testlerinde istenilen Tüylenme/tiftiklenme katsayısı(CL) (log 10) ≤4,0 olmalıdır.

Toplam Belirsizlik(iç yüzey): ±%9,4

Toplam Belirsizlik(dış yüzey): ±%12,1

TEST REPORT
DENEY RAPORU

AB-0583-T

21036445

12-21

Müşterinin adı: ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi: MAHMUTBEY MAHALLESİ 2567 SOK. NO:1 İŞ YERİ NO:11,21 BAĞCILAR/İSTANBUL
Alıcı firma: -
İlgili kişi: BUSENUR KILIÇ
İstek numarası: LOT NO:012021291015
Model numarası: TEK KULLANIMLIK ÖRTÜ VE ÖNLÜK
Numunenin adı ve tarifi: Mavi dokusuz yüzey cerrahi örtü(Müşteri tarafından belirtilmiştir; 10 Adet / Mavi)
Numunenin kabul tarihi: 30.11.2021
İlave numune ve/veya ilave bilgi geliş tarihi: -
Deneyin yapıldığı tarih: 30.11.2021-15.12.2021
Açıklamalar: -
Numune alımı: Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir.
Numunenin son kullanımı: -
Yıkama talimatı: Belirtilmedi
Raporun sayfa sayısı: 8

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0583-T akreditasyon dosya numarası ile ISO 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması)

Mühür

Tarih

15.12.2021

Müşteri Temsilcisi

Zahide TAPAN

Laboratuvar Müdürü

Sevim A. RAZAK

15.12.2021

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036445

12-21

İSTENEN TESTLER	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ		
Mikrobiyal Temizlik Yüğü (Biyoyük Tayini)	P	
Bakteriyel Geçirgenliğe Olan Direncin Tayini-İslak Metot	P	
Mikrobiyal Geçirgenliğe Olan Direncin Tayini-Kuru Metot	P	
FİZİKSEL ÖZELLİK TESTLERİ		
Kopma Mukavemeti / Kuru	P	
Kopma Mukavemeti / Yaş	P	
Patlama Mukavemeti / Kuru	P	
Patlama Mukavemeti / Yaş	P	
Su Geçirgenliği	P	
Dokusuz Yüzeylerde Tiftik ve Partikül Oluşumu	P	
P: Geçer F: Kalır R: Alıcı firmanın teknik kişisine başvurunuz Test sonuçları EN 13795-1:2019 (*) Standart Performans Özellikleri limit değerlerine göre değerlendirilmiştir. (Tablo 1)		

Not: Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Müşteri tarafından talep edildiğinde testlere ait ölçüm belirsizliği raporlanır fakat "Geçer/Kalır" değerlendirmesinde ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınmaz. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Uygunluk beyanı Basit Kabul Karar Kuralına göre verilmiştir. Bu raporda (*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir.



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036445

12-21

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL TEMİZLİK (BİYÖYÜK) ; EN ISO 11737-1:2018

5 numune çalışılır. Numune tartılır ve test çözeltisi içerisine atılarak iyice çalkalanır (250 rpm de 5 dk) ve uygun besiyerlerine ekilir. Toplam aerobik bakteriler için 30±1°C'de 72 saat, küf ve maya için ise 20-25 °C'de 7 gün inkübasyon sonrası agarda oluşan mikroorganizmalar sayılır.

	<u>SONUÇ</u>	<u>İSTENEN</u>
Mikrobiyal Temizlik (kob/100 cm²)	5 kob/100 cm ²	≤300 kob/100 cm ²

*kob:Koloni oluşturan birim

Toplam Belirsizlik: 0,28

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036445

12-21

TEST SONUÇLARI

BAKTERİYEL GEÇİRGENLİĞE OLAN DİRENCİN TAYİNİ-ISLAK METOT;

BS EN ISO 22610: 2006

Dönen bir disk üzerindeki agar plakasına bir test örneği konur. Test örneğinin üzerine bakteri taşıyıcı materyali ve kaplama filmi yerleştirilir ve bütün parçalar disk üzerinde sabitlenir. Test örneğine belirli bir kuvvet ($3N \pm 0,02$) uygulamak üzere bir parmak yerleştirilir. Parmak, 15 dakika içinde agarın tüm yüzeyi boyunca test örneği üzerinde hareket eder. 15 dakikalık 5 çalışma yapılır. 6. çalışma numune ters çevrilerek tekrarlanır..

Numune miktarı :	5 adet 25x25cm2
Taşıyıcı Materyal:	30 µm inceliğinde , 25x25cm2 Poliüretan Film
Kaplama Materyali:	25x25cm2 HDPE Film
Mikroorganizma:	Staphylococcus aureus ATCC 29213
Bakteri Konsantrasyonu (kob/ml) :	5×10^4 kob/ml
İnkübasyon Koşulları:	(36 ± 1)°C 48 saat

SONUÇLAR				
Nüfus Etme Zamanı (min)	Nüfus Eden Bakteri Sayısı (cfu)		Nüfus Etme Oranı	
15	X_1	0	RCUM1	0
30	X_2	0	RCUM2	0
45	X_3	0	RCUM3	0
60	X_4	0	RCUM4	0
75	X_5	0	RCUM5	0
	Z	230		
	T			230

X_1 X_5 : Aynı numunedeki 5 paralel petride üreyen koloni sayısı

Z : altıncı petride üreyen koloni sayısı

T: $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$

RCUM1 = X_1/T

RCUM2 = $(X_2 + X_1)/T$

RCUM3 = $(X_3 + X_2 + X_1)/T$

RCUM4 = $(X_4 + X_3 + X_2 + X_1)/T$

RCUM5 = $(X_5 + X_4 + X_3 + X_2 + X_1)/T$

BARİYER İNDEKSİ (IB)		
IB	Sonuç	Kabul edilen (*)
	6,0	≥ 2.8
$IB = 6 - (CUM1 + CUM2 + CUM3 + CUM4 + CUM5)$		

Toplam Belirsizlik: 0,08

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036445

12-21

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL GEÇİRGENLİĞE OLAN DİRENCİN TAYİNİ-KURU METOT ; ISO 22612:2005

Numuneler ve konteynerler steril edilir. Her bir konteynere agar plakaları konulur. Numuneler aseptik bir şekilde aparata yerleştirilir. Kapaklar kapatılır. Piston ile numunede bir potluk yapıldıktan sonra pistonlar çıkarılır ve beş adet numuneye bakteri ile kontamine edilmiş pudradan, altıncıya ise kontamine olmamış pudradan kontrol olarak $0,5 \text{ g} \pm 0,1 \text{ g}$ eklenir. Ardından tüm açıklıklar plastik bir poşetle kapatılır. Dakikada 20.800 titreşim verecek şekilde cihaz çalıştırılır. Test süresi 30 dakikadır. Test bittikten sonra tüm agar plakaları 35°C 'de 24 saat inkübe edilir.

Numune miktarı: 6 adet $20 \times 20 \text{ cm}^2$
Mikroorganizma: *Bacillus subtilis* ATCC 9372
Bakteri Konsantrasyonu (kob/ml): $1 \times 10^8 \text{ kob/ml}$
İnkübasyon Koşulları: $35^{\circ}\text{C} / 24 \text{ saat}$

SONUÇLAR

Nüfuz Eden Bakteri Sayısı (kob)

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6 (Kontrol)	0
Toplam	0
Logaritma	-

SONUÇ

Sonuç (kob/g)
0 kob/g

Beklenen Değer
 $\leq 300 \text{ kob/g}$

Toplam Belirsizlik: 0,12

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036445

12-21

TEST SONUÇLARI

KOPMA MUKAVEMETİ ; BS EN 29073-3:1992

Instron 5969 (Yük: 5 kN), Şerit Metodu.

Hız: 100 mm/dk±10, Çene mesafesi 200 mm.

Ön gerilme uygulanmamıştır. Islatma işlemi yapılmamıştır.

En ve boy yönlerinde 5 adet sonucun ortalaması verilmiştir.

Kondüsyon şartlarında test edilmiştir. (20±2°C - %65±4)

Kuru ;

	<u>SONUC</u>	<u>İSTENEN</u>
En	70,3 N	≥ 20N (Kuru)
Boy	152,4 N	≥ 20N (Kuru)

Toplam Belirsizlik: ±%4,9

KOPMA MUKAVEMETİ ; BS EN 29073-3:1992

Instron 5969 (Yük: 5 kN), Şerit Metodu.

Hız: 100 mm/dk±10, Çene mesafesi 200 mm.

Ön gerilme uygulanmamıştır. Islatma işlemi yapılmıştır.

En ve boy yönlerinde 5 adet sonucun ortalaması verilmiştir.

Kondüsyon şartlarında test edilmiştir. (20±2°C - %65±4)

Yaş ;

	<u>SONUC</u>	<u>İSTENEN</u>
En	67,5 N	≥ 20N (Yaş)
Boy	125,7 N	≥ 20N (Yaş)

Toplam Belirsizlik: ±%4,9

PATLAMA MUKAVEMETİ; ISO 13938-1:1999

Tru Brust James H. Test cihazı. Test alanı 30.5 mm çap

Hacim artış oranı: 29 cm³/dakika

5 adet sonucun ortalaması verilmiştir.

Kondüsyon şartlarında test edilmiştir (20±2°C-65%±4).

	<u>SONUC</u>	<u>İSTENEN</u>
Kuru ;	355 kPa	≥ 40 kPa (Kuru)
Şişirme mesafesi*	8,7 mm	

Toplam Belirsizlik: ±%3,4

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036445

12-21

TEST SONUÇLARI

PATLAMA MUKAVEMETİ; ISO 13938-1:1999

Tru Brust James H. Test cihazı. Test alanı 30.5 mm çap
Hacim artış oranı: 29 cm³/dakika
5 adet sonucun ortalaması verilmiştir.
Kondüsyon şartlarında test edilmiştir (20±2°C-65%±4).

Yaş ;

SONUÇ
314 kPa

İSTENEN
≥ 40 kPa (Kuru)

Şişirme mesafesi*
Toplam Belirsizlik: ±%3,4

8,8 mm

SU GEÇİRGENLİĞİ; ISO 811:2018

Hidrostatik Başlık Cihazı, Textest marka Fx 3000 model
Su sıcaklığı 20°C. Basınç artış oranı 10 mbar/dk.
Kondüsyonlu ortamda test edilmiştir. (20±2°C-65%±4).

Numune 1
Numune 2
Numune 3
Numune 4
Numune 5

RESULT
117,3 cm H₂O
105,1 cm H₂O
120,4 cm H₂O
110,2 cm H₂O
112,2 cm H₂O

REQUIREMENT
≥ 20cm H₂O

Ortalama

113,0 cm H₂O

Toplam Belirsizlik: ±%7,7

Gen.FI36-1/03

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

21036445

12-21

TEST SONUÇLARI

DOKUSUZ YÜZEYLERDE TİFTİK VE PARTİKÜL OLUŞUMU ; ISO 9073-10: 2003

Boy yönünde 5 adet numune (iç ve dış yüzey için ayrı) test edilir. Numuneler ISO 14644-1' göre Sınıf 5 kategorisindeki bir temiz odada, bükülme ve sıkıştırma hareketi yapan Gelbo Flex cihazına cihazına yerleştirilir. Numuneden kopan tiftik ve partiküller, sayaç cihazı ile sayılır ve boyut aralığına göre sınıflandırılır.

SOLAIR 3100 partikül ölçme cihazı

Min. ölçüm boyutu: 0,3 µm,

Maks. ölçüm boyutu: 25 µm

Hava akışı: 28,3 ± 1,4 L/dk

Cihaz çalışma modu: 30 sn x 10 tur

NUMUNE (İÇ YÜZEY)

Toplam tüylenme/tiftiklenme : 122

Standart sapma : 36

Varyans Katsayısı : %29

Tüylenme/tiftiklenme katsayısı(CL): 2

NUMUNE (DIŞ YÜZEY)

Toplam tüylenme/tiftiklenme : 91

Standart sapma : 78

Varyans Katsayısı : %85

Tüylenme/tiftiklenme katsayısı(CL): 2

NUMUNE (TOPLAM)

Toplam tüylenme/tiftiklenme : 213

Tüylenme/tiftiklenme katsayısı(CL)*: 2

* TS EN ISO 13795-1:2019' e göre, kritik ve daha az kritik ürün alanlarında hem standart performans hem de yüksek performans testlerinde istenilen Tüylenme/tiftiklenme katsayısı(CL) (log 10) ≤4,0 olmalıdır.

Toplam Belirsizlik(iç yüzey): ±%9,4

Toplam Belirsizlik(dış yüzey): ±%12,1

AB-0583-T
21036445- İNG
12-21

Customer name: ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Address: MAHMUTBEY MAHALLESİ 2567 SOK. NO:1 İŞ YERİ NO:11,21 BAĞCILAR/İSTANBUL
Buyer name: -
Contact Person: BUSENUR KILIÇ
Order No: LOT NO:012021291015
Article No: DISPOSABLE DRAPE AND GOWN
Name and identity of test item: Blue non woven surgical drape (claimed to be; 10 Pcs / Blue)
The date of receipt of test item: 30.11.2021
Re-submitted/re-confirmation date: -
Date of test: 30.11.2021-15.12.2021
Remarks: -
Sampling: The results given in this report belong to the received sample by vendor.
End-Use: -
Care Label: Not specified.
Number of pages of the report: 8

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number [AB-0583-T] for ISO 17025:2017 as test laboratory.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report

Seal

Date

15.12.2021

Customer Representative

Zahide TAPAN

Head of Testing Laboratory

Sevim A. RAZAK

15.12.2021

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**


AB-0583-T

21036445-
İNG

12-21

REQUIRED TESTS	EVALUATION	COMMENTS
MICROBIOLOGICAL TEST		
Microbial Cleanliness (Bioburden)	P	
Resistance to Bacterial Penetration-Wet Method	P	
Resistance to Microbial Penetration-Dry Method	P	
PHYSICAL PROPERTIES TESTS		
Tensile Strength / Dry	P	
Tensile Strength / Wet	P	
Bursting Strength / Dry	P	
Bursting Strength / Wet	P	
Water Permeability	P	
Lint and Other Particles Generation From Nonwoven	P	
P: Pass F: Fail R: Refer to retailer technologist. Test results were evaluated according to EN 13795-1:2019(*) Standard Performance Properties limit values (Table 1)		

REMARK: Original samples are kept for 3 months and all technical records are kept for 5 years unless otherwise specified. If requested, measurement uncertainty will be reported. But unless otherwise specified, measurement uncertainty is not considered while stating compliance with specification or limit values. The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95 %. Tests marked (*) in this report are not included in the accreditation schedule.

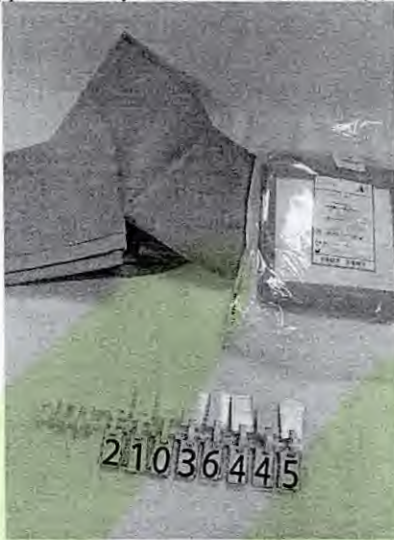

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036445-
İNG

12-21

TEST RESULTS

MICROBIAL CLEANLINESS (Bioburden) ; EN ISO 11737-1:2018

The sample is put in extraciton liquid after shaking well after shaking well (250 rpm,5 min), inoculated on the suitable agar.The plates are incubated for 3 days at 30 ± 1 °C for 72 hours, and 7 days at (20 to 25) °C for TSA and SDA plates respectively.
Total microoragnisms counts are calculated.

RESULTS

REQUIREMENT

Microbial cleanliness (cfu/100 cm²)

5 cfu/100 cm²

≤300 cfu/100 cm²

*cfu= Colony forming unit.

Total Uncertainty: 0,28

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036445-
İNG

12-21

TEST RESULTS

DETERMINATION OF RESISTANCE TO BACTERIAL PENETRATION-WET METHOD ; BS EN 22610: 2006

A test sample is placed on the agar plate on a rotating disc. Bacteria carrier material and coating film are placed on the test sample and all parts are fixed on the disk. A finger is placed on the test sample to apply a certain force ($3N \pm 0.02$). The finger moves on the test sample over the entire surface of the agar within 15 minutes. 5 studies are carried out for 15 minutes. 6. The study is repeated by inverting the sample.

Sample amount:	5 pieces 25x25cm ²
Carrier Material:	30 µm thin, 25x25cm ² Polyurethane Film
Coating Material:	25x25cm ² HDPE Film
Microorganism:	Staphylococcus aureus ATCC 29213
Bacterial Concentration (kob / ml):	5×10^4 kob / ml
Incubation Conditions:	(36 ± 1) ° C 48 hours

RESULTS			
Number of Populating Bacteria (cfu)		Penetration Rate	
X ₁	0	R _{CUM1}	0
X ₂	0	R _{CUM2}	0
X ₃	0	R _{CUM3}	0
X ₄	0	R _{CUM4}	0
X ₅	0	R _{CUM5}	0
Z	230		
T			230
X₁ X₅: Number of colonies growing in 5 parallel petri in the same sample Z: number of colonies growing in the sixth petri dish T: X₁ + X₂ + X₃ + X₄ + X₅ + Z R_{CUM1} = X₁/T R_{CUM2} = (X₂ + X₁)/T R_{CUM3} = (X₃ + X₂ + X₁)/T R_{CUM4} = (X₄ + X₃ + X₂ + X₁)/T R_{CUM5} = (X₅ + X₄ + X₃ + X₂ + X₁)/T			
Critical area		BARRIER INDEX (I _B)	
		Result	Expected value (*)
I _B		6,0	≥2.8
I _B = 6 - (CUM1 + CUM2 + CUM3 + CUM4 + CUM5)			

Total Uncertainty: 0,08

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036445-
İNG

12-21

TEST RESULTS

DETERMINATION OF RESISTANCE TO MICROBIAL PENETRATION-DRY METHOD; ISO 22612:2005

Samples and containers are sterilized. Agar plates are placed in each container. Samples are placed aseptically in the apparatus. The covers are closed. After making a pot in the sample with the piston, the pistons are removed and $0.5 \text{ g} \pm 0.1 \text{ g}$ are added to five samples from the powder contaminated with bacteria and the six to the non-contaminated powder. Then all openings are closed with a plastic bag. The device is operated to give 20,800 vibrations per minute. The test time is 30 minutes. After the test is over, all agar plates are incubated at 35°C for 24 hours.

Less Critical area

Sample amount: 6 pieces $20 \times 20 \text{ cm}^2$
Mikroorganism: *Bacillus subtilis* ATCC 9372
Bacterial concentration (cfu/ml): $1 \times 10^8 \text{ kob/ml}$
Incubation conditions: $35^\circ \text{C} / 24 \text{ hours}$

RESULTS

Number of Populationg Bacteria (cfu)

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6 (Control)	0
Total	0
Logarithm	-

RESULT

Result (cfu/g)
0 cfu/g

Expected Value
 $\leq 300 \text{ cfu/g}$

Total Uncertainty: 0,12

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036445-
İNG

12-21

TEST RESULTS

TENSILE STRENGTH; EN 29073-3:1996

Instron 5969 (Load: 5 kN), Strip Method.

Speed: 100 mm/min $\pm$ 10, Gauge length 200 mm.

Pre-load was not applied. Without wetting samples.

The average results are given for width and length direction of three samples

Performed in the conditioned room (20 $\pm$ 2°C-65% $\pm$ 4).

Dry ;

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Width	70,3 N	$\geq$ 20N (Dry)
Length	152,4 N	$\geq$ 20N (Dry)
Total Uncertainty: $\pm$ %4,9		

TENSILE STRENGTH; EN 29073-3:1996

Instron 5969 (Load: 5 kN), Strip Method.

Speed: 100 mm/min $\pm$ 10, Gauge length 200 mm.

Pre-load was not applied. Without wetting samples.

The average results are given for width and length direction of three samples

Performed in the conditioned room (20 $\pm$ 2°C-65% $\pm$ 4).

Wet;

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Width	67,5 N	$\geq$ 20N (Wet)
Length	125,7 N	$\geq$ 20N (Wet)
Total Uncertainty: $\pm$ %4,9		

BURSTING STRENGTH;; ISO 13938-1:1999

SDL ATLAS M229 tester. Test area: 30.5 mm diameter

The average results are given of five samples.

Performed in the conditioned room (20 $\pm$ 2°C-65% $\pm$ 4).

Less Critical area

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Dry ;	355 kPa	$\geq$ 40 kPa (Dry)
Height at Burst*	8,7 mm	

Total Uncertainty: $\pm$ %3,4

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036445-
İNG

12-21

TEST RESULTS

BURSTING STRENGTH;; ISO 13938-1:1999

SDL ATLAS M229 tester. Test area: 30.5 mm diameter
The average results are given of five samples.
Performed in the conditioned room (20±2°C-65%±4).

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Wet ;	314 kPa	≥ 40 kPa (Wet)
Height at Burst*	8,8 mm	

Total Uncertainty: ±%3,4

WATER PERMEABILITY; ISO 811:2018

Hydrostatic Head Tester, Textest marka Fx 3000 model
Temperature of water 20°C. Pressure increase ratio 10 mbar/min.
Performed in the conditioned room (20±2°C-65%±4)

	<u>RESULT</u>	<u>REQUIREMENT</u>
Sample 1	117,3 cm H ₂ O	≥ 20 cm H ₂ O
Sample 2	105,1 cm H ₂ O	
Sample 3	120,4 cm H ₂ O	
Sample 4	110,2 cm H ₂ O	
Sample 5	112,2 cm H ₂ O	
Average	113,0 cm H ₂ O	

Total Uncertainty: ±%7,7

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21036445-
İNG

12-21

TEST RESULT

LINT AND OTHER PARTICLES GENERATION FROM NONWOWEN;

Test Metod: ISO 9073-10: 2003

5 test samples that in cross direction are maintained to twisting and compression action with Gelbo Flex for inner and outer surface in a clean room condition (according to ISO 14644-1 Class 5).

Lint and particles detached from the sample are counted with counter device and classified to size range.

Min. measuring size of SOLAIR 3100 particles measuring device: 0,3 µm,

Max. measuring size of SOLAIR 3100 particles measuring device: 25 µm,

Air flow: 28,3 ± 1,4 L/min Working mode: 30 s x 10 consecutive periods

Critical area

SAMPLE, INNER SURFACE (3 µm - 25 µm)		SAMPLE, OUTER SURFACE (3 µm - 25 µm)	
Total linting	: 122	Total linting	: 91
Standard deviation	: 36	Standard deviation	: 78
Coefficient of variation	: 29%	Coefficient of variation	: 85%
Coefficient of linting (CL):	2	Coefficient of linting (CL)	:2
SAMPLE, MATERIAL (TOTAL)			
Total linting	:213		
Coefficient of linting (CL)*	:2		

*According to EN ISO EN ISO 13795-1:2019, Coefficient of linting (CL) (log 10) should be ≤4 for analysis of critical product area and less critical product area of both standard performance and high performance testing.

Total Uncertainty(Inner surface): ±%9,4

Total Uncertainty(Out surface): ±%12,1