

Anexa 20 Brancarda sanitara (caracteristici de baza) , Model: MYS-950, Meyosis

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg da Antitredelinburg da Control manual Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm "Mînere pentru transportarea brancardei" da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da</p>	<p>Brancarda (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancarda destinata pentru transportarea pacientilor" Parametru Specificație Tip reglabila pe inaltime 48-75 cm; Poziționare "Tredelinburg da, Antitredelinburg da Caracteristici Bare laterale pliante da Roți Diametru ≥ 150 mm Frine "cu blocare centrală la toate 4 roți" Sarcina maximă - 250 kg Dimensiuni - 215 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea da, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Este dotat cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da</p>

Anexa 21 Brancarda sanitara (caracteristici avansate) , Model: MYS-650, Meyosis

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
<p>Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 2 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 20 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparentă la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 60 - 90 cm</p> <p>Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 15 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" da "Posibilitatea de blocare a direcției roților" da Material "oțel inox vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 250 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da</p>	<p>Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere "Brancarda destinata pentru transportarea pacientilor" Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor > 20 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" > 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparentă la razele x-ray (radiografie, brac C) da Da, casete pot fi amplasate pe toata lungimea brancardei . Reglabilă pe înălțime 57,5 -88.5 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru 20 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" da "Posibilitatea de blocare a direcției roților" da Material "oțel inox vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 250 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da "Este dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da</p>

Anexa 22 Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) , Model: MYS-5410NE, Meyosis

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Pat multifunctional pentru adulți (5-6 pozitii) Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spetează ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 pozitii) Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spetează 250 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 77.5 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da

Anexa 23 Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) , Model: MYS-5410NE, Meyosis

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
<p>Pat multifunctional pentru adulți (6-8 pozitii) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da</p>	<p>Pat multifunctional pentru adulți (6-8 pozitii) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat 250 kg Înălțime Ajustabilă 77.5 cm Rotile Diametru 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate are cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică -da Alimentare 220 V, 50 Hz (si baterie interna) Saltele lavabile ortopedică da</p>

Anexa 24 Fotoliu ginecologic , Model: MYS-923, Meyosis

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Fotoliu ginecologic Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	Fotoliu ginecologic Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 91 cm Capacitate maximă 250 kg



DECLARATION OF CONFORMITY

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Kandış İş Merkezi No:128 kat: 1 D:1 Ataşehir/İstanbul, Türkiye

PRODUCTS:

Emergency Stretcher: MYS-650

CLASSIFICATION : Class 1

We herewith declare that the above mentioned products meet the provisions of the following EC Council Directives and Standards.

GENERAL APPLICABLE DIRECTIVES:

Medical Devices Directive 93/42/EEC of June 1993 concerning medical devices.


Date / Place of Issue : 04.01.2021 / İSTANBUL

Name : Mehmet Öğün Geyik

Position : Chairman

Signature:

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI
SAN. VE TİC. A.Ş.
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No128
K-1 Kandış İş Merkezi Ataşehir İST.
Kozyatağı V.D. 742 048 2891
Tic. Sic. No:44513-5





DECLARATION OF CONFORMITY

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Kandış İş Merkezi No:128 kat: 1 D:1 Ataşehir/İstanbul, Türkiye

PRODUCTS:

Delivery Chair With Motors: MYS-923

CLASSIFICATION : Class 1

We herewith declare that the above mentioned products meet the provisions of the following EC Council Directives and Standards.

GENERAL APPLICABLE DIRECTIVES:

Medical Devices Directive 93/42/EEC of June 1993 concerning medical devices.

Standards:

EN 60601-1:2009 : Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds

EN 60601-2-38:2003 : Particular requirements for the safety of electrically operated hospital beds


Date / Place of Issue : 04.01.2021 / İSTANBUL

Name : Mehmet Öğün Geyik

Position : Chairman

Signature :

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI
SAN. ve TİC. A.Ş.
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No128
K:T Kandış İş Merkezi Ataşehir İST.
Kozyatağı V.D. 742 046 2891
Tic. Sic. No:44513-5





DECLARATION OF CONFORMITY

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Kandış İş Merkezi No:128 kat: 1 D:1 Ataşehir/İstanbul, Türkiye

PRODUCTS:

Hydraulic Stretcher: MYS-950

CLASSIFICATION : Class 1

We herewith declare that the above mentioned products meet the provisions of the following EC Council Directives and Standards.

GENERAL APPLICABLE DIRECTIVES:

Medical Devices Directive 93/42/EEC of June 1993 concerning medical devices.


Date / Place of Issue : 04.01.2021 / İSTANBUL

Name : Mehmet Öğün Geyik

Position : Chairman

Signature:

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI
SAN. VE TİC. A.Ş.
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No128
K-1 Kandış İş Merkezi Ataşehir İST.
Kozyatağı V.D. 742 048 2891
Tic. Sic. No:44513-5





DECLARATION OF CONFORMITY

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Kandış İş Merkezi No:128 kat: 1 D:1 Ataşehir/İstanbul, Türkiye

PRODUCTS:

4 Motors ICU Hospital Bed: MYS-5410NE

CLASSIFICATION : Class 1

We herewith declare that the above mentioned products meet the provisions of the following EC Council Directives and Standards.

GENERAL APPLICABLE DIRECTIVES:

Medical Devices Directive 93/42/EEC of June 1993 concerning medical devices.

Standards:

EN 60601-1:2009 : Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds

EN 60601-2-38:2003 : Particular requirements for the safety of electrically operated hospital beds


Date / Place of Issue : 04.01.2021 / İSTANBUL

Name : Mehmet Ögün Geyik

Position : Chairman

Signature :

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI
SAN. VE TİC. A.Ş.
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No128
K-1 Kandış İş Merkezi Ataşehir İST.
Kozyatağı V.D. 742 048 2891
Tic. Sic. No:44513-5





CERTIFICATE

TÜRCERT Sertifikasyon Merkezi
iş bu belge ile

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:128 D-1 Kandış İş Merkezi Ataşehir / İstanbul
Fabrika: Hadımköy Mah. 75.Yıl Cad. Dış Kapı No:26 D:İSY2 Arnavutköy / İstanbul

şirketinin;

«Hasta karyoları ve mekanik, hidrolik, elektrikli, motorlu, elektromekanik, donanımlı hasta karyoları üretimi satışı ve pazarlanması, teknik servis hizmetleri »

belirlenen standardın uygulanması konusunda bir **Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi** yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu taahhüt eder.

MDQMS2021051702 Sayılı rapordaki inceleme ile

TS EN ISO 13485 : 2016

şartlarının sağlanmış olduğu kanıtlanmıştır, iş bu sertifika yıllık ara denetimlerinin yapılması kaydıyla **17.05.2022** tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika Kayıt No : 2021051702

Sertifika Yayın Tarihi : 17.05.2021

Sertifika Geçerlilik Tarihi : 17.05.2022



Belgelendirme Bölümü Adına



51902430608 (MDQMS)



TÜRCERT TEKNİK KONTROL ve BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Merkez Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:38/44 A Güngören - İstanbul - Turkey
Tel: +90 212 702 40 00 www.turcert.com

Bu belge müşterinin TÜRCERT'in kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the rules TÜRCERT procedures and agreements.



Belge Geçerlilik Sorgulama



MYS-5410NE
ICU BED WITH 4 MOTORS
TECHNICAL BROCHURE



MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş.

Headquarters: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Kandış İş Merkezi No:128 kat: 1
D:1 Ataşehir/İstanbul, Türkiye T:+902165746738 F:+902165746739

Manufacturing: Hadımköy Mahallesi 75.Yıl Caddesi Dış Kapı No:26
Daire:İŞY2 Arnavutköy/İstanbul

PRODUCT:

TRADE MARK : MEYOSIS
MODEL : MYS-5410NE
NAME : ICU BED WITH 4 MOTORS



1. TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- a.** Backrest, leg rest, auto contour, height (up - down), Electronic CPR, cardiac position, trendelenburg & reverse Trendelenburg positions are operated by 4 DC motors.
- b.** Positions are controlled by “Nurse Control Panels” located on outer side rails, “Patient Control Panels” located on inner sides of the side rails and by Nurse Remote Control.
- c.** Accessory sockets are located at each corner of the bed for IV poles or traction sets.
- d.** Head and foot boards are made of PP plastic and easily clearable. These parts can also be assembled and disassembled easily.
- f.** 4 pieces folding side rails are made of PP plastic and have release system assisted by gas spring.
- g.** Automatic back sliding and leg sliding functions are available in the bed.
- h.** One adjustable IV pole is provided with the bed.
- i.** Metal chassis is epoxy polyester electrostatic painted.
- j.** Bumpers are located at each corner of the bed to protect the bed against crushes.



- k. Central Brake System with 125 mm diameter casters
- l. 4 patient restraint strap holders (2 on each side).
- m. There are drainage bag holders at both sides of the bed.
- n. Mattress is waterproof and zippered.
- o. Battery
- p. Scale system (optional).

2. DIMENSIONS:

- Full Length: 214,5 cm
- Full Width: 108 cm
- Minimum Height: 41 cm
- Maximum Height: 77,5 cm
- Mattress Length : 190 cm
- Mattress Width : 90 cm
- Weight Capacity: 250 kg



3. OPERATING ANGLES:

- Back Movement: 0°-70°
- Leg Movement: 0°-30°
- Vascular Position
- Knee Movement
- Hight Adjustment
- Trandelenburg & Reverse Trandelenburg 0°-17°
- Cardiac Position



4. MATTRESS:

- Waterproof and zipped cover,
- CNC cut,
- Adaptable to all movements
- **28 kg/m³** density foam
- 90 cm x 110 cm x 11 cm (h)






(Fig.1) Hand Remote Control

5. HAND REMOTE CONTROLS:

- Backrest, legrest, automatic contour and height (up - down) positions can be adjusted electronically by the help of the keys on **Hand Remote Control (Fig.1)**.
- Backrest, legrest, height (up - down), trendelenburg, reverse trendelenburg and CPR positions can be adjusted electronically by the help of the keys on **Nurse Remote Control (Fig.2)**.
- Also “**Activation Key**” is available on the Nurse Control Panels. All functions of the bed can be locked by this key.

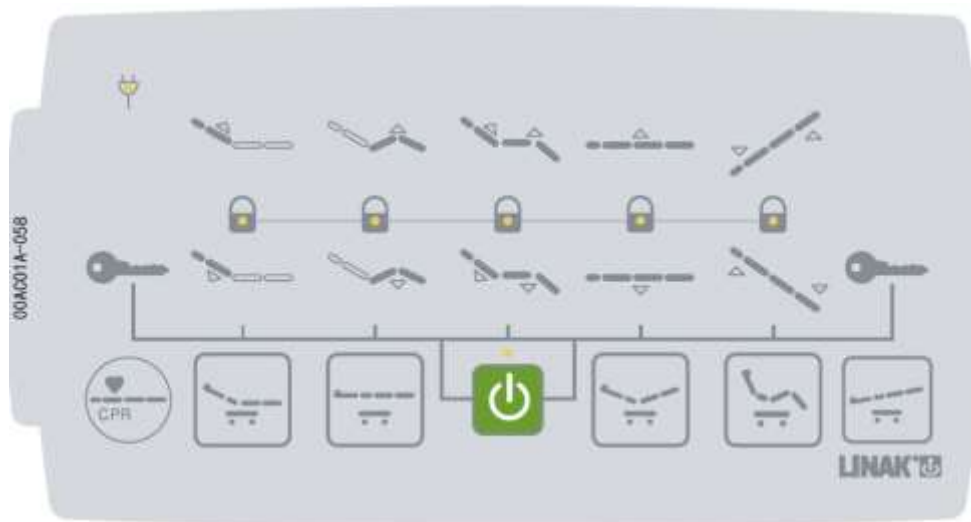

(Fig.2) Nurse Remote Control

6. BRAKE AND STEER SYSTEM:

- BRAKE** (pedal is in “full down” position): Brakes are applied on all four castors (all castors are locked).
- FREE** (pedal is in “middle-neutral” position): All four castors are free to rotate and swivel.
- STEER** (pedal is in “full up” position): Three castors can rotate and swivel, the steering castor can only rotate but cannot swivel.



MYS-650
EMERGENCY STRETCHER
BROCHURE



MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş.

Headquarters: İnönü Mh. Kayışdağı Cd. Kandış İş Merkezi No: 128 K:1

Ataşehir – İstanbul

T:+902165746738

Manufacturing: Hadımköy Mh. 75. Yıl Cd.No: 110-26 B İşyeri No: 2

Arnavutköy İstanbul-Turkey

www.meyosis.com

PRODUCT:

TRADE MARK : MEYOSIS
MODEL : MYS-650
NAME : EMERGENCY STRETCHER

1. TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Back side adjustment by gas spring and foot side adjustment by destomat system
- Height adjustment, trendelenburg and reverse trendelenburg by hydraulic pedals at both sides
- Full length polyurethane side rails
- Full length X-RAY cassette place
- Oxygen tube place
- 1 IV Pole
- 200mm, 360 degrees swivel wheels with central break system and directional lock
- 5th Wheel assisted direction fixing system
- 4 bumpers on the 4 corners of the stretcher
- Compact laying surface
- Water proof mattress
- Fluid basin and IV pole

2. DIMENSIONS:

WIDTH (cm) : 80,5 cm
LENGHT(cm) : 211,5 cm
MIN. HEIGHT(cm) : 57,5 cm
MAX. HEIGHT (cm) : 88,5 cm: 88,5 cm





MYS-923 DELIVERY CHAIR WITH MOTORS



**MEYOSIS HASTANE EKİPMANLARI
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd
N:137/1 Kat:4 Çelik Plaza Ataşehir -
İstanbul T:+902165746738

F:+902165746739

www.meyosis.com

PRODUCT:

TRADE MARK : MEYOSIS HOSPITAL EQUIPMENTS
MODEL : MYS-923
NAME : DELIVERY CHAIR WITH MOTORS



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- a. Back movement, leg movement, height movement, back-leg movement, trendelenburg and reverse trendelenburg are controlled by 3 DC motors.
- b. Lithotomy, sitting-chair and bed positions.
- c. It transforms to hospital bed with attachable footside panel and footside platform.
- d. Paper roll holder on back rest.
- e. Head board is made of PP plastic and easily clearable. It can also be assembled and disassembled easily.
- f. 3 pieces fixed laying surface is covered with faux leather
- g. 2 pieces folding side rails are made of PP plastic and can move by hydraulic system.
- h. Delivery Chair has automatic back sliding function.
- i. Metal chassis is epoxy polyester electrostatic painted and covered with ABS plastic.
- j. There are 2 IV holes on head corners of the bed and one adjustable IV pole.
- k. There are 2 bumpers on head corners of the bed.
- l. Integrated labor handles on both side rails.
- m. Integrated stainless steel fluid basin.
- n. 230 V~AC 50/60 Hz.

DIMENSIONS:

- Full Length: 205 cm (*from bumpers*)
- Full Width: 101 cm (*siderails up*)
- Height: 55 cm – 91 cm (*from chassis*)
- Total bedding surface length: 181 cm
- Mattress width: 70 cm
- Back Section length: 80 cm
- Seat Depth: 51 cm
- Foot Part length: 46 cm
- Weight capacity: 250 kg



OPERATING ANGLES:

- Back Movement: 0°-70°
- Leg Movement: 0°-90°

BRAKE SYSTEM:

- Brakes are applied on all four castors (all castors are locked).
- All four castors are free to rotate and 360° swivel.
- Three castors can rotate and 360° swivel, the steering castor can only rotate but cannot swivel.


MYS-950

PEDIATRIC STRETCHER



Meyosis®

TECHNICAL INFORMATION

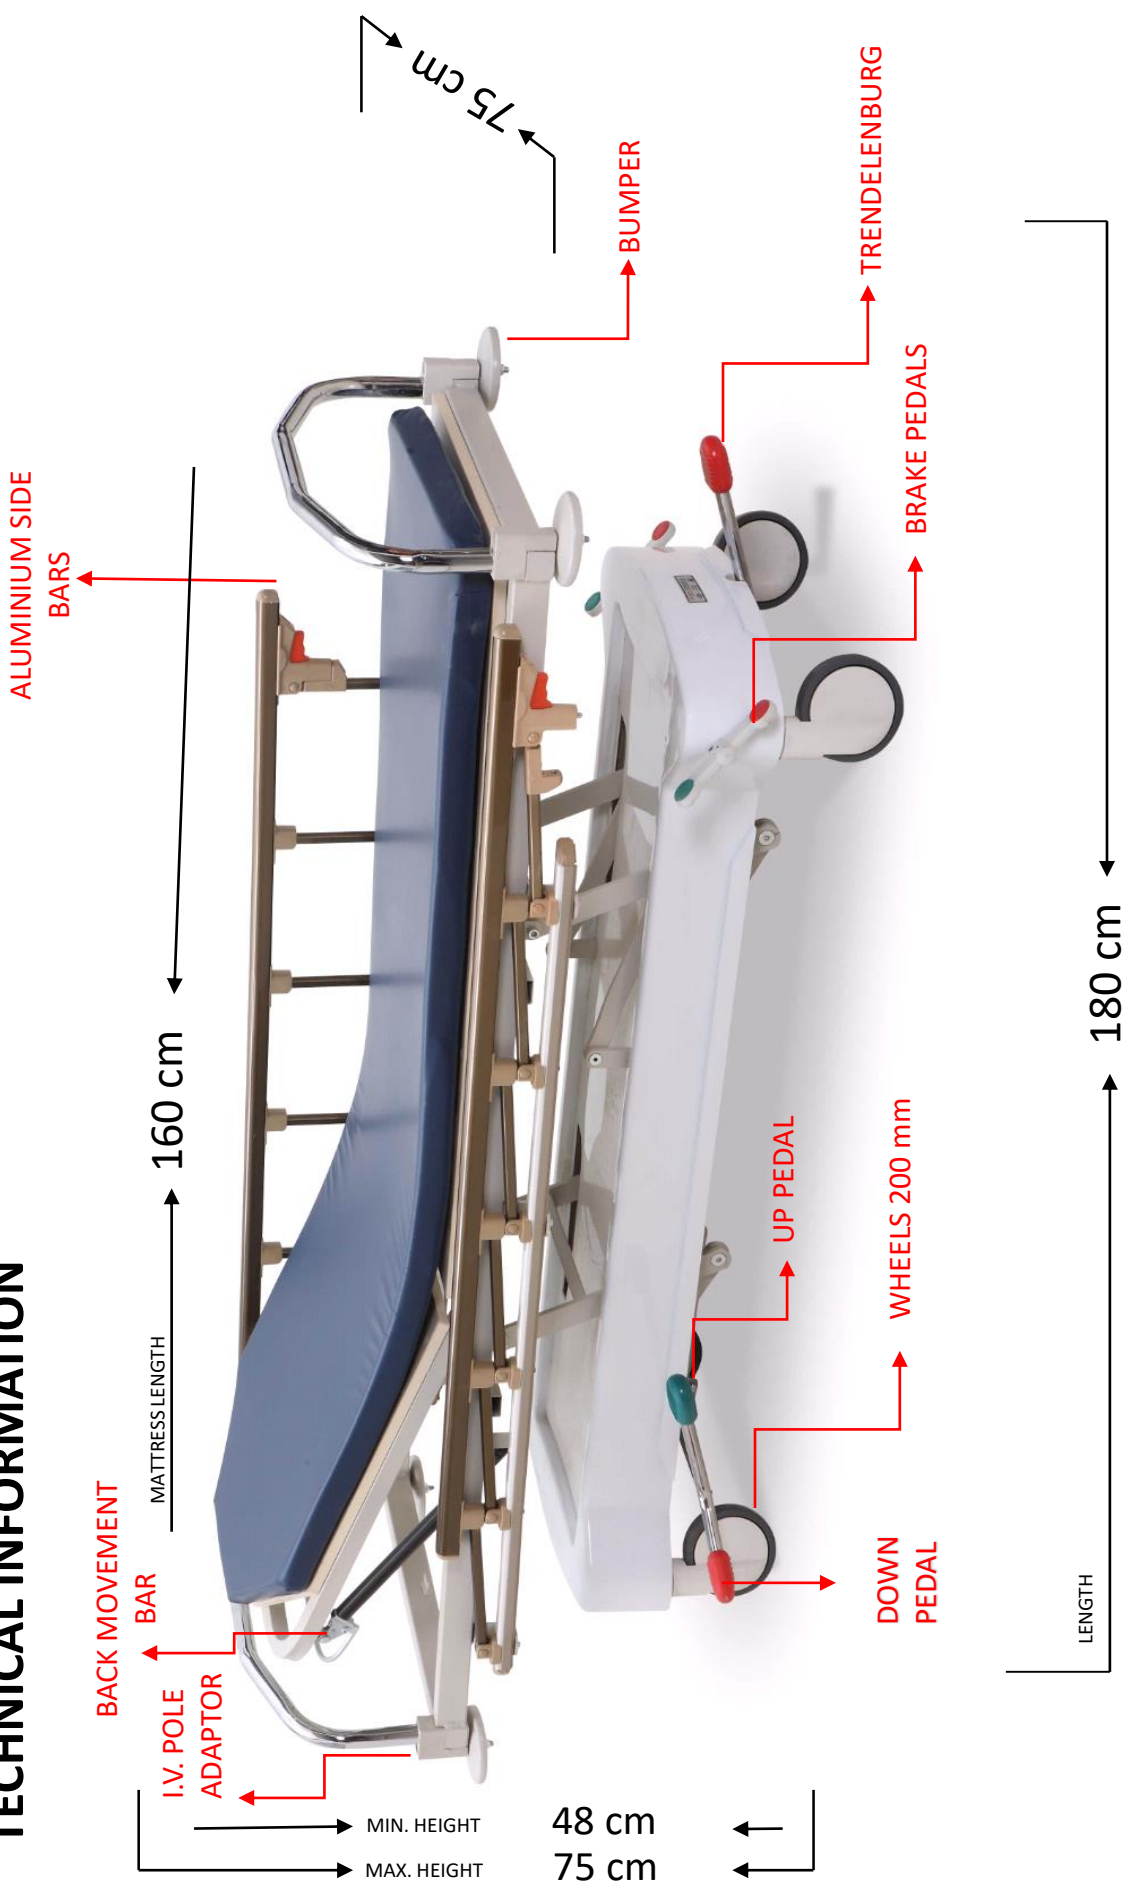

PATIENT MANAGEMENT SOLUTIONS

PEDIATRIC STRETCHER FOR TRANSFER AND EXAMINATION CASES.
ADVANCED MOBILITY, SAFETY AND EFFICIENCY.



BACK MOVEMENT

- Backrest adjustment by gas spring.




HEIGHT ADJUSTMENT

- Dual sided foot pedals for hi-lo



BUMPERS

- Bumpers on 4 corners of the stretcher.

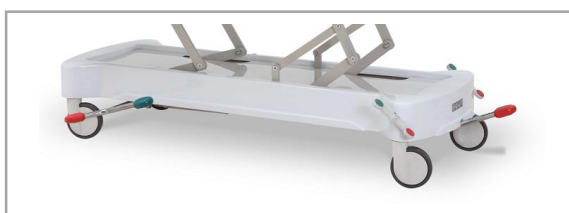

BRAKE SYSTEM

- 360° swivel wheels with central brake system and directional lock.

TRENDELENBURG

- Trendelenburg function by pedals on foot end chasis of the stretcher.
- 250 kg weight capacity





MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş.
Headquarters: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd N:137/1
Çelik Plaza Kat:4 Ataşehir – İstanbul
T:+902165746738 F:+902165746739
Manufacturing: Devekaldırımı Caddesi No :10 Bağcılar –
İstanbul - Turkey

www.meyosis.com