



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

04.06.2013

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 28.05.2013 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 28.05.2013
2. Decizie privind crearea întreprinderii din 28.05.2013
3. Statut
4. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 28.05.2013
5. Confirmare a achitării taxelor pentru înregistrare

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1013600018392** din 04.06.2013

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Sediul: MD-2009, str. Alecsandri Vasile, 77, ap.(of.) 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: BOJENCO GALINA, anul nașterii 23.01.1940, locul nașterii Iaroslavl, Rusia, CA
BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42021870 eliberat la data
de 24.11.1997, codul de identitate 0972111420151, domiciliu: MD-2028, str.
Academiei, 6/1, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
2. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism
3. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi
4. Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice
5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine
6. Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțăminții
7. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminții
8. Alte tipuri de comerț cu ridicata
9. Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare

Capitalul social: 5400 lei.


Fondator(i):

1. BOJENCO ALEXEI, anul nașterii 09.09.1970, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42039825 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU BOTANICA la data de 01.06.1998, codul de identitate 0961107543688, domiciliu: MD-2072, str. Cuza-Vodă bd., 25/2, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor datelor din
Registrul de stat al persoanelor juridice

27.06.2014

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 20.06.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 20.06.2014
2. Decizia asociației privind schimbarea administratorului din 19.06.2014
3. Ordin de încasare a platilor din 20.06.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice datele referitor la organul executiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1013600018392 din 04.06.2013 după cum urmează:

Administrator a schimba în

BOJENCO ANNA, anul nașterii 21.01.1984, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02011576 eliberat la data de 12.03.2014, codul de identitate 2000002129084, domiciliu: MD-2014, str. Miron Costin, 19/6, ap. 88, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 11573 din 11.06.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ALEX STANDARD».**

Denumirea prescurtată: **«ALEX STANDARD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013600018392.**

Data înregistrării de stat: **04.06.2013.**

Sediul: **MD-2009, str. Vasile Alecsandri, 77, ap.(of.) 2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**
- 2 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**
- 3 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 4 Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice;**
- 5 Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 6 Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;**
- 7 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte;**
- 8 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 9 Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BOJENCO ANNA,

Asociați:

- 1. BOJENCO ALEXEI 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 11.06.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207837



Frantuz Marina



EB 0366579



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Centru”

Republica Moldova, MD-2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373 22) 57-67-66
Fax: (373 22) 57-67-14

Data 04.05.2021
Nr. 01/03-02/18

Республика Молдова, MD-2012
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел.: (373 22) 57-67-66
Факс: (373 22) 57-67-14

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"Alex Standard" S.R.L.**, IDNO **1013600018392**, la data de **4 mai 2021 10:38** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD05ML000000022516091385	MDL
2	MD05ML000000022516091385	USD
3	MD05ML000000022516091385	EUR

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Centru



EEI

Ion Arhip

Ex.: Natalia Carvovschi-Rusu
Tel: 022576815
ID: 349360C5783

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0208657

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea Наименование	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEX STANDARD
Data înregistrării Дата регистрации	01.11.2013
Adresa juridică Юридический адрес	SEC.CENTRU Alecsandri Vasile nr.77 of.2
Codul fiscal Фискальный код	1013600018392
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0208657

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților

Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

51479

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ

ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din от	01.11.2013	pînă la до	30.11.2013
------------------	------------	----------------------	------------

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din от	01.12.2013	pînă la до	31.12.2013
------------------	------------	----------------------	------------

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII

ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către [MOLDOVATRANSGAZ](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21663099 din 04.08.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Manometre noi Alex Standard SRL(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.08.26 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Alex Standard SRL
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către MOLDOVATRANSGAZ

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Manometre, prin procedura de achiziție**, 21663099din 04.08.2026 pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 12.10.26 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.08.26 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Alex Standard SRL

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE

Către MOLDOVATRANS GAZ

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem garanției de bună execuție valabilă, privind Manometre prin procedura de achiziție licitație deschisă, 21663099din 04.08.2026 și suntem de acord cu reținerea garanției de bună execuție, aplicarea penalităților conform prevederile garanției bancare de bună execuție.

Data completării 19.06.26 Cu stimă,



Ofertant/candidat
Alex Standard SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Oficiu	buc		
2.	Depozit	buc		

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	cintare	Vitanta Effes	Contract unic 43 de la 16.02.22	16 000	
2	Termometre	Termoelectrica	Contract unic 479 de la 18.06.22	80 500	
	Sigilii	Red Nord	Contract unic	560 000	
	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,	dispozitivele or medicale, consumabile lor și pieselor de schimb	Contract unic	56340,00	
4	<i>Ustensile, consumabile și echipament</i>	Ansa	Contract unic	6720	
3	Achiziționarea instrumentelor de măsurat	Termoelectrica	Contract unic	140 000	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SR

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL este obligat sa instaleze și instruiască personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL



DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL declara Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 60% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate total mai mare de 2 ani și de cel puțin 80% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate total mai mic de 2 ani (inclusiv), dar nu mai mic de 12 luni

Declarație pe proprie răspundere

Prin prezenta declarație – confirmăm că produsele oferite de compania noastră corespund normelor și cerințelor tehnice solicitate în anunțul de achiziții nr , 21663099 din 04.08.2026 reprezintă produse fabricate la uzinele producătoare indicate în Specificațiile Tehnice.



DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL va prezenta mostrele în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, ambalate și etichetate . De asemenea garantam, ca toate componentele sunt noi (nefolosite)

Certificam că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2026

DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL declara ca produsele propuse in achizitia Manometre , prin procedura nr 21663099 din 04.08.2026 vor fi executate calitativ si livrate dupa semnarea contractului conform graficul stabilit.

Termen de garantie 24 luni din data livrării.

Garantarea perioadei de reactie jumătate de ora sau mai puțin la telefon si 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului in cazul aparitiei defectiunilor tehnice

Declarație

cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: Manometre, prin procedura de achiziție licitație deschisă , 216630
99din 04.08.2026

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la **art.16 alin.(2) lit.a)** din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 11.08.26

Operator economic Alex Standard SRL

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Bojenco Anna

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **MOLDOVATRANS GAZ**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Alex Sandard SRL

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 11.08.26

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Bojenco Anna, reprezentant împuternicit al SRL "Alex Standard", R.Moldova, mun. Chișinău, str. Alecsandri 77 of 2, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție nr 21663099 din 04.08.2026, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv
Bojenco Ana

IDNP al beneficiarului efectiv

2000002129084

Data completării: 11.08.26

Semnat: _____

Nume/prenume: Bojenco A

Funcția: director

Denumirea operatorului economic: SRL "Alex Standard

IDNO al operatorului economic: 1013600018392



Anexa nr. 5

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul Manometre

Numărul : № MTG –VM 37/26

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*	
1	Manometru RM 50- 18 NPT, (-1 – 18) bar, (oțel inoxidabil)	buc	22	conform CS	wika		Ger man ia	wika	Manometru cu tub Bourdon, execuție din oțel inoxidabil, model 131.11 Model: 131.11 Specificații tehnice conform fișei tehnice: PM 01.05 Carcasă: oțel inoxidabil Mecanism: oțel inoxidabil Sistem de măsurare: oțel inoxidabil Dimensiune nominală: 050 mm Tipul presiunii măsurate: presiune relativă (suprapresiune) Domeniu de măsurare: 0...20 bar Racord la proces: 1/4 NPT Poziția racordului: radială Geam: policarbonat Clasa de precizie: clasa 2,5 Tipul carcasei: carcasă cu dis Termen de livrare 2 luni
2	Manometru RM 50- 25 NPT, (-1 –25) bar, (oțel inoxidabil)	buc	16	conform CS	wika		Ger man ia	wika	Manometru cu tub Bourdon, execuție din oțel inoxidabil, model 131.11 Model: 131.11

									Specificații tehnice conform fișei tehnice: PM 01.05 Carcasă: oțel inoxidabil Mecanism: oțel inoxidabil Sistem de măsurare: oțel inoxidabil Dimensiune nominală: 050 mm Tipul presiunii măsurate: presiune relativă (suprapresiune) Domeniu de măsurare: 0...25 bar Racord la proces: 1/4 NPT Poziția racordului: radială Termen de livrare 2 luni
3	Manometru RM 50- 315 NPT, (-1 –315) bar, (oțel inoxidabil)	buc	42	conform CS	wika		Germania	wika	Manometru cu tub Bourdon, execuție din oțel inoxidabil, model 131.11 Model: 131.11 Specificații tehnice conform fișei tehnice: PM 01.05 Carcasă: oțel inoxidabil Mecanism: oțel inoxidabil Sistem de măsurare: oțel inoxidabil Dimensiune nominală: 050 mm Tipul presiunii măsurate: presiune relativă (suprapresiune) Domeniu de măsurare: 0...315 bar Racord la proces: 1/4 NPT Poziția racordului: radială Geam: policarbonat Clasa de precizie: clasa 2,5 Tipul carcasei: carcasă cu disc Termen de livrare 2 luni

4	Manometru RM 50- 5 NPT, (-1 – 5) bar, (oțel inoxidabil)	buc	20	conform CS	wika		Ger man ia	wika	Manometru cu tub Bourdon, execuție din oțel inoxidabil, model 131.11 Model: 131.11 Specificații tehnice conform fișei tehnice: PM 01.05 Carcasă: oțel inoxidabil Mecanism: oțel inoxidabil Sistem de măsurare: oțel inoxidabil Dimensiune nominală: 050 mm Tipul presiunii măsurate: presiune relativă (suprapresiune) Domeniu de măsurare: 0...6 bar Racord la proces: 1/4 NPT Poziția racordului: radială Geam: polycarbonat Clasa de precizie: clasa 2,5 Tipul carcasei: carcasă cu disc de siguranță pentru evacuarea presiunii în partea din spate Standardul manometrului: internațional (standard european) Logoul producătorului: WIKA Număr de serie pe cadran: număr de serie Termen de livrare 2 luni ...

5	Manometru MTPSd -100-OM2 (0-10 kgf/cm² clasa de precizie 1,5) M20×1.5	buc	26	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	Manometru МТП СД-100-OM2 10 кг/см² Diametru nominal: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...10 kgf/cm² Racord filetat: M20 × 1,5
6	Manometru TM-320P.00 (0-10 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63 mm G1/4	buc	9	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	Manometru ДМ 05063- 10 МПа - кл.2,5 - 01 Dimensiunea carcasei: 63 mm Domeniu de măsurare: 0...10 MPa Clasa de precizie: 2,5 Racord filetat: M12 × 1,5 Adaptor inclus: M12 × 1,5 / G 1/4 Livrare 2 saptamini cu verificare metrologica
7.	Manometru digital 0-700bar 80mm 1/4" Bsp Ip 65 Granit	buc	3	conform CS	Granit		Germania	Granit	Manometru digital 0-700bar 80mm 1/4" Bsp Ip 65 Granit Manometru digital, informatii tehnice: Filet BSP: 1/4" Domeniu de măsurare: 0-700 bar Domeniul de măsurare al indicatorului: bar, PSI, MPa, kg(f)/cm² Filet de conectare: filet exterior Tip conexiune: conexiune inferioară Conexiune-intrare: 1/4" BSP Versiune: digitală Diametru: 80 mm Interval de presiune: 0 -1000 bar Protectie la suprasarcina: 150% Precizia indicației: 0,4% FS Stabilitate pe termen lung: 0,4% FS/an

									Tensiune de intrare: 3V (două baterii AAA de 1,5V) Temperatura de functionare: -20°C +70°C Material carcasa: otel inoxidabil (304) Clasa de protectie: IP65 Producator: granit Certificat CE
8.	Manometru TM-320P.00 (0-25 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63mm G1/4	buc	2	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05063- 25 МПа - кл.2,5 - 01 Dimensiunea carcasei: 63 mm Domeniu de măsurare: 0...25 MPa Clasa de precizie: 2,5 Racord filetat: M12 × 1,5 Adaptor inclus: M12 × 1,5 / G ¼ Livrare 30 zile Metrologia RM
9.	Manometru TM-320P.00 (0-1 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63mm G1/4	buc	6	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05063- 1 МПа - кл.2,5 - 01 G1/4 Dimensiunea carcasei: 63 mm Domeniu de măsurare: 0...1 MPa Clasa de precizie: 2,5 Racord filetat: G 1/4 Livrare 30 zile Metrologia RM
10.	Manometru ДМ 05100 (0-10 MPa) clasa de precizie 1,5 D=100mm M20x1,5	buc	4	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05100- 10 МПа - кл.1,5 - 01 M Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...10 MPa Clasa de precizie: 1,5 Racord filetat: M20 × 1,5 Livrare 30 zile Metrologia RM
11.	Manometru tehnic (0 - 16 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G 1/2 axial	buc	18	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05100- 1,6 МПа - кл.1,6 - 01 M (O) G1/2

									Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...1,6 MPa Clasa de precizie: 1,6 Racord filetat: G 1/2 Poziția racordului: axială Livrare 30 zile Metrologia RM
12.	Manometru tehnic (0-16bar) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm G ½	buc	13	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05-МП-3У- 1,6 МПа - кл.1,6 - 01 G1/2 Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniul de măsurare: 0...1,6 MPa Clasa de precizie: 1,6 Racord filetat: G 1/2 Livrare 30 zile Metrologia RM
13	Manometru tehnic (0 - 100 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½	buc	40	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05100- 10 МПа - кл.1,5 - 01 М Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...10 MPa Clasa de precizie: 1,5 Racord filetat: M20 × 1,5 Adaptor inclus: M20 × 1,5 / G 1/2 Livrare 30 zile Metrologia RM
14	Manometru tehnic (0 - 2,5 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½	buc	10	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05100- 250 кПа - кл.1,6 - 01 М Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...250 kPa Clasa de precizie: 1,6 Racord filetat: M20 × 1,5 Adaptor inclus: M20 × 1,5 / G 1/2 Livrare 30 zile Metrologia RM
15	Manometru tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½	buc	16	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДН 05100- 10 кПа - кл.1,6 - 02 М Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...10 kPa

									Clasa de precizie: 1,6 Racord filetat: M20 × 1,5 Adaptor inclus: M20 × 1,5 / G 1/2 Livrare 30 zile Metrologia RM
16	Manometru tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½ axial	buc	3	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...10 kPa Clasa de precizie: 1,6 Racord filetat: M20 × 1,5 Adaptor inclus: M20 × 1,5 / G 1/2 Poziția racordului: radială Livrare 30 zile Metrologia RM
17	Manometru (0 - 10 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm M14×1,5	buc	11	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05-МП-3У- 1 МПа - кл.1,6 - 01 Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...1 MPa Clasa de precizie: 1,6 Racord filetat: M20 × 1,5 Adaptor inclus: M20 × 1,5 / M12 × 1,5 Livrare 30 zile Metrologia RM
	Manometru tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 50mm M14×1,5	buc	8	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДН 05063- 10 кПа - кл.2,5 - 02 Dimensiunea carcasei: 63 mm Domeniu de măsurare: 0...10 kPa Clasa de precizie: 2,5 Racord filetat: M12 × 1,5 Livrare 30 zile Metrologia RM
19	Manometru tehnic (0 – 10 kgf/cm²) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm M20×1,5	buc	10	conform CS	Steclopribor		Ucraina	Steclopribor	ДМ 05-МП-3У- 1 МПа - кл.1,6 - 01 Dimensiunea carcasei: 100 mm Domeniu de măsurare: 0...1 MPa Clasa de precizie: 1,6 Racord filetat: M20 × 1,5 Livrare 30 zile Metrologia RM

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicile tehnice a bunurilor propuse.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: ____ Bojenco A

În calitate de: _____

Ofertantul: Alex Standard SRL

Adresa: Lupu 16

Data 11.08.26

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația de preț:

Obiectul Manometre

Numărul : № MTG –VM 37/26

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar, lei fără TVA	Preț unitar, lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manometru RM 50- 18 NPT, (-1 – 18) bar, (oțel inoxidabil)	buc	22	3500	4200	77 000	92 400
2	Manometru RM 50- 25 NPT, (-1 –25) bar, (oțel inoxidabil)	buc	16	3500	4200	56 000	67 200
3	Manometru RM 50- 315 NPT, (-1 –315) bar, (oțel inoxidabil)	buc	42	3800	4560	159 600	191 520
4	Manometru RM 50- 5 NPT, (-1 – 5) bar, (oțel inoxidabil)	buc	20	3500	4200	70 000	84 000
5	Manometru MTPSd -100-OM2 (0-10 kgf/cm ² clasa de precizie 1,5) M20×1,5	buc	26	650	780	16 900	20 280
6	Manometru TM-320P.00 (0-10 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63 mm G1/4	buc	9	190	228	1710	2052
7	Manometru digital 0-700bar 80mm 1/4" Bsp Ip 65 Granit	buc	3	10700	12840	29 100	38 520
8	Manometru TM-320P.00 (0-25 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63mm G1/4	buc	2	180	216	360	432
9	Manometru TM-320P.00 (0-1 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63mm G1/4	buc	6	190	228	760	1368
10	Manometru ДМ 05100 (0-10 MPa) clasa de precizie 1,5 D=100mm M20x1,5	buc	4	250	300	1000	1200
11	Manometru tehnic (0 - 16 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G 1/2 axial	buc	18	250	300	4500	5400
12	Manometru tehnic (0-16bar) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm G ½	buc	13	190	228	2470	2964
13	Manometru tehnic (0 - 100 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½	buc	40	350	420	14 000	16 800
14	Manometru tehnic (0 - 2,5 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½	buc	10	350	420	3500	4200
15	Manometru tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½	buc	16	1100	1320	16 600	21 120
16	Manometru tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½ axial	buc	3	350	420	1050	1260
17	Manometru (0 - 10 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm M14×1,5	buc	11	180	216	1980	2376
18	Manometru tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 50mm M14×1,5	buc	8	450	540	3600	4320
19	Manometru tehnic (0 – 10 kgf/cm ²) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm M20×1,5	buc	10	190	228	1900	2280
Valoarea totală (lei):						466 530	559 836

*

Numele, Prenumele: ___Bojenco A

În calitate de: _____

Ofertantul: Alex Standard SRL

Adresa:Lupu 16



MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor
de responsabilitate extinsă a producătorului (ambalaje)

În scopul plasării pe piață a ambalajelor/produselor ambalate, în conformitate
cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. e) din Legea nr. 209 din 29.07.2016
privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020,
se emite numărul de înregistrare

MD2024-6-A-1309

pentru ALEX STANDARD SRL, IDNO: 1013600018392, cu adresa juridică
mun. Chișinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 77, ap.(of.) 2.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 21.06.2024 până la
data de 21.06.2029.

Director adjunct

Radu STRATUTA

Digitally signed by Stratuța Radu
Date: 2024.06.21 19:58:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

0830392

Din
От

16.06.2026 08:30



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1013600018392

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

01.07.2026 08:30



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 16.06.2026 08:30

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)



INSTITUTUL NAȚIONAL DE METROLOGIE

CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL

Nr. 1067

Data 10.07.2024

Valabil până la „10” iulie 2034

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016, la recomandarea Consiliului Tehnico-Științific din cadrul Institutului Național de Metrologie, prin hotărârea Institutului Național de Metrologie Nr. 11, punctul 4 din „10” iulie 2024 se eliberează prezentul certificat de aprobare de model ce denotă că mijlocul de măsurare aprobat poate fi utilizat în Republica Moldova în domeniile de interes public

**MANOMETRE tip: ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05,
ДН 05, ДТ 05, ДГ 05**

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

producător

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», Ucraina,

(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

cu nr. **I-1025:2024** din „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare” (partea I).

Pentru modelul aprobat se stabilește obligatoriu verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare - **12 luni**.

Acest certificat atestă conformitatea modelelor cu cerințele prevăzute în:

NML 04-02:2022.

(reglementarea de metrologie legală)

Conformitatea a fost stabilită prin încercările metrologice în scopul aprobării de model descrise în raportul parte componentă a dosarului nr. 1065, care cuprinde 73 file.

Pe fiecare mijloc de măsurare livrat se va aplica, prin grija solicitantului, marcajul aprobării de model, care atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

DIRECTOR INTERIMAR

Digitally signed by Bordianu Constantin
Date: 2024.07.11 08:33:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONSTANTIN BORDIANU

Bourdon tube pressure gauge, stainless steel

Compact version, NS 40 [1 ½"], 50 [2"] and 63 [2 ½"]

Model 131.11

WIKA data sheet PM 01.05



For further approvals,
see page 5

Applications

- For gaseous and liquid aggressive media that are not highly viscous or crystallising, also in aggressive environments
- Machine building and general plant construction
- Indication of failure alarm on gas cylinders
- CDA (Clean Dry Air) applications

Special features

- Case and wetted parts from stainless steel
- Version per EN 837-1 or ASME B40.100
- Cost-effective and reliable
- Scale ranges from 0 ... 1 to 0 ... 1,000 bar [0 ... 15 to 0 ... 15,000 psi]



Bourdon tube pressure gauge model 131.11.050 with dual scale bar/psi

Configurator



Standard articles



Description

The compact model 131.11 Bourdon tube pressure gauge is constructed with a case and wetted parts from stainless steel.

The modular design enables a multitude of combinations of process connections, nominal sizes and scale ranges. Due to this high variance, the instrument is suitable for use in a wide range of applications within industry.

The instrument is frequently used as a failure alarm indicator on gas cylinders. With its compact design and moderate purchase costs, the pressure gauge also qualifies for machine-building and plant-construction applications.

Due to the use of high-quality stainless steel materials and its robust design, the instrument is suitable for liquid and gaseous media, also in aggressive environments.

For mounting in control panels, the pressure gauges can be fitted with a surface mounting flange or with a triangular profile ring and mounting bracket.

Specifications

Basic information		
Standard	EN 837-1 ASME B40.100	
	→ For information on the “Selection, installation, handling and operation of pressure gauges”, see technical information IN 00.05.	
Special design feature	Oil- and grease-free For oxygen, oil- and grease-free ¹⁾ Silicone-free Version for ammonia plants With temperature scale for refrigerant R 717 (NH3) in °C Scale range: -1 ... 0 ... 15 bar or -1 ... 0 ... 26 bar	
Nominal size (NS)	Ø 40 mm [1 ½"] Ø 50 mm [2"] Ø 63 mm [2 ½"]	
Connection location	Lower mount (radial) Centre back mount	
Window	Polycarbonate, snap-fitted in case Laminated safety glass ²⁾ Instrument glass ²⁾	
Case		
Design	Lower mount (radial)	Safety level “S1” per EN 837-1: With blow-out device at case circumference, 6 o'clock
	Centre back mount	Safety level “S0” per EN 837-1 Safety level “S1” per EN 837-1: With blow-out device in case back
Material	Stainless steel	
Ring	Without Slip-on bezel, stainless steel Slip-on bezel, stainless steel, polished	
Mounting	Without Panel mounting flange, polished stainless steel ³⁾ Triangular profile ring with mounting bracket, polished stainless steel ³⁾ Surface mounting flange, stainless steel ⁴⁾	
Movement	Stainless steel	

1) Not available for NS 63 [2 ½"]

2) Only available with slip-on bezel

3) Only available with centre back mount

4) Only available for NS 63 [2 ½"]

Measuring element	
Type of measuring element	Bourdon tube, C-type or helical type
Material	Stainless steel 1.4404 (316L)
Leak tightness	Helium tested, leakage rate: < 5 · 10 ⁻³ mbar l/s

Accuracy specifications	
Accuracy class	
■ EN 837-1	■ Class 2.5 ■ Class 1.6
	■ ±3 % of measuring span (grade B) ■ ±2 % of measuring span (grade A)
■ ASME B40.100	
Temperature error	On deviation from the reference conditions at the measuring system: ≤ ±0.4 % per 10 °C [≤ ±0.4 % per 18 °F] of full scale value
Reference conditions	
Ambient temperature	+20 °C [68 °F]

Scale ranges, gauge pressure

bar	
0 ... 1	0 ... 40
0 ... 1.6	0 ... 60
0 ... 2	0 ... 70
0 ... 2.5	0 ... 100
0 ... 4	0 ... 140
0 ... 6	0 ... 160
0 ... 7	0 ... 200
0 ... 10	0 ... 250
0 ... 14	0 ... 315
0 ... 16	0 ... 400
0 ... 20	0 ... 600
0 ... 25	0 ... 700 ¹⁾
0 ... 30	0 ... 1,000 ¹⁾

kPa	
0 ... 100	0 ... 4,000
0 ... 160	0 ... 6,000
0 ... 200	0 ... 7,000
0 ... 250	0 ... 8,000
0 ... 300	0 ... 10,000
0 ... 400	0 ... 14,000
0 ... 600	0 ... 16,000
0 ... 700	0 ... 20,000
0 ... 800	0 ... 25,000
0 ... 1,000	0 ... 40,000
0 ... 1,400	0 ... 60,000
0 ... 1,600	0 ... 70,000 ¹⁾
0 ... 2,500	0 ... 80,000 ¹⁾
0 ... 3,000	0 ... 100,000 ¹⁾

1) Only available for NS 63 [2 ½"]

psi	
0 ... 15	0 ... 800
0 ... 30	0 ... 1,000
0 ... 60	0 ... 1,500
0 ... 100	0 ... 2,000
0 ... 150	0 ... 3,000
0 ... 160	0 ... 4,000
0 ... 200	0 ... 5,000
0 ... 250	0 ... 6,000
0 ... 300	0 ... 7,500
0 ... 400	0 ... 10,000 ¹⁾
0 ... 500	0 ... 15,000 ¹⁾
0 ... 600	-

MPa	
0 ... 0.1	0 ... 4
0 ... 0.16	0 ... 6
0 ... 0.20	0 ... 7
0 ... 0.25	0 ... 10
0 ... 0.4	0 ... 14
0 ... 0.6	0 ... 16
0 ... 0.7	0 ... 20
0 ... 1.0	0 ... 25
0 ... 1.4	0 ... 31.5
0 ... 1.6	0 ... 40
0 ... 2	0 ... 60
0 ... 2.5	0 ... 70 ¹⁾
0 ... 3	0 ... 100 ¹⁾

Vacuum and compound scale ranges

bar	
-1 ... 0	-1 ... +7
-1 ... +0.6	-1 ... +9
-1 ... +1	-1 ... +10
-1 ... +1.5	-1 ... +15
-1 ... +3	-1 ... +25
-1 ... +5	-1 ... +30

kPa	
-100 ... 0	-100 ... +700
-100 ... +60	-100 ... +900
-100 ... +100	-100 ... +1,000
-100 ... +150	-100 ... +1,500
-100 ... +200	-100 ... +2,400
-100 ... +500	-100 ... +3,000

psi	
-30 inHg ... 0	-30 inHg ... +100
-30 inHg ... +15	-30 inHg ... +160
-30 inHg ... +30	-30 inHg ... +200
-30 inHg ... +60	-30 inHg ... +300

MPa	
-0.1 ... 0	-0.1 ... +0.5
-0.1 ... +0.06	-0.1 ... +0.7
-0.1 ... +0.1	-0.1 ... +0.9
-0.1 ... +0.15	-0.1 ... +1
-0.1 ... +0.2	-0.1 ... +1.5
-0.1 ... +0.3	-0.1 ... +2.4
-0.1 ... +0.4	-0.1 ... +3

Further details on: Scale ranges	
Unit	■ bar ■ psi ■ kPa ■ MPa ■ kg/cm²
Vacuum resistance	■ Without ■ Vacuum-resistant to -1 bar
Dial	
Scale colour	Black
Material	Aluminium
Customer-specific version	■ Without ■ With temperature scale for refrigerant, e.g. for NH₃: R 717 Other scales or customer-specific dials, e.g. with red mark, circular arcs or circular sectors, on request → Alternatively, adhesive label set for red and green circular arcs; see data sheet AC 08.03
Pointer	Aluminium, black
Pointer stop pin	■ Without ■ At zero point ■ At 6 o'clock

→ Other scale ranges on request

Process connection	
Standard	■ EN 837-1 ■ ISO 7 ■ ANSI/B1.20.1
Size	
EN 837-1	■ G ¼ B, male thread ■ G ½ B, male thread ■ M14 x 1.5, male thread
ANSI/B1.20.1	■ ¼ NPT, male thread ■ ½ NPT, male thread
ISO 7	■ R ¼, male thread ■ R ½, male thread
Restrictor	■ Without ■ Ø 0.6 mm [0.024"], stainless steel ■ Ø 0.3 mm [0.012"], stainless steel
Material (wetted)	
Process connection	■ Stainless steel 1.4571 (316Ti) ■ Stainless steel 1.4404 (316L)
Bourdon tube	Stainless steel 1.4404 (316L)

→ Other process connections on request

Operating conditions	
Medium temperature	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]
Ambient temperature	-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Pressure limitation	
Steady	3/4 x full scale value
Fluctuating	2/3 x full scale value
Short time	Full scale value
Ingress protection per IEC/EN 60529	■ IP54 ■ IP65 ¹⁾

1) Only selectable for scale ranges from 0 ... 16 bar [0 ... 250 psi] and centre back mount

Approvals

Logo	Description	Region
	EU declaration of conformity Pressure equipment directive PS > 200 bar, module A, pressure accessory	European Union
-	CRN Safety (e.g. electr. safety, overpressure, ...) For scale ranges ≤ 1,000 bar	Canada

Optional approvals

Logo	Description	Region
 	EU declaration of conformity ATEX directive Hazardous areas - Ex h Gas II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X Dust II 2D Ex h IIC T85°C ... T100°C Db X	European Union
	PAC Kazakhstan Metrology, measurement technology	Kazakhstan
-	MChS Permission for commissioning	Kazakhstan
	PAC Ukraine Metrology, measurement technology	Ukraine
	PAC Uzbekistan Metrology, measurement technology	Uzbekistan
-	PAC China Metrology, measurement technology	China
-	KBA ²⁾ Automotive Components for motor vehicles using natural gas (CNG/LNG) – UN no. R 110	International

1) Not available for NS 63 [2 ½"]

2) Not available for all versions

Manufacturer's declaration

Logo	Description
-	Pressure equipment directive (PED) for maximum allowable pressure PS ≤ 200 bar
-	Suitability of wetted materials for drinking water in accordance with the European 4MS initiative


Certificates (option)

Certificates	
Certificates	■ 2.2 test report per EN 10204 (e.g. state-of-the-art manufacturing, indication accuracy) ■ 3.1 inspection certificate per EN 10204 (e.g. indication accuracy)
Recommended calibration interval	1 year (dependent on conditions of use)

→ For approvals and certificates, see website

Dimensions in mm [in]

Model 131.11, lower mount (radial)

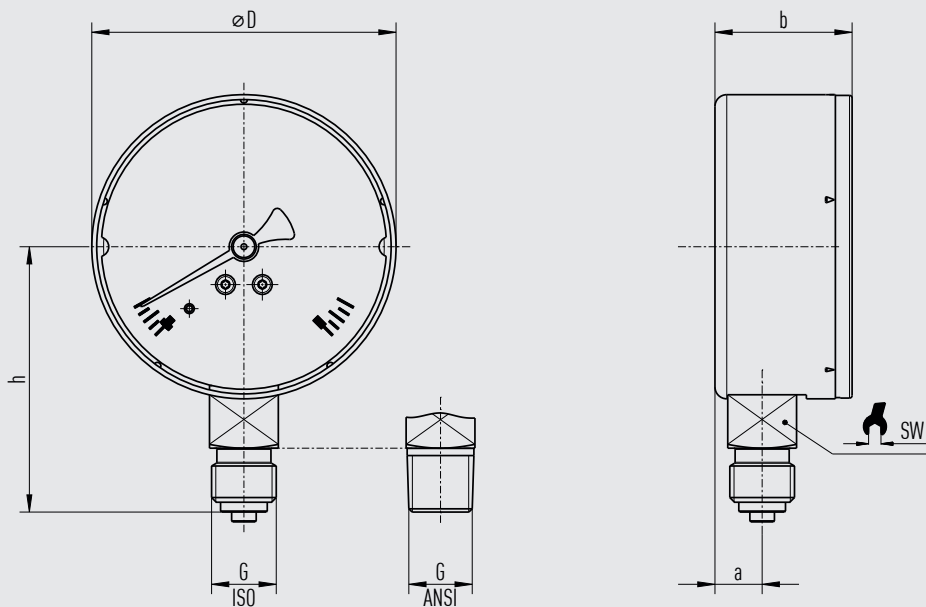


2184087.02

NS	G ¹⁾	Dimensions in mm [in]					Weight in kg [lb]
		D	h ±1 [0.04]	a	b ±1 [0.04]	SW	
40 [1.5"]	G ½ B, ½ NPT	39 [1.54]	36 [1.42]	9 [0.35]	25 [0.98]	14 [0.55]	0.05 [0.11]
	G ¼ B, ¼ NPT	39 [1.54]	39 [1.54]	9 [0.35]	25 [0.98]	14 [0.55]	0.05 [0.11]
50 [2"]	G ½ B, ½ NPT	49 [1.93]	44 [1.73]	9 [0.35]	29 [1.41]	14 [0.55]	0.09 [0.2]
	G ¼ B, ¼ NPT	49 [1.93]	47 [1.85]	9 [0.35]	29 [1.41]	14 [0.55]	0.09 [0.2]
63 [2 ½"]	G ½ B, ½ NPT	62 [2.44]	51 [2.01]	10 [0.39]	28 [1.1]	14 [0.55]	0.12 [0.26]
	G ¼ B, ¼ NPT	62 [2.44]	54 [2.13]	10 [0.39]	28 [1.1]	14 [0.55]	0.12 [0.26]

1) The G ½ B process connection of this instrument is manufactured without a centring spigot and with a thread runout instead of a thread undercut.

Model 131.11, centre back mount

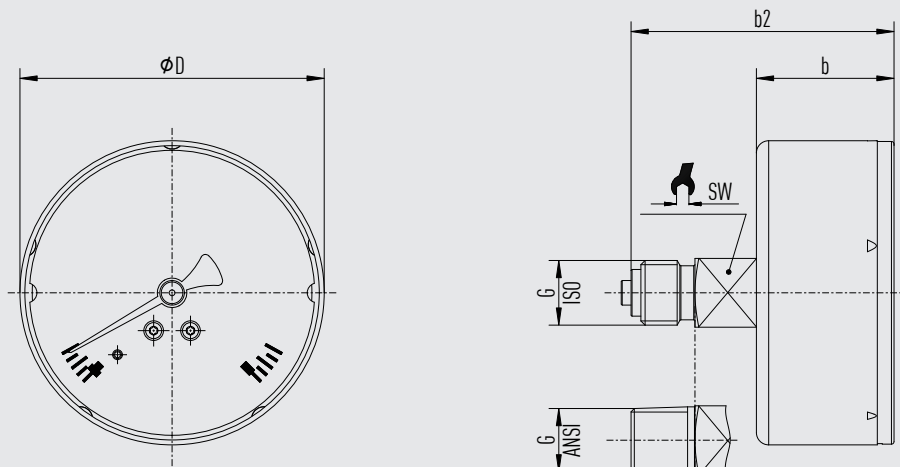

2184109.02

NS	G ¹⁾	Dimensions in mm [in]				Weight in kg [lb]
		D	b2	b ±1 [0.04]	SW	
40 [1.5"]	G ½ B, ½ NPT	39 [1.54]	52.5 [2.07]	27.5 [1.09]	14 [0.55]	0.05 [0.11]
	G ¼ B, ¼ NPT	39 [1.54]	52.5 [2.07]	27.5 [1.09]	14 [0.55]	0.05 [0.11]
50 [2"]	G ½ B, ½ NPT	49 [1.93]	53.5 [2.11]	29 [1.14]	14 [0.55]	0.09 [0.2]
	G ¼ B, ¼ NPT	49 [1.93]	53.5 [2.11]	29 [1.14]	14 [0.55]	0.09 [0.2]
63 [2 ½"]	G ½ B, ½ NPT	62 [2.44]	53.5 [2.11]	28 [1.1]	14 [0.55]	0.12 [0.26]
	G ¼ B, ¼ NPT	62 [2.44]	53.5 [2.11]	28 [1.1]	14 [0.55]	0.12 [0.26]

1) The G ½ B process connection of this instrument is manufactured without a centring spigot and with a thread runout instead of a thread undercut.

Ordering information

Model / Nominal size / Connection location / Scale range /
Process connection / Options



© 02/2009 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, all rights reserved.
The specifications given in this document represent the state of engineering at the time of publishing.
We reserve the right to make modifications to the specifications and materials.
In case of a different interpretation of the translated and the English data sheet, the English wording shall prevail.



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de

Manometru digital 0-700bar 80mm 1/4" Bsp Ip 65 Granit

Manometrul digital 0-700 bar 80mm este un dispozitiv precis pentru măsurarea presiunii. Acesta este un manometru digital inteligent care este perfect pentru calibrarea echipamentelor hidraulice, măsurarea presiunii gazului, lichidului, uleiului etc. Acest manometru are un afișaj iluminat din spate care permite citirea ușoară a măsurătorilor. Acest manometru se distinge prin precizia sa ridicată de măsurare. Poate fi folosit în diverse domenii, precum agricultură, pomicultură, silvicultură, construcții și industrie în general.

Manometru digital, informatii tehnice:

- Filet BSP: 1/4"
- Domeniu de măsurare: 0-700 bar
- Domeniul de măsurare al indicatorului: bar, PSI, MPa, kg(f)/cm²
- Filet de conectare: filet exterior
- Tip conexiune: conexiune inferioară
- Conexiune-intrare: 1/4" BSP
- Versiune: digitală
- Diametru: 80 mm
- Interval de presiune: 0 -1000 bar
- Protecție la suprasarcină: 150%
- Precizia indicației: 0,4% FS
- Stabilitate pe termen lung: 0,4% FS/an
- Tensiune de intrare: 3V (două baterii AAA de 1,5V)
- Temperatura de funcționare: -20°C +70°C
- Material carcasa: oțel inoxidabil (304)
- Clasa de protecție: IP65
- Producător: granit

Manometru digital, functii:

Pornire/oprire: apăsați comutatorul mai mult de 3 secunde pentru a porni sau opri.

Unitate: apăsați scurt comutatorul pentru a comuta afișajul (bar, PSI, MPa, Kg/cm²).

Punerea la zero: apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a reseta afișajul la zero.

Iluminare de fundal: apăsați scurt comutatorul pentru a porni iluminarea de fundal a afișajului, care se stinge automat după 70 de secunde.





ЧА.ТН.113

(знак соответствия и дополнительная метрологическая маркировка)



Сертификат проверки типа
№ ЧА.ТН.113-0127-18 версия 3
от 27.08.2025 г.

ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»

Манометры ДМ 05, Вакуумметры ДВ 05, Мановакуумметры ДА 05

Паспорт АКТ 05.890.003 ПС

Манометры ДМ 05, вакуумметры ДВ 05, мановакуумметры ДА 05 (далее - приборы) предназначены для измерения избыточно и вакуумметричного давлений: жидкости, газа и пара в разных отраслях промышленности, в том числе при проведении работ по: обеспечению здравоохранения, контроля состояния окружающей природной среды и безопасности условий труда, а также при проведении геодезических и гидрометеорологических работ.

Приборы выпускаются по техническим условиям ТУ У 33.2-14307481-031.2005 и ДСТУ EN 837-1.

Производитель: ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР», 37240, ул. Озерная, 18, г. Заволжье, Полтавская область, Украина. Тел./факс (05356) 3-71-00, 3-71-11; (044) 330-03-09. E-mail: sales@stekloribor.com, www.stekloribor.com.

Основные технические данные и характеристики

Наименование и условное обозначение: Манометры ДМ 05; Вакуумметры ДВ 05; Мановакуумметры ДА 05

Диапазоны показаний: 0-60; 0-100; 0-160; 0-200; 0-250; 0-400; 0-600 кПа.

0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250 МПа.

-100 - 0; -100 - 60; -60 - 100; -100 - 150; -100 - 300; -100 - 500 кПа.

-0,1 - 0,9; -0,1 - 1,5; -0,1 - 2,4; -0,1 - 4; -0,1 - 6 МПа.

Диапазоны показаний: 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2; 0-2,5; 0-4; 0-6 бар.

0-10; 0-16; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-400; 0-600 бар.

-1-0; -1-0,6; -0,6-1; -1-1,5; -1-3; -1-5; -1-9; -1-15; -1-24; -1-40; -1-60 бар.

Класс точности: 1,0; 1,6; 2,5.

Диаметр корпуса прибора, мм: 40; 50; 63; 100; 160; 250.

Расположение штуцера: - осевое, радиальное.

Присоединительная резьба для приборов:

диаметром 40; 50; 63 - M12x1,5; G1/4;

диаметром 100; 160 - M20x1,5; G1/2;

диаметром 250 - M20x1,5.

Материал штуцера: - латунь, сталь нержавеющей; сталь углеродистая.

Материал механизма: - латунь, сталь нержавеющей; сталь углеродистая.

Материал рабочей камеры: - латунь, сталь нержавеющей; сплав алюминия-устойчивый.

Материал корпуса: - сталь черная, сталь нержавеющей.

Степень защиты по ГОСТ 14254: IP 40, IP 53, IP 54, IP 65.

Рабочая температура: минус 40...+150 °C

Масса, кг: от 0,12 до 3,5.

Средняя наработка на отказ: 100000 часов.

Комплект поставки содержит:

- прибор - 1 шт. (модификация, исполнение и типоразмер в соответствии с заказом);

- паспорт - 1 экз.;

- руководство по эксплуатации - 1 экз. на 10 шт.;

- индивидуальная упаковка.

Требования безопасности

Не допускается эксплуатация приборов в системах, давление в которых может превышать верхние пределы измерений этих приборов.

Приборы должны быть надежно закреплены при монтаже на объекте.

Монтаж приборов должен осуществляться только влиянием на штуцер.

Категорически запрещается при установке приборов приспосабливать механические усилия к корпусу прибора.

Замена, присоединение и отсоединение приборов от объекта должны проводиться при отсутствии давления в магистралах.

Указания по эксплуатации, транспортированию и хранению

Монтаж и эксплуатация приборов должны проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации. Эксплуатация приборов проводится при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +70 °C и относительной влажности 80% при 15 °C.

Приборы в транспортной упаковке транспортируются всеми видами автомобильного и железнодорожного транспорта, а также почтовыми посылками (с массой груза до 10 кг).

Способ укладки ящиков на транспортном средстве должен исключать возможность их перемещения.

Хранение приборов в транспортной таре осуществляется в неотапливаемых хранилищах при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности - 75% при 15 °C, а в потребительской таре - в отапливаемых хранилищах при температуре воздуха от 5 до 40 °C и относительной влажности - 60% при 20 °C.

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие приборов ТУ У 33.2-14307481-031.2005 и ДСТУ EN 837-1 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с даты продажи.

Сведения о приемке

Партия № _____

Прибор зав. № _____ соответствует ТУ 33.2-14307481-031.2005 и ДСТУ EN 837-1 и признан годным к эксплуатации.

Межповерочный интервал приборов, находящихся в эксплуатации - 1 год, согласно Приказу Минэкономразвития от 13.10.2016г. №1747.

Отчет срока проводится от года, указанного в дополнительной метрологической маркировке.

Дата выпуска _____ место для штампа

Отметки о периодических поверках

мес., год.

место для штампа

Дата

Результат поверки

Дата следующей поверки

Подпись поверителя и оттиск клейма

Подпись поверителя и оттиск клейма

Подпись поверителя и оттиск клейма

Подпись поверителя и оттиск клейма

Подпись поверителя и оттиск клейма



UA.TR.113

(знак відповідності та додаткове
метрологічне маркування)Сертифікат перевірки типу
№ UA.TR.113-0127-18 версія 4
від 01.05.2026 р**ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»****Манометри ДМ 05, Вакуумметри ДВ 05, Мановакуумметри ДА 05**

Паспорт АКГ 05.890.003 ПС

Манометри ДМ 05, вакуумметри ДВ 05, мановакуумметри ДА 05 (далі по тексту - прилади) призначені для вимірювання надлишкового і вакуумметричного тиску: рідин, газів і пари в різних галузях промисловості, в тому числі при проведенні робіт щодо: забезпечення охорони здоров'я, контролю стану навколишнього природного середовища та безпеки умов праці, а також при проведенні геодезичних і гідрометеорологічних робіт.

Прилади випускаються під замовлення за технічними умовами ТУ У 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-1.

Виробник: ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», 37240, вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, Україна. Тел./факс (05356) 3-71-00, 3-71-11; (044) 330-03-09.

E-mail: sales@steklopribor.com, www.steklopribor.com.

Основні технічні дані і характеристики

Найменування та умовне позначення: Манометри ДМ 05; Вакуумметри ДВ 05;
Мановакуумметри ДА 05

Діапазони показів (вимірювань): 0-60; 0-100; 0-160; 0-200; 0-250; 0-400; 0-600 kPa.
0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250 МПа.
-100 - 0; -100 - 60; -60 - 100; -100 - 150; -100 - 300; -100 - 500 kPa.
-0,1- 0,9; -0,1- 1,5; -0,1- 2,4; -0,1- 4; -0,1- 6 МПа.

Діапазони показів (вимірювань): 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2; 0-2,5; 0-4; 0-6 bar.
0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-400; 0-600 bar.
-1-0; -1-0,6; -0,6-1; -1-1,5; -1-3; -1-5; -1-9; -1-15; -1-24; -1-40; -1-60 bar.

Клас точності: 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5.

Діаметр корпусу приладу, mm: 40; 50; 63; 100; 160; 250.

Розташування штуцера: - осьове, радіальне.

Приєднувальна різьба для приладів:

діаметром 40; 50; 63 - M12x1,5; G1/4;

діаметром 100; 160 - M20x1,5; G1/2;

діаметром 250 - M20x1,5.

Матеріал штуцера: - латунь, сталь нержавіюча; сталь вуглецева.

Матеріал механізму: - латунь, сталь нержавіюча; сталь вуглецева.

Матеріал робочої камери: - латунь, сталь нержавіюча; сплав ам'ячно-стійкий.

Матеріал корпусу: - сталь чорна, сталь нержавіюча.

Ступінь захисту за ДСТУ EN 60529:2014 (код IP) - IP40, IP53, IP54 та IP65 для приладів з гідрозаповненням.

Маса, kg: від 0,12 до 3,5.

Середнє напрацювання на відмову, h (год): 100000.

Комплект поставки:

- прилад - 1 шт. (модифікація, виконання і типорозмір відповідно до замовлення);
- паспорт - 1 прим.;
- настанова з експлуатації - 1 прим. на 10 шт.;
- індивідуальна упаковка.



UA.TR.113

(знак відповідності та додаткове
метрологічне маркування)Сертифікат перевірки типу
№ UA.TR.113-0127-18 версія 4
від 01.05.2026 р**ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»****Манометри ДМ 05, Вакуумметри ДВ 05, Мановакуумметри ДА 05**

Паспорт АКГ 05.890.003 ПС

Манометри ДМ 05, вакуумметри ДВ 05, мановакуумметри ДА 05 (далі по тексту - прилади) призначені для вимірювання надлишкового і вакуумметричного тиску: рідин, газів і пари в різних галузях промисловості, в тому числі при проведенні робіт щодо: забезпечення охорони здоров'я, контролю стану навколишнього природного середовища та безпеки умов праці, а також при проведенні геодезичних і гідрометеорологічних робіт.

Прилади випускаються під замовлення за технічними умовами ТУ У 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-1.

Виробник: ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», 37240, вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, Україна. Тел./факс (05356) 3-71-00, 3-71-11; (044) 330-03-09.

E-mail: sales@steklopribor.com, www.steklopribor.com.

Основні технічні дані і характеристики

Найменування та умовне позначення: Манометри ДМ 05; Вакуумметри ДВ 05;
Мановакуумметри ДА 05

Діапазони показів (вимірювань): 0-60; 0-100; 0-160; 0-200; 0-250; 0-400; 0-600 kPa.
0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250 МПа.
-100 - 0; -100 - 60; -60 - 100; -100 - 150; -100 - 300; -100 - 500 kPa.
-0,1- 0,9; -0,1- 1,5; -0,1- 2,4; -0,1- 4; -0,1- 6 МПа.

Діапазони показів (вимірювань): 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2; 0-2,5; 0-4; 0-6 bar.
0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-400; 0-600 bar.
-1-0; -1-0,6; -0,6-1; -1-1,5; -1-3; -1-5; -1-9; -1-15; -1-24; -1-40; -1-60 bar.

Клас точності: 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5.

Діаметр корпусу приладу, mm: 40; 50; 63; 100; 160; 250.

Розташування штуцера: - осьове, радіальне.

Приєднувальна різьба для приладів:

діаметром 40; 50; 63 - M12x1,5; G1/4;

діаметром 100; 160 - M20x1,5; G1/2;

діаметром 250 - M20x1,5.

Матеріал штуцера: - латунь, сталь нержавіюча; сталь вуглецева.

Матеріал механізму: - латунь, сталь нержавіюча; сталь вуглецева.

Матеріал робочої камери: - латунь, сталь нержавіюча; сплав ам'ячно-стійкий.

Матеріал корпусу: - сталь чорна, сталь нержавіюча.

Ступінь захисту за ДСТУ EN 60529:2014 (код IP) - IP40, IP53, IP54 та IP65 для приладів з гідрозаповненням.

Маса, kg: від 0,12 до 3,5.

Середнє напрацювання на відмову, h (год): 100000.

Комплект поставки:

- прилад - 1 шт. (модифікація, виконання і типорозмір відповідно до замовлення);
- паспорт - 1 прим.;
- настанова з експлуатації - 1 прим. на 10 шт.;
- індивідуальна упаковка.

Вимоги безпеки

Не допускається експлуатація приладів в системах, тиск в яких може перевищувати верхні межі вимірів цих приладів.

Прилади повинні бути надійно закріплені при монтажі на об'єкті.

Монтаж приладів повинен здійснюватися тільки впливом на штуцер.

Категорично забороняється при встановленні приладів прикладати механічні зусилля до корпусу приладу.

Заміна, приєднання і від'єднання приладів від об'єкта повинні проводитися при відсутності тиску в магістралі.

Вказівки по експлуатації, транспортуванню і зберіганню

Монтаж і експлуатація приладів повинні проводитися відповідно до настанови по експлуатації. Температура повітря при експлуатації від мінус 40 до + 70 °С, відносна вологість 80% при 15°С та від мінус 20°С до +100°С для приладів з гідрозаповненням. Температура робочого середовища від мінус 40 до +150 °С.

Прилади в транспортній упаковці транспортуються всіма видами автомобільного і залізничного транспорту, а також поштовими посилками (з масою вантажу до 10 кг).

Спосіб укладання ящиків на транспортному засобі повинен виключати можливість їх переміщення.

Зберігання приладів в транспортній тарі в неопалювальних сховищах при температурі повітря від мінус 50 до плюс 50 °С і відносній вологості повітря 75% при 15 °С, а в споживчій тарі – в опалювальних сховищах при температурі повітря від 5 до 40 °С і відносній вологості повітря 60 % при 20 °С.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність приладів ТУ У 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-1 при дотриманні споживачем умов монтажу, експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін експлуатації - 18 місяців з дати продажу.

Відомості про приймання

Партія № ПБТ2605

Прилад зав. № _____ відповідає вимогам ТУ 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-1 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску травень 2026
місяць, рік.

місце для штампу
ВТК

Міжповірочний інтервал приладів, що перебувають в експлуатації - 1 рік, згідно з Наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 р. № 1747.

Відрахування терміну здійснюється від року, зазначеного у додатковому метрологічному маркуванні.

Відмітки про періодичні повірки

Дата	Результат повірки	Дата наступної повірки	Підпис повірителя та відтиск тавра

Вимоги безпеки

Не допускається експлуатація приладів в системах, тиск в яких може перевищувати верхні межі вимірів цих приладів.

Прилади повинні бути надійно закріплені при монтажі на об'єкті.

Монтаж приладів повинен здійснюватися тільки впливом на штуцер.

Категорично забороняється при встановленні приладів прикладати механічні зусилля до корпусу приладу.

Заміна, приєднання і від'єднання приладів від об'єкта повинні проводитися при відсутності тиску в магістралі.

Вказівки по експлуатації, транспортуванню і зберіганню

Монтаж і експлуатація приладів повинні проводитися відповідно до настанови по експлуатації. Температура повітря при експлуатації від мінус 40 до + 70 °С, відносна вологість 80% при 15°С та від мінус 20°С до +100°С для приладів з гідрозаповненням. Температура робочого середовища від мінус 40 до +150 °С.

Прилади в транспортній упаковці транспортуються всіма видами автомобільного і залізничного транспорту, а також поштовими посилками (з масою вантажу до 10 кг).

Спосіб укладання ящиків на транспортному засобі повинен виключати можливість їх переміщення.

Зберігання приладів в транспортній тарі в неопалювальних сховищах при температурі повітря від мінус 50 до плюс 50 °С і відносній вологості повітря 75% при 15 °С, а в споживчій тарі – в опалювальних сховищах при температурі повітря від 5 до 40 °С і відносній вологості повітря 60 % при 20 °С.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність приладів ТУ У 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-1 при дотриманні споживачем умов монтажу, експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін експлуатації - 18 місяців з дати продажу.

Відомості про приймання

Партія № ПБТ2605

Прилад зав. № _____ відповідає вимогам ТУ 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-1 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску травень 2026
місяць, рік.

місце для штампу
ВТК

Міжповірочний інтервал приладів, що перебувають в експлуатації - 1 рік, згідно з Наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 р. № 1747.

Відрахування терміну здійснюється від року, зазначеного у додатковому метрологічному маркуванні.

Відмітки про періодичні повірки

Дата	Результат повірки	Дата наступної повірки	Підпис повірителя та відтиск тавра



UA.TR.113
(знак відповідності та
додаткове метрологічне маркування)



Сертифікат перевірки типу
№ UA.TR.113-0127-18 версія 4
від 01.05.2026 р.



UA.TR.113
(знак відповідності та
додаткове метрологічне маркування)



Сертифікат перевірки типу
№ UA.TR.113-0127-18 версія 4
від 01.05.2026 р.

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

Напороміри ДН 05, Тягоміри ДТ 05, Тягонапороміри ДГ 05
Паспорт АКГ 05.890.004 ПС

Напороміри ДН 05; тягоміри ДТ 05; тягонапороміри ДГ 05 (далі по тексту - прилади) призначені для вимірювання надлишкового і вакуумметричного тиску газів і пару в різних галузях промисловості, в тому числі при проведенні робіт по забезпеченню охорони здоров'я, контролю стану навколишнього природного середовища та безпеки умов праці, при проведенні геодезичних і гідрометеорологічних робіт.

Прилади випускаються під замовлення за технічними умовами ТУ У 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-3.

Виробник: ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», 37240, вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, Україна. Тел./факс (05356) 3-71-00, 3-71-11; (044) 330-03-09.

E-mail: sales@steklopribor.com, www.steklopribor.com.

Основні технічні дані та характеристики

Найменування та умовне позначення: Напороміри ДН 05; Тягоміри ДТ 05;
Тягонапороміри ДГ 05

Діапазони показів (вимірювань): 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-400 mbar
-10-0; -16-0; -25-0; -40-0; -60-0; -100-0; -160-0; -250-0; -400-0 mbar
-10-10; -10-15; -12,5-12,5; -15-10; -15-25; -20-20; -20-40;
-25-15; -30-30; -40-20; -40-60; -50-50; -60-40; -60-100; -80-80;
-100-60; -100-150; -125-125; 150-100; -200-200 mbar.

Діапазони показів (вимірювань): 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40 kPa
-1-0; -1,6-0; -2,5-0; -4-0; -6-0; -10-0; -16-0; -25-0; -40-0 kPa.
-1-1; -1-1,5; -1,25-1,25; -1,5-1; -1,5-2,5; -2-2; -2-4;
-2,5-1,5; -3-3; -4-2; -4-6; -5-5; -6-4; -6-10; -8-8; -10-6; -10-15;
-12,5-12,5; 15-10; -20-20 kPa.

Клас точності: 1; 1,6; 2,5

Діаметр або розмір лицьової панелі корпусу, mm: 63; 100
Розташування штуцера: - осьове, радіальне;
Приєднання, різьба:

для корпусу діаметром 63 mm M12x1,5;
для діаметра 100 mm M20x1,5

Матеріал робочої камери: латунь
Матеріал штуцера: латунь
Матеріал корпусу: сталь чорна, сталь нержавіюча
Маса не більше, kg: від 0,2 до 0,5 kg
Ступінь захисту за ДСТУ EN 60529:2014 (код IP) - IP 53, IP 54
Середнє напрацювання на відмову, h (год): 100000

Комплект поставки містить:

- прилад - 1 шт. (модифікація виконання і типорозмір відповідно до замовлення);
- паспорт - 1 прим.;
- настанова з експлуатації - 1 прим. на 10 шт.;
- індивідуальна упаковка.

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

Напороміри ДН 05, Тягоміри ДТ 05, Тягонапороміри ДГ 05
Паспорт АКГ 05.890.004 ПС

Напороміри ДН 05; тягоміри ДТ 05; тягонапороміри ДГ 05 (далі по тексту - прилади) призначені для вимірювання надлишкового і вакуумметричного тиску газів і пару в різних галузях промисловості, в тому числі при проведенні робіт по забезпеченню охорони здоров'я, контролю стану навколишнього природного середовища та безпеки умов праці, при проведенні геодезичних і гідрометеорологічних робіт.

Прилади випускаються під замовлення за технічними умовами ТУ У 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-3.

Виробник: ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», 37240, вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, Україна. Тел./факс (05356) 3-71-00, 3-71-11; (044) 330-03-09.

E-mail: sales@steklopribor.com, www.steklopribor.com.

Основні технічні дані та характеристики

Найменування та умовне позначення: Напороміри ДН 05; Тягоміри ДТ 05;
Тягонапороміри ДГ 05

Діапазони показів (вимірювань): 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-400 mbar
-10-0; -16-0; -25-0; -40-0; -60-0; -100-0; -160-0; -250-0; -400-0 mbar
-10-10; -10-15; -12,5-12,5; -15-10; -15-25; -20-20; -20-40;
-25-15; -30-30; -40-20; -40-60; -50-50; -60-40; -60-100; -80-80;
-100-60; -100-150; -125-125; 150-100; -200-200 mbar.

Діапазони показів (вимірювань): 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40 kPa
-1-0; -1,6-0; -2,5-0; -4-0; -6-0; -10-0; -16-0; -25-0; -40-0 kPa.
-1-1; -1-1,5; -1,25-1,25; -1,5-1; -1,5-2,5; -2-2; -2-4;
-2,5-1,5; -3-3; -4-2; -4-6; -5-5; -6-4; -6-10; -8-8; -10-6; -10-15;
-12,5-12,5; 15-10; -20-20 kPa.

Клас точності: 1; 1,6; 2,5

Діаметр або розмір лицьової панелі корпусу, mm: 63; 100
Розташування штуцера: - осьове, радіальне;
Приєднання, різьба:
для корпусу діаметром 63 mm M12x1,5;
для діаметра 100 mm M20x1,5
Матеріал робочої камери: латунь
Матеріал штуцера: латунь
Матеріал корпусу: сталь чорна, сталь нержавіюча
Маса не більше, kg: від 0,2 до 0,5 kg
Ступінь захисту за ДСТУ EN 60529:2014 (код IP) - IP 53, IP 54
Середнє напрацювання на відмову, h (год): 100000

Комплект поставки містить:

- прилад - 1 шт. (модифікація виконання і типорозмір відповідно до замовлення);
- паспорт - 1 прим.;
- настанова з експлуатації - 1 прим. на 10 шт.;
- індивідуальна упаковка.

Вимоги безпеки

Не допускається експлуатація приладів в системах, тиск в яких може перевищувати верхні межі вимірів цих приладів.

Прилади повинні бути надійно закріплені при монтажі на об'єкті.

Монтаж приладів повинен здійснюватися тільки впливом на штуцер.

Категорично забороняється при встановленні приладів прикладати механічні зусилля до корпусу приладу.

Заміна, приєднання і від'єднання приладів від об'єкта повинні проводитися за відсутності тиску в магістралі.

Вказівки по експлуатації, транспортуванню і зберіганню

Монтаж і експлуатація приладів повинні проводитись відповідно до настанови по експлуатації. Температура повітря при експлуатації від мінус 40 до +70 °С, відносна вологість повітря 80 % при 15 °С та від мінус 20°С до 100°С для приладів з гідрозаповненням. Температура робочого середовища від мінус 40 до плюс 70 °С.

Прилади в транспортній упаковці транспортуються всіма видами автомобільного і залізничного транспорту, а також поштовими посилками (з масою вантажу до 10 кг).

Спосіб укладання ящиків на транспортному засобі повинен виключати можливість їх переміщення.

Зберігання приладів в транспортній тарі в неопалювальних сховищах при температурі повітря від мінус 50 до + 50 °С і відносній вологості повітря 75% при 15 °С, а в споживчій тарі – в опалювальних сховищах при температурі повітря від 5 до 40 °С і відносній вологості повітря 60 % при 20 °С.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність приладів ТУ У 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-3 при дотриманні споживачем умов монтажу, експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін експлуатації - 18 місяців з дати продажу.

Відомості про приймання

Партія № ПВТ2605

Прилад зав. № _____ відповідає ДСТУ EN 837-3 та ТУ 33.2-14307481-031:2005 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску травень 2026 р.
місяць, рік.

місце для штампу
ВТК

Міжповірочний інтервал приладів, що перебувають в експлуатації - 1 рік, згідно з Наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 р. № 1747.

Відрахування терміну здійснюється від року, зазначеного у додатковому метрологічному маркуванні.

Відмітки про періодичні повірки

Дата	Результат повірки	Дата наступної повірки	Підпис повірителя та відтиск тавра

Вимоги безпеки

Не допускається експлуатація приладів в системах, тиск в яких може перевищувати верхні межі вимірів цих приладів.

Прилади повинні бути надійно закріплені при монтажі на об'єкті.

Монтаж приладів повинен здійснюватися тільки впливом на штуцер.

Категорично забороняється при встановленні приладів прикладати механічні зусилля до корпусу приладу.

Заміна, приєднання і від'єднання приладів від об'єкта повинні проводитися за відсутності тиску в магістралі.

Вказівки по експлуатації, транспортуванню і зберіганню

Монтаж і експлуатація приладів повинні проводитись відповідно до настанови по експлуатації. Температура повітря при експлуатації від мінус 40 до +70 °С, відносна вологість повітря 80 % при 15 °С та від мінус 20°С до 100°С для приладів з гідрозаповненням. Температура робочого середовища від мінус 40 до плюс 70 °С.

Прилади в транспортній упаковці транспортуються всіма видами автомобільного і залізничного транспорту, а також поштовими посилками (з масою вантажу до 10 кг).

Спосіб укладання ящиків на транспортному засобі повинен виключати можливість їх переміщення.

Зберігання приладів в транспортній тарі в неопалювальних сховищах при температурі повітря від мінус 50 до + 50 °С і відносній вологості повітря 75% при 15 °С, а в споживчій тарі – в опалювальних сховищах при температурі повітря від 5 до 40 °С і відносній вологості повітря 60 % при 20 °С.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність приладів ТУ У 33.2-14307481-031:2005 та ДСТУ EN 837-3 при дотриманні споживачем умов монтажу, експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін експлуатації - 18 місяців з дати продажу.

Відомості про приймання

Партія № ПВТ2605

Прилад зав. № _____ відповідає ДСТУ EN 837-3 та ТУ 33.2-14307481-031:2005 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску травень 2026 р.
місяць, рік.

місце для штампу
ВТК

Міжповірочний інтервал приладів, що перебувають в експлуатації - 1 рік, згідно з Наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 р. № 1747.

Відрахування терміну здійснюється від року, зазначеного у додатковому метрологічному маркуванні.

Відмітки про періодичні повірки

Дата	Результат повірки	Дата наступної повірки	Підпис повірителя та відтиск тавра

Мінекономіки України
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
Орган з оцінки відповідності
Акредитований Національним Агентством з акредитації України,
Атестат про акредитацію № 10251 від 14 лютого 2025 р.

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Виданий:

Issued to:

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», 37240, Полтавська обл., м. Заводське,
вул. Озерна, 18, код ЄДРПОУ 14307481

Відповідно до:

In accordance with:

Додаток 2, Модуль В (перевірка типу) Технічного регламенту
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений
Постановою КМУ № 94 від 13 січня 2016 р.

Група (категорія)

**засобу вимірювальної
техніки:**

*Group (Category) of
measuring instrument:*

**Назва та позначення
типу:**

Name and type designation:

Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму

Манометри ДМ 05, манометри з термометром ДМТ 05, манометри
сигналізуючі ДМ Сг 05, вакуумметри ДВ 05, вакуумметри сигналізуючі
ДВ Сг 05, мановакуумметри ДА 05, мановакуумметри сигналізуючі
ДА Сг 05, напороміри ДН 05, тягоміри ДТ 05, тягонапороміри ДГ 05

Дата видачі:

Date of issue:

27.08.2025

Чинний до:

Valid until:

18.03.2028

Кількість сторінок:

Number of pages:

10

Номер для посилань:

Reference Number:

113-0127-18 версія 3

**Номер призначеного
органу:**

Number of Designated body:


UA.TR.113

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проєкту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або ввозять в експлуатацію, типу, описаному в цьому сертифікаті, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

Director of the conformity assessment body

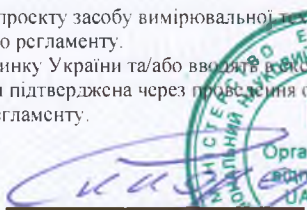
(підпис/ signature)

Володимир СКЛЯРОВ
(ініціали, прізвище/
initials, family name)
М.П./ Stamp

Цей сертифікат є власністю виробника. Він може бути відтворений лише повністю з письмової згоди виробника. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса: вул. Мירוносицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 057 704-98-49 факс: +38 057 700-34-47 ел. пошта: os_096@metrology.kharkov.ua web-сайт: <http://www.metrology.kharkov.ua>

Мінекономіки України
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
Орган з оцінки відповідності
Акредитований Національним Агентством з акредитації України,
Атестат про акредитацію № 10251 від 14 лютого 2025 р.

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Виданий:

Issued to:

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», 37240, Полтавська обл., м. Заводське,
вул. Озерна, 18, код ЄДРПОУ 14307481

Відповідно до:

In accordance with:

Додаток 2, Модуль В (перевірка типу) Технічного регламенту
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений
Постановою КМУ № 94 від 13 січня 2016 р.

Група (категорія)

**засобу вимірювальної
техніки:**

*Group (Category) of
measuring instrument:*

**Назва та позначення
типу:**

Name and type designation:

Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму

Манометри ДМ 05, манометри з термометром ДМТ 05, манометри
сигналізуючі ДМ Сг 05, вакуумметри ДВ 05, вакуумметри сигналізуючі
ДВ Сг 05, мановакуумметри ДА 05, мановакуумметри сигналізуючі
ДА Сг 05, напороміри ДН 05, тягоміри ДТ 05, тягонапороміри ДГ 05

Дата видачі:

Date of issue:

27.08.2025

Чинний до:

Valid until:

18.03.2028

Кількість сторінок:

Number of pages:

10

Номер для посилань:

Reference Number:

113-0127-18 версія 3

**Номер призначеного
органу:**

Number of Designated body:


UA.TR.113

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проєкту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або ввозять в експлуатацію, типу, описаному в цьому сертифікаті, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

Director of the conformity assessment body

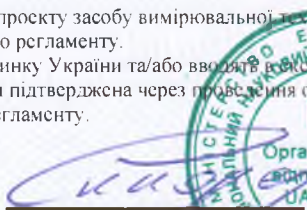
(підпис/ signature)

Володимир СКЛЯРОВ
(ініціали, прізвище/
initials, family name)
М.П./ Stamp

Цей сертифікат є власністю виробника. Він може бути відтворений лише повністю з письмової згоди виробника. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса: вул. Мירוносицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 057 704-98-49 факс: +38 057 700-34-47 ел. пошта: os_096@metrology.kharkov.ua web-сайт: <http://www.metrology.kharkov.ua>

**НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
(ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»)**

акредитований Національним агентством з акредитації України
на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065,
атестат про акредитацію № 10251 чинний до 13.02.2030

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Виданий:

Issued to:

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», 37240, Полтавська обл., м. Заводське,
вул. Озерна, 18, код ЄДРПОУ 14307481

Відповідно до:

In accordance with:

Додаток 2, Модуль В (перевірка типу) Технічного регламенту
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений
Постановою КМУ № 94 від 13 січня 2016 р.

Група (категорія)

**засобу вимірювальної
техніки:**

*Group (Category) of
measuring instrument:*

Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму

**Назва та позначення
типу:**

Name and type designation:

Манометри ДМ 05, манометри з термометром ДМТ 05, манометри
сигналізуючі ДМ Сг 05, вакуумметри ДВ 05, вакуумметри сигналізуючі
ДВ Сг 05, мановакуумметри ДА 05, мановакуумметри сигналізуючі
ДА Сг 05, напороміри ДН 05, тягоміри ДТ 05, тягонапороміри ДГ 05

Дата видачі:

Date of issue:

01.05.2026

Чинний до:

Valid until:

18.03.2028

Кількість сторінок:

Number of pages:

10

Номер для посилань:

Reference Number:

113-0127-18 версія 4

Номер призначеного

органу:

Number of Designated body:

UA.TR.113

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність
типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або ввозять в експлуатацію, типу, описаному в цьому
сертифікаті, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за
модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

Director of the conformity assessment body

Цей сертифікат є власністю виробника. Він може бути відтворений лише повністю з письмової згоди виробника. Сертифікат без підпису та печатки
не дійсний.

Адреса: вул. Мироносицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 057 704-98-49 факс: +38 057 700-34-47 ел. пошта: os_096@metrology.kharkov.ua web-сайт: <http://www.metrology.kharkov.ua>

(підпис/signature)

Орган з оцінки
відповідності
UA.TR.113

Володимир СКЛЯРОВ

(ініціали, прізвище/
initials, family name)

М.П./ Stamp