
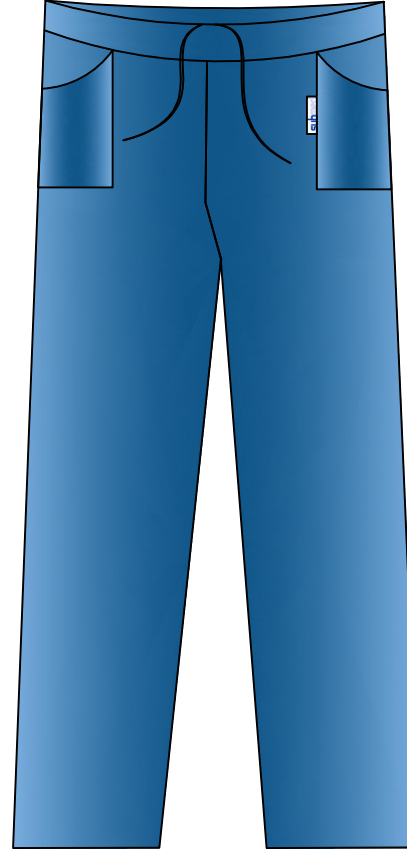




SURGICAL SCRUB SUITS

submed Safe Easy

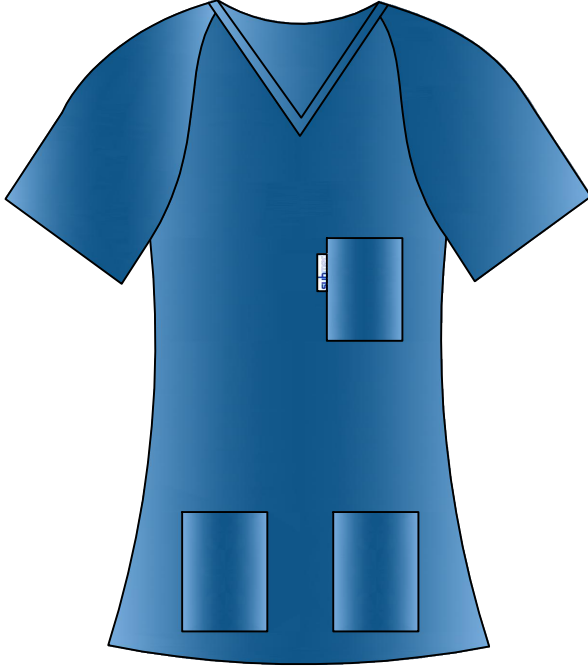

SCALE / ÖLÇEK :1/5	TOLERANCE /TÖLERANS: ±3	MACHINE CODE / MAKİNA KODU	MANUAL FOLD MANUEL KATLAMA
TITLE / ÜRÜN ADI	SURGICAL SCRUB SUITS M SIZE CERRAHİ ÖNLÜK M BEDEN	DOCUMENT NUMBER DÖKÜMAN NUMARASI	
DRAWING BY / ÇİZEN	İMREN ÖZBÜK	REVISION NO / REVİZYON NO	01
TECHNICAL DRAWING DATE TEKNİK ÇİZİM TARİHİ	23.12.2024	NOTE: Ultrasonic seam allowance should be maximum 1cm. NOT: Ultrasonik dikiş payı maksimum 1cm olmalıdır.	

[EN] ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT BELONGS TO
SU BİYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
[TR] BU BELGEDE YER ALAN TÜM BİLGİLER
SU BİYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 'YE AİTTİR.

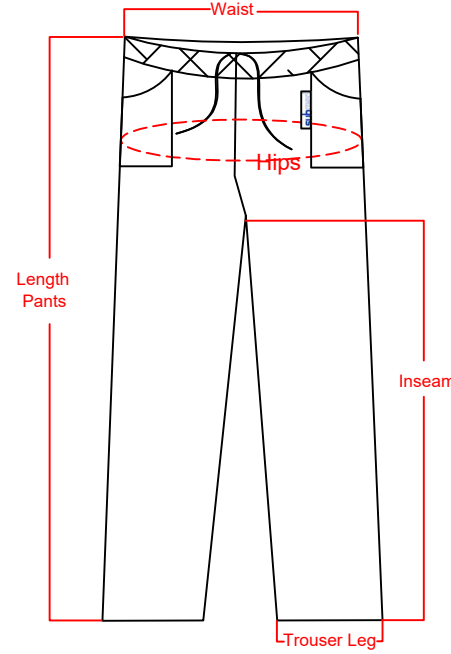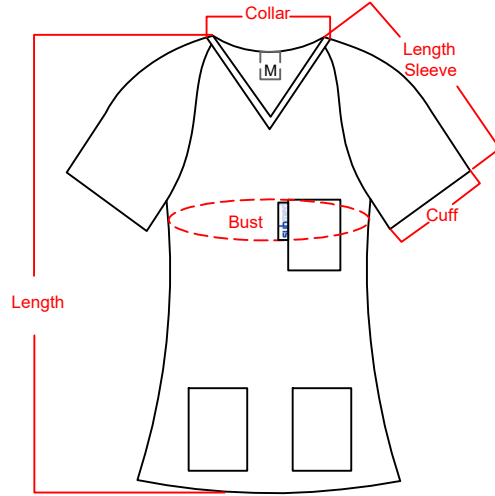


submed Safe Easy

MEASUREMENT TOLERANCE : ± 3 ÖLÇÜM TÖLERANS: ± 3

TOPS SIZE / ÜST BEDEN						PANTS SIZE / PANTOLON BEDEN				
SIZE / BEDEN	Length Uzunluk	Collar Yaka	Bust Göğüs	Length Sleeve Kol Uzunluk	Cuff Manşet	Length Pants Length Pants	Hips Kalça	Waist Bel	Inseam İç Uzunluk	Trouser Leg Paça Eni
S	66 CM	19 CM	105 CM	36 CM	19 CM	100 CM	103 CM	50 CM	72 CM	20 CM
M	68 CM	20 CM	111 CM	37 CM	20 CM	102 CM	109 CM	53 CM	73 CM	21 CM
L	70 CM	21 CM	117 CM	38 CM	21 CM	104 CM	115 CM	56 CM	74 CM	22 CM
XL	72 CM	22 CM	123 CM	39 CM	22 CM	106 CM	121 CM	59 CM	75 CM	23 CM
XXL	74 CM	23 CM	129 CM	40 CM	23 CM	108 CM	127 CM	62 CM	76 CM	24 CM

SCALE / ÖLÇEK :1/5	TOLERANCE /TÖLERANS: ±3	MACHINE CODE / MAKİNA KODU	MANUAL FOLD MANUEL KATLAMA	[EN] ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT BELONGS TO SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. [TR] BU BELGEDE YER ALAN TÜM BİLGİLER SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 'YE AİTTİR.
TITLE / ÜRÜN ADI	SURGICAL SCRUB SUITS M SIZE CERRAHİ ÖNLÜK M BEDEN	DOCUMENT NUMBER DÖKÜMAN NUMARASI		
DRAWING BY / ÇİZEN	İMREN ÖZBÜK	REVISION NO / REVİZYON NO	01	
TECHNICAL DRAWING DATE TEKNİK ÇİZİM TARİHİ	23.12.2024	NOTE: Ultrasonic seam allowance should be maximum 1cm. NOT: Ultrasonik dikiş payı maksimum 1cm olmalıdır.		

SHEET:2 OF 9

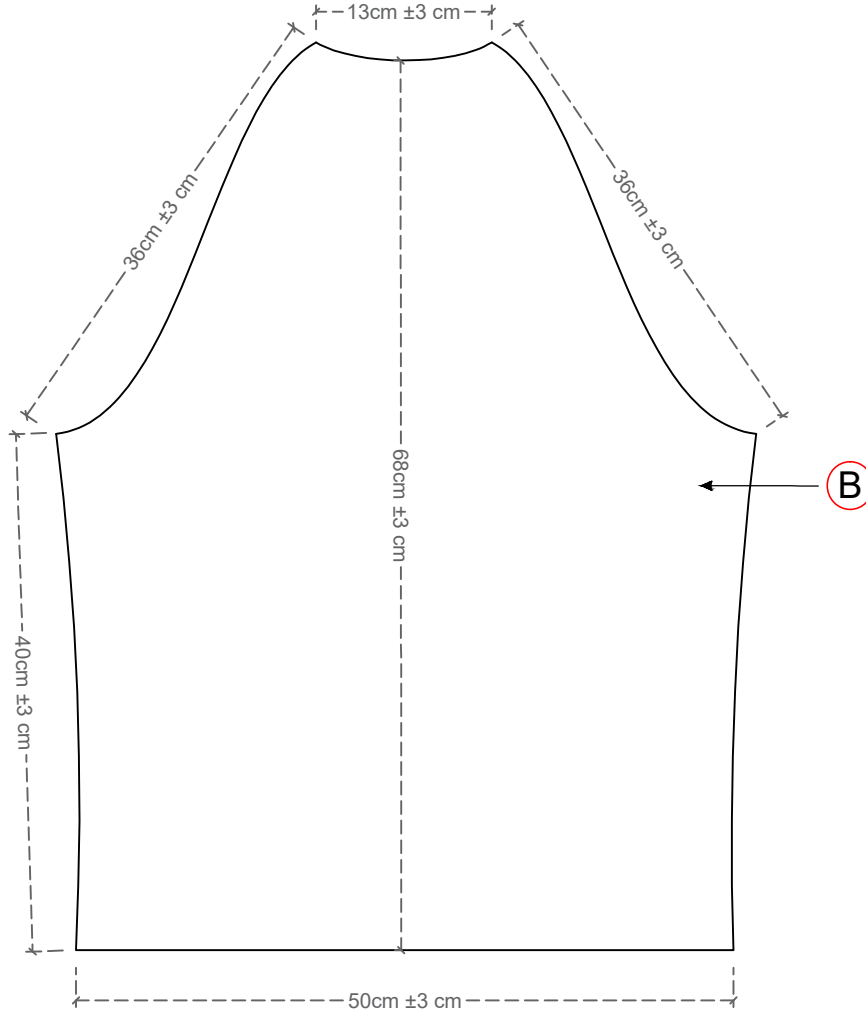


ENB The back part of the apron is cut according to the dimensions in the image.

TRB Önlüğün arka parçası görseldeki ölçülere uygun kesilir.

SCALE / ÖLÇEK :1/5	TOLERANCE /TÖLERANS: ±3	MACHINE CODE / MAKİNA KODU	MANUAL FOLD MANUEL KATLAMA
TITLE / ÜRÜN ADI	SURGICAL SCRUB SUITS M SIZE CERRAHİ ÖNLÜK M BEDEN	DOCUMENT NUMBER DÖKÜMAN NUMARASI	
DRAWING BY / ÇİZEN	İMREN ÖZBÜK	REVISION NO / REVİZYON NO	01
TECHNICAL DRAWING DATE TEKNİK ÇİZİM TARİHİ	23.12.2024	NOTE: Ultrasonic seam allowance should be maximum 1cm. NOT: Ultrasonik dikiş payı maksimum 1cm olmalıdır.	


EN ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT BELONGS TO
SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TR BU BELGEDE YER ALAN TÜM BİLGİLER
SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 'YE AİTTİR.

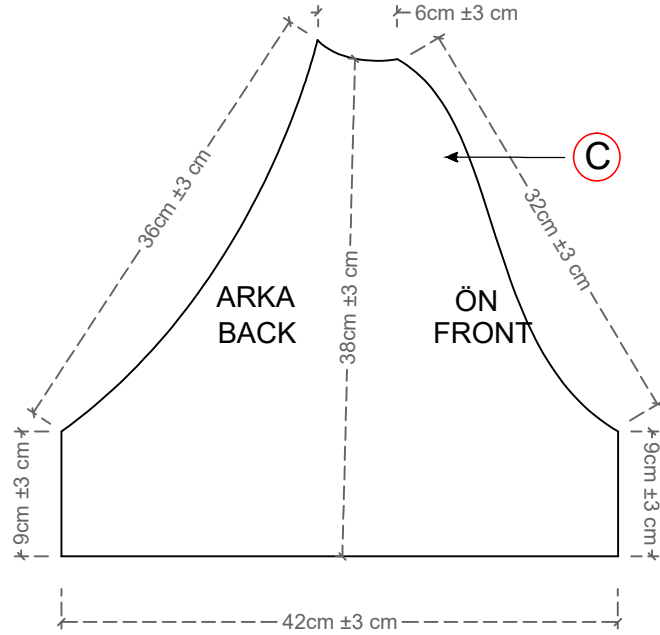


ENC The sleeve part of the apron is cut in 2 pieces according to the dimensions in the image.

TRC Önlüğün kol parçası görseldeki ölçülere uygun olarak 2 adet kesilir.

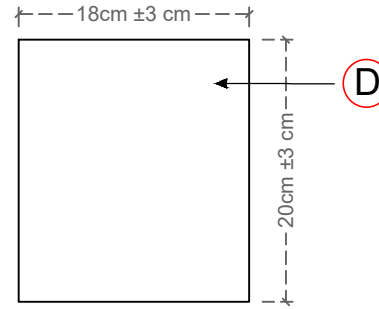

END The pocket piece of the apron is cut in 2 pieces according to the dimensions in the image.

TRD Önlüğün cep parçası görseldeki ölçülere uygun olarak 2 adet kesilir.

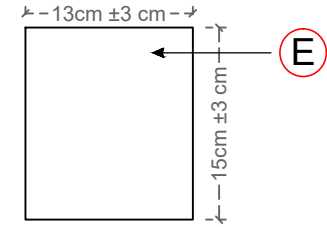


ENE The pocket piece of the apron is cut according to the dimensions in the image.

TRE Önlüğün cep parçasısı görseldeki ölçülere uygun olarak kesilir.

SCALE / ÖLÇEK :1/10	TOLERANCE /TÖLERANS: ±3	MACHINE CODE / MAKİNA KODU	MANUAL FOLD MANUEL KATLAMA
TITLE / ÜRÜN ADI	SURGICAL SCRUB SUITS M SIZE CERRAHİ ÖNLÜK M BEDEN	DOCUMENT NUMBER DÖKÜMAN NUMARASI	
DRAWING BY / ÇİZEN	İMREN ÖZBÜK	REVISION NO / REVİZYON NO	01
TECHNICAL DRAWING DATE TEKNİK ÇİZİM TARİHİ	23.12.2024	NOTE: Ultrasonic seam allowance should be maximum 1cm. NOT: Ultrasonik dikiş payı maksimum 1cm olmalıdır.	

EN ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT BELONGS TO SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TR BU BELGEDE YER ALAN TÜM BİLGİLER SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 'YE AİTTİR.

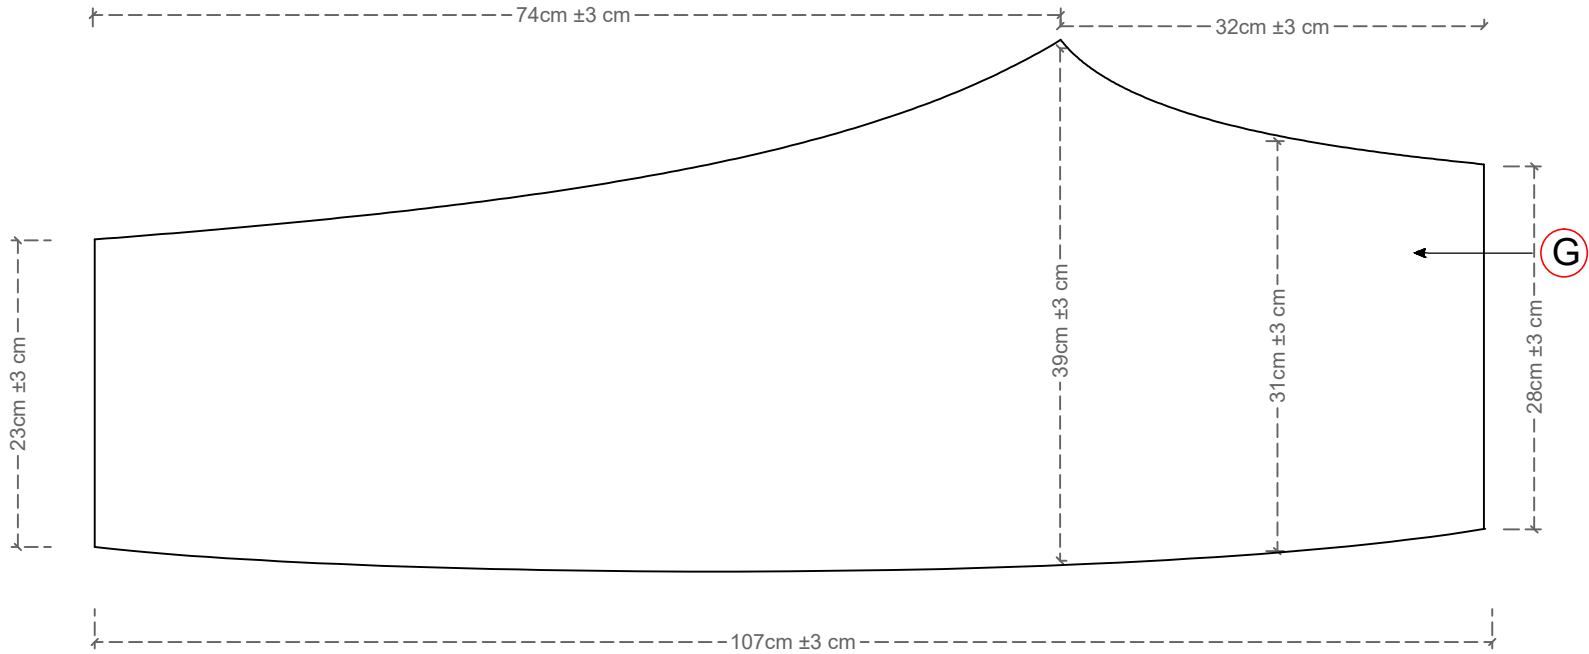


ENG The back part of the apron is cut in 2 pieces according to the dimensions in the image.

TRG Önlüğün arka parçası görseldeki ölçülere uygun olarak 2 adet kesilir.

SCALE / ÖLÇEK :1/10	TOLERANCE /TÖLERANS: ±3	MACHINE CODE / MAKİNA KODU	MANUAL FOLD MANUEL KATLAMA
TITLE / ÜRÜN ADI	SURGICAL SCRUB SUITS M SIZE CERRAHİ ÖNLÜK M BEDEN	DOCUMENT NUMBER DÖKÜMAN NUMARASI	
DRAWING BY / ÇİZEN	İMREN ÖZBÜK	REVISION NO / REVİZYON NO	01
TECHNICAL DRAWING DATE TEKNİK ÇİZİM TARİHİ	23.12.2024	NOTE: Ultrasonic seam allowance should be maximum 1cm. NOT: Ultrasonik dikiş payı maksimum 1cm olmalıdır.	

EN ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT BELONGS TO
SU BİYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TR BU BELGEDE YER ALAN TÜM BİLGİLER
SU BİYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 'YE AİTTİR.

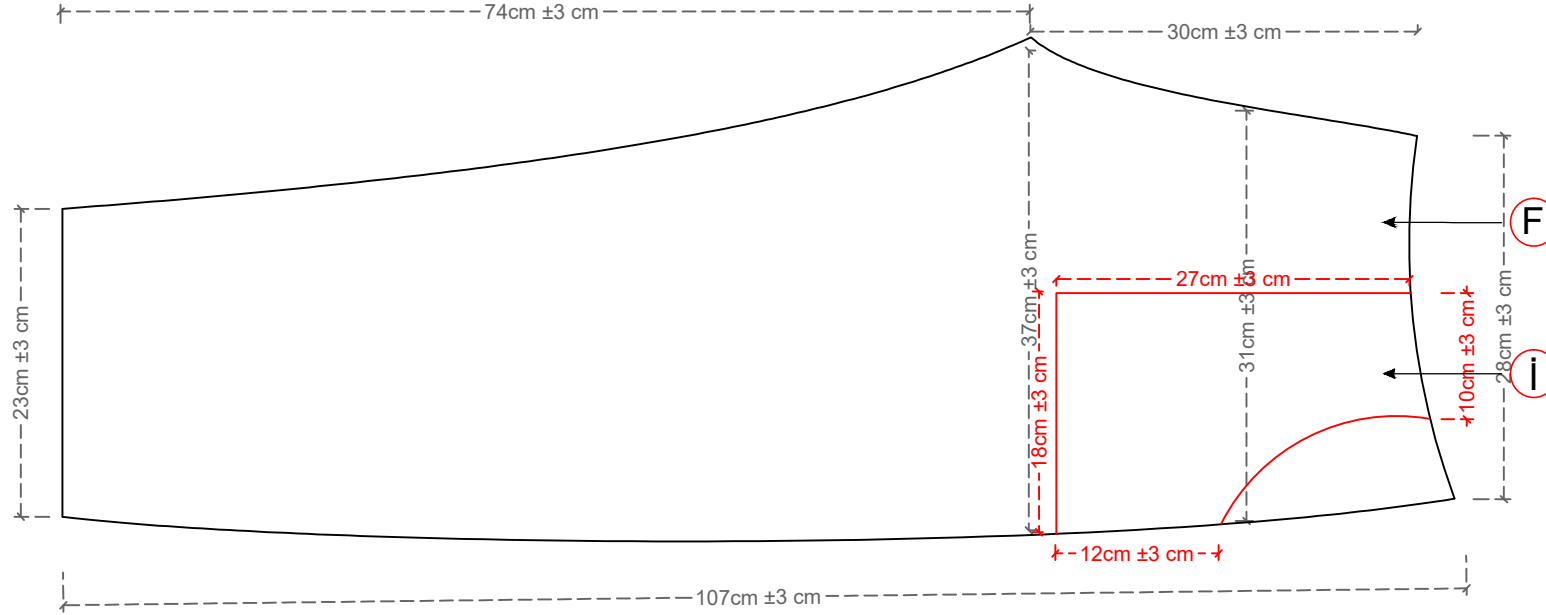

EN F The front part of the apron is cut in 2 pieces according to the dimensions in the image.

TR F Önlüğün ön parçası görseldeki ölçülere uygun olarak 2 adet kesilir.

EN I The pocket part of the apron is cut in 2 pieces according to the dimensions in the image.


TR I Önlüğün cep parçası görseldeki ölçülere uygun olarak 2 adet kesilir.

SCALE / ÖLÇEK :1/10	TOLERANCE /TÖLERANS: ±3	MACHINE CODE / MAKİNA KODU	MANUAL FOLD MANUEL KATLAMA
TITLE / ÜRÜN ADI	SURGICAL SCRUB SUITS M SIZE CERRAHİ ÖNLÜK M BEDEN	DOCUMENT NUMBER DÖKÜMAN NUMARASI	
DRAWING BY / ÇİZEN	İMREN ÖZBÜK	REVISION NO / REVİZYON NO	01
TECHNICAL DRAWING DATE TEKNİK ÇİZİM TARİHİ	23.12.2024	NOTE: Ultrasonic seam allowance should be maximum 1cm. NOT: Ultrasonik dikiş payı maksimum 1cm olmalıdır.	


EN ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT BELONGS TO
SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TR BU BELGEDE YER ALAN TÜM BİLGİLER
SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 'YE AİTTİR.


FOLD 1 / KATLAMA 1

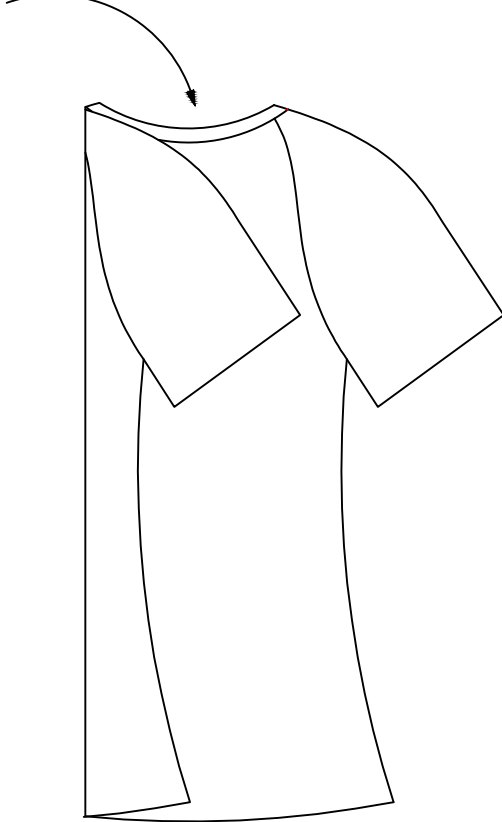

FOLD 2 / KATLAMA 2

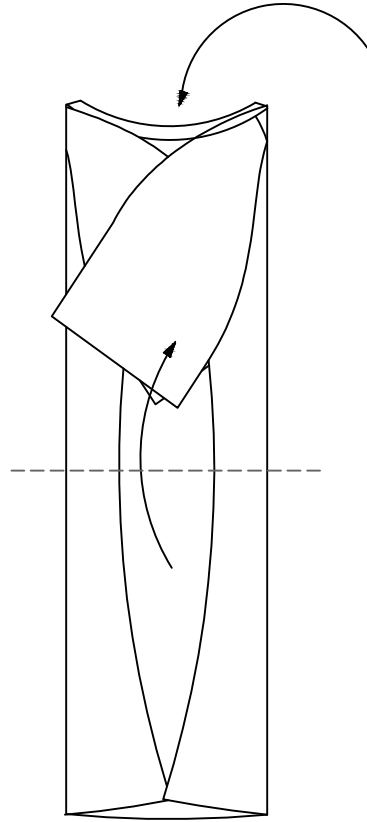

FINAL VIEW / FİNAL

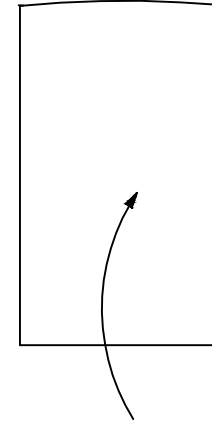

SCALE / ÖLÇEK :1/10	TOLERANCE /TÖLERANS: ±3	MACHINE CODE / MAKİNA KODU	MANUAL FOLD MANUEL KATLAMA
TITLE / ÜRÜN ADI	SURGICAL SCRUB SUITS M SIZE CERRAHİ ÖNLÜK M BEDEN	DOCUMENT NUMBER DÖKÜMAN NUMARASI	
DRAWING BY / ÇİZEN	İMREN ÖZBÜK	REVISION NO / REVİZYON NO	01
TECHNICAL DRAWING DATE TEKNİK ÇİZİM TARİHİ	23.12.2024	NOTE: Ultrasonic seam allowance should be maximum 1cm. NOT: Ultrasonik dikiş payı maksimum 1cm olmalıdır.	

[EN] ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT BELONGS TO
SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.





[TR] BU BELGEDE YER ALAN TÜM BİLGİLER
SU BIYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 'YE AİTTİR.

FOLD 1 / KATLAMA 1

FOLD 2 / KATLAMA 2

FOLD 3 / KATLAMA 3

FINAL VIEW / FİNAL

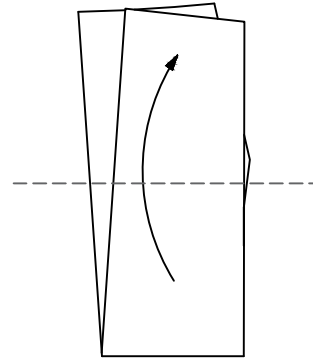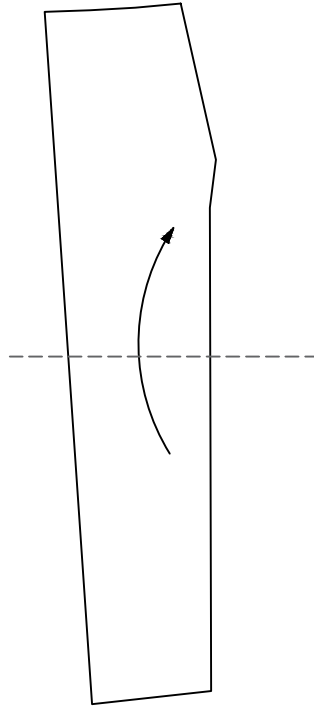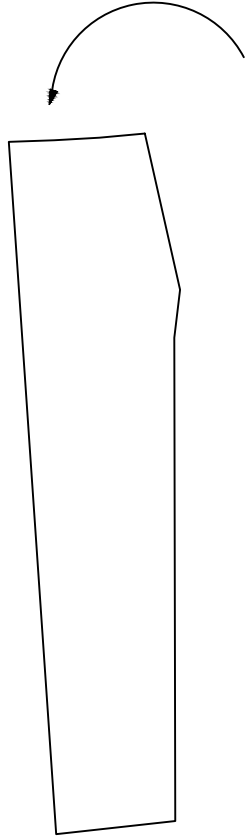

SCALE / ÖLÇEK :1/10	TOLERANCE / TÖLERANS: ± 3	MACHINE CODE / MAKİNA KODU	MANUAL FOLD MANUEL KATLAMA
TITLE / ÜRÜN ADI	SURGICAL SCRUB SUITS M SIZE CERRAHİ ÖNLÜK M BEDEN	DOCUMENT NUMBER DÖKÜMAN NUMARASI	
DRAWING BY / ÇİZEN	İMREN ÖZBÜK	REVISION NO / REVİZYON NO	01
TECHNICAL DRAWING DATE TEKNİK ÇİZİM TARİHİ	23.12.2024	NOTE: Ultrasonic seam allowance should be maximum 1cm. NOT: Ultrasonik dikiş payı maksimum 1cm olmalıdır.	

[EN] ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT BELONGS TO
SU BİYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

[TR] BU BELGEDE YER ALAN TÜM BİLGİLER
SU BİYOMEDİKAL SİSTEMLER VE SAĞLIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. 'YE AİTTİR.