BS-600M

Биохимический анализатор

mindray

Технические характеристики

Функционал системы:

Производительность: 600 фотометрических тестов в час, до 800 тестов в час с ISE модулем

Принципы измерений: Абсорбционная фотометрия, турбидиметрия

Методы анализа: до 77 фотометрических тестов + 3 ISE электрода + 3 сывороточных индекса

Методики: Конечная точка, фиксированное время, кинетика. ISE

Работа с образцами:

SDM: 120 образцов на 12 штативах, непрерывная загрузка образцов, приоритетная подача срочных образцов

Объем образца: 1,5–45 мкл с шагом 0,1 мкл Образец HbA1c: Цельная кровь для анализа на HbA1c Пробозаборник: Определение уровня жидкости, определение сгустков, защита от столкновений

Работа с реагентами:

Лоток для реагентов: 80 позиций с системой охлаждения (2-8°C)

Объем реагента: 10–200 мкл с шагом 0,5 мкл Зонд для реагентов: Определение уровня жидкости, определение пузырьков, защита от столкновений

Встроенное устройство считывания штрих-кодов:

Устройства считывания штрих-кодов с образцов и реагентов поддерживают такие системы кодирования, как Codabar, ITF (2 из 5 чередующийся), Code 128, Code 39, UPC/EAN и Code 93; Может обмениваться данными с ЛИС в двунаправленном режиме

Реакционная система:

Реакционный объем: 70–300 мкл

Температура реакции: 37°С с колебанием

температуры 0,1°С

Реакционные кюветы: 124 кюветы многоразового использования с 8-ступенчатой автоматической промывкой

www.mindray.com

№ изделия: ENG-BS-600M-210285X8P-20220302 ©2022 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. Все права защищень

Оптическая система:

Источник света: Галоген-вольфрамовая лампа Фотометр: Фотометр с дифракционной решеткой **Длина волны:** 16 длин волн (340 нм, 380 нм, 412 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм, 546 нм, 570 нм, 605 нм, 630 нм, 660 нм, 700 нм, 740 нм, 770 нм, 800 нм, 850 нм)

Диапазон поглощения: 0-3,5 коэф (конверсия 10 мм)

Контроль и калибровка:

Режим калибровки: Линейная (одноточечная, двухточечная и многоточечная), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Сплайн, экспоненциальная, полиномиальная, параболическая Правила контроля качества: Система правил

Операционный блок:

Вестгарда, Twin plot

Операционная система: Сенсорный экран (дополнительно), Windows 10 (64 бит) Интерфейс: RS-232, сетевой порт, USB/параллельный порт

Условия эксплуатации:

Источник питания: 200–240 В, 50/60 Гц, 1700 В-А или 110/115 В, 60 Гц, 1700 В-А

Температура: 15−30°С

Относительная влажность: 35-85 %

Размеры: 1380 мм (длина)*860 мм (ширина)*1200 мм (высота)

Вес: 350 кг





Качественное медицинское обслуживание для всех

BS-600M Биохимический анализатор

Мощный и эффективный







Гибкое управление образцами

Непрерывная загрузка образцов

Непрерывная загрузка образцов на штативы До 120 позиций для образцов Увеличение времени работы без участия оператора

Быстрый запуск для повторного анализа образцов

Автоматический запуск для анализа образцов Автоматическая приоритетная подача срочных образцов и повторный анализ

Приоритетная подача срочных образцов (STAT-образцов)

Выделенная позиция для срочных образцов, аспирация 1 минута Быстрый отчет о результатах ISE+CO2 за 7 минут



Интеллектуальное разбавление


Запатентованная функция интеллектуального разбавления Оперативное получение результатов

Анализ цельной крови на гликированный гемоглобин (HbA1c)




Встроенный гемолиз образцов цельной крови для повышения эффективности работы Предварительная обработка без вмешательства оператора для снижения риска биологического загрязнения и вероятности ошибок, связанных с человеческим фактором 120 тестов/час при исследовании на HbA1c для сокращения времени выполнения анализа

Благодаря реагенту HbA1c компании Mindray при использовании ферментативного метода анализа можно точно определять гликированные N-концевые аминокислоты из бета-цепей гемоглобина, что позволяет эффективным образом избежать интерференции вариантов гемоглобина (HbS, HbC, HbE и HbD) и других производных гемоглобина (лабильный HbA1c, карбамилированный Hb и ацетилированный Hb). Ферментативный метод анализа на гликированный гемоглобин (HbA1c) компании Mindray дает надежные и экономически эффективные результаты с самого первого измерения и

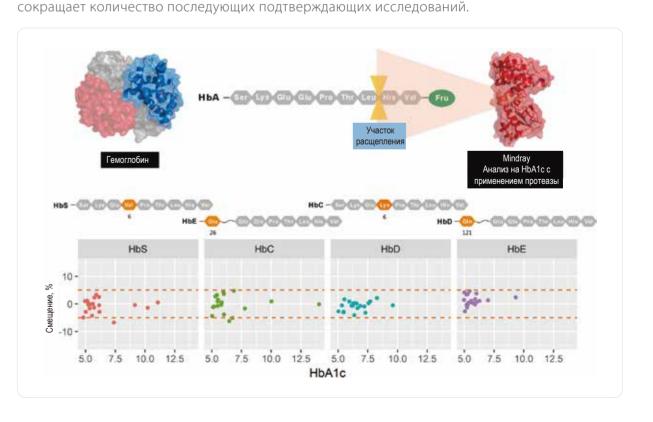

Нижний предел обнаружения гемоглобина для анализа на HbA1c

Выполняется оценка концентрации гемоглобина в процессе гемолиза и заблаговременное начало тестов на увеличение концентрации в образцах с низкой концентрацией гемоглобина. Данная функция позволяет понизить предел обнаружения и расширить линейную область определения концентрации гемоглобина с целью уменьшения количества повторных тестов и снижения отходов реагентов при анализе образцов с признаками анемии.

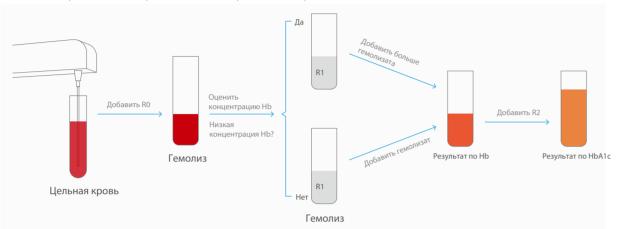

Интегрированный ионоселективный модуль

Встроенный ионоселективный модуль

- Выдача результатов по Na+, K+, CL-
- 1 пробирка для крови для выполнения анализов на электролиты и биохимических анализов фотометрическими методами





Эффективное и простое управление

- До 300 тестов в час
- Срок службы электродов Na/K/референтных электродов до 9 месяцев
- Автоматическая калибровка
- Малый расход
- Простота эксплуатации и технического обслуживания

Надежная система тестирования



Высокий уровень показателей сигмаметрии

Оригинальные реагенты и утвержденный протокол применения снижают процент неточностей и погрешностей, что способствует достижению отличных показателей сигмаметрии мирового уровня. Система с более высоким показателем сигма позволяет лабораториям обеспечивать высокий уровень качества при меньших затратах, а также повышает уверенность и удовлетворенность медицинских работников.

Интеллектуальное обнаружение аномальных реакций

Мощное программное обеспечение со встроенными алгоритмами, которые могут отслеживать реакцию на наличие отклонений, подавать сигналы тревоги и запускать автоматический повтор анализа образцов, у которых наблюдаются отклонения от нормы во время тестирования, например, истощение субстрата, нехватка кислорода, хук-эффекты и пр. Такой интеллектуальный подход с функциями обнаружения, сигнализации и автоматического повтора анализа минимизирует количество ложных результатов и риск постановки неправильного диагноза, а также позволяет получить точные и надежные результаты исследований.

